



PROTOCOLO GERAL
64583.010437/2022-44

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 01/2023-HMAR

VOLUME VIII

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SALC)

OBJETO:	Pregão Eletrônico para Aquisição de Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares - Material permanente do planejamento anual das atividades - PAASSEX, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), de acordo com a Portaria nº 001-SEF, de 27 Jan 2014.
----------------	--

INTERESSADO:	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
---------------------	------------------------------------

ANEXOS:	Documentos conforme termo de autuação.
----------------	--

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	D A T A	DESTINO	D A T A
1			17
2			18
3			19
4			20
5			21
6			22
7			23
8			24
9			25
10			26
11			27
12			28
13			29
14			30
15			31
16			32



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO / 1817)**

TERMO DE ABERTURA DO 8º VOLUME

Aos 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, procedemos à abertura do Volume VIII do Processo Administrativo nº 64583.010437/2022-44, iniciando-se com a folha nº 1501.

**Hospital Militar de Área de Recife
UASG: 160199**

GEORGE DOS SANTOS COSTA – 2º Ten

Adjunto da Salc do HMAR

o que você procura

| Pedidos e Trocas | Atendimento |

... e Fidejussão de ...

Handwritten signature and circular stamp with text: "HOSPITAL ... 12/08/14"

... Multifuncionais > Multifuncionais Laser Brother Mono > Multifuncionais Laser Brother Mono



Impressora Multifuncional Laser DCPL5652DN, Monocromática, Impressão Duplex, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v - Brother CX 1 UN

Código: 220560


Mais produtos [Brother](#)

★★★★★ (1)

Compre junto

... para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, ... e concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

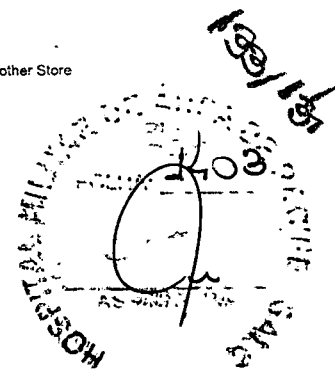

Handwritten signature

177,70 a vista

100% iguais ao produto, 20% de a. 20 27% e a. 20 27% e a. 20 27% e a.

Adicionar ao carrinho

Descrição

Características

Compartilhar

+
+
+

Produtos

- 1. Produto 1
- 2. Produto 2

Dúvidas Frequentes

- [Como funciona a loja](#)
- [Dúvidas sobre cadastro](#)
- [Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos](#)
- [Devolução e troca](#)
- [Nota Fiscal Eletrônica](#)

Redes Sociais

- Facebook
- Instagram
- Youtube
- LinkedIn

Cartões de Crédito:



PIX, Boleto Bancário e Faturado:




Débito Online:



Este site é um site hospedado e operado por Kalunga.com.br, que estão atuando como o revendedor desta loja. A informação que você disponibilizar será gerenciada pela Kalunga.com.br e será compartilhada com a Brother. Para mais informações sobre como a Brother administrará suas informações, acesse a Política de Privacidade da Brother em brotherstore.com.br.

As condições de pagamento, frete e estoque são válidas apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000

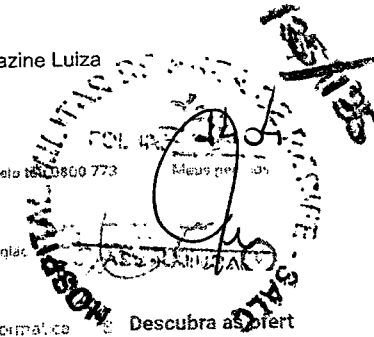

Meu Magalu | Minha loja | Registros | Acessibilidade | Guia de segurança

Atendimento | Compre pelo telefone 0800 773 3838

Busca no Magalu



Bem-vindo | Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Magalu | Ofertas do Dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | TV e Vídeo | Informática

Descubra as ofertas

Compartilhe sua localização para valores de frete, entre

Estabilizador Ts Shara Powerest 700va Bivolt - 9005

Estabilizador Ts Shara Powerest 700va Bivolt - 9005

Ver descrição completa | TS.SHARA



Imagem de Estabilizador Ts Shara Powerest 700va Bivolt - 9005

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Importline**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 465,09

R\$ 418,58

no PIX (10% de desconto)

ou 8x de R\$ 58,14 sem juros

Cartão de crédito
sem juros


R\$ 465,09
8x R\$ 58,14

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 [Calcular frete e prazo](#)

Produtos patrocinados do Magalu para você

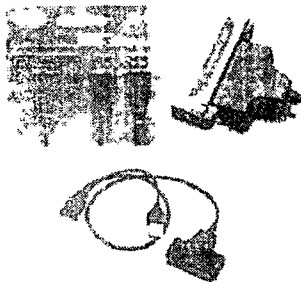

Adaptador para USB 2.0 Hd de Notebook 2,5
5 Pin, KP-HD015

R\$ 26,77



Headset Gamer JBL



★★★★★ 28

R\$ 1.232,00

R\$ 650,91

no PIX (7% de desconto)

ou 5x de R\$ 139,98 sem juros

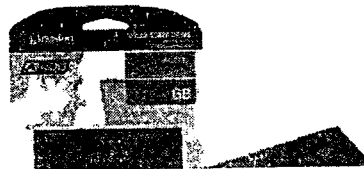

Estabilizador Ts Shara Powerest 7... R\$ 418,58 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Ver detalhes](#)

[Descrição Completa](#)


[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

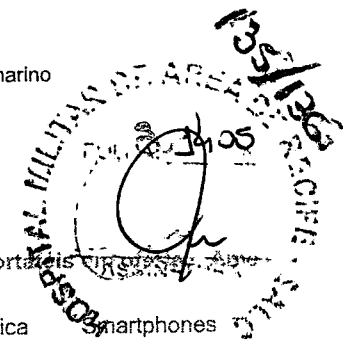

Ver o APP Cupom do dia Volta às Aulas TVs com desconto Eletroportáteis

Livros Games PC Gamer Notebooks Informática Smartphones

os melhores fretes e prazos

> proteção elétrica > estabilizador



os cadastrados

Estabilizador Ts Shara Powerest Home 700 Bivolt 115/220v - 9005

R\$ 404,85

em até 4x sem juros no cartão de crédito

Faça a 1ª

avaliação

R\$ 404,85 em até 8x sem juros no cartão de crédito Ame

[Mais formas de pagamento](#)

Estabilizador Powerest Home 700 é a proteção ideal para os equipamentos eletrodomésticos em geral pois possuem duas características extremamente eficientes, uma delas é o Auto diagnóstico de partida, que faz a análise prévia da red...

Calcular frete e prazo

[Mais informações](#)

Comprar

< [outra imagem do produto](#) | [outra imagem do produto](#) | [outra imagem do produto](#)



[Conheça nossa política de troca](#)

Este produto é vendido e entregue por **IBYTE**. O Submarino garante a sua compra do pedido à entrega.

Atendimento


Televidas

Nossas lojas

Atendimento

Atendimento em Libras

Pesquise por produtos ou marcas

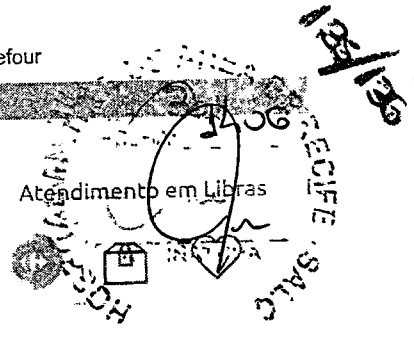

Departamentos Ofertas do Dia Smartphones Pneu TVs Eletrodomésticos Notebooks Frald

Lojas para: Sao Paulo - SP

Estabilizador Powerest 700Va Bivolt 115V 6T 9005 Preto

- Cód: 6693496

Vendido e entregue por Olist

R\$ 461,53

COMPRAR

em 1x no cartão ou boleto

9x de R\$ 51,28 sem juros

O Carrefour garante a sua cc

Condição exclusiva Cartão Carrefour
Até 10x R\$ 46,15 sem juros

[Peça já o seu](#)

Condições de pagamento

Valor e prazo de entrega

[Não sei meu CEP](#)

Buscar


Especificações técnicas

Características do Produto

Tensão

Bivolt

Scanner de Mesa Canon DR-S150, ... R\$ 3.049,99 à vista

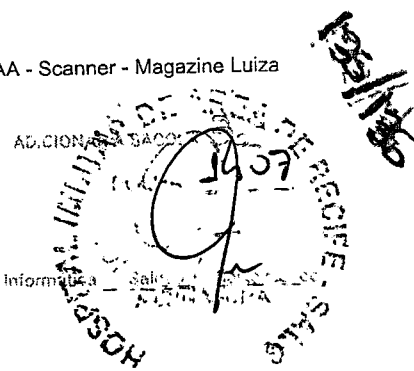

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Imagem](#) [Comparações](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#)

Scanner de Mesa Canon DR-S150, LAN/WIFI/USB, Duplex, Display Touch - 4044C011AA

Scanner de Mesa Canon DR-S150, LAN/WIFI/USB, Duplex, Display Touch - 4044C011AA

Ver descrição completa | Canon

★★★★☆ [Avaliar produto](#)

Vendido por **KaBum!**
Entregue por **MAGALU**
Empresa do **Grupo Magalu** que garante sua compra do pedido à entrega.

R\$ 3.388,88¹
R\$ 3.049,99

no PIX (10% de desconto)
ou 10x de R\$ 338,89 sem juros


[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 3.388,88
10x R\$ 338,89

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACUDA](#)

[Calcular frete e prazo](#)

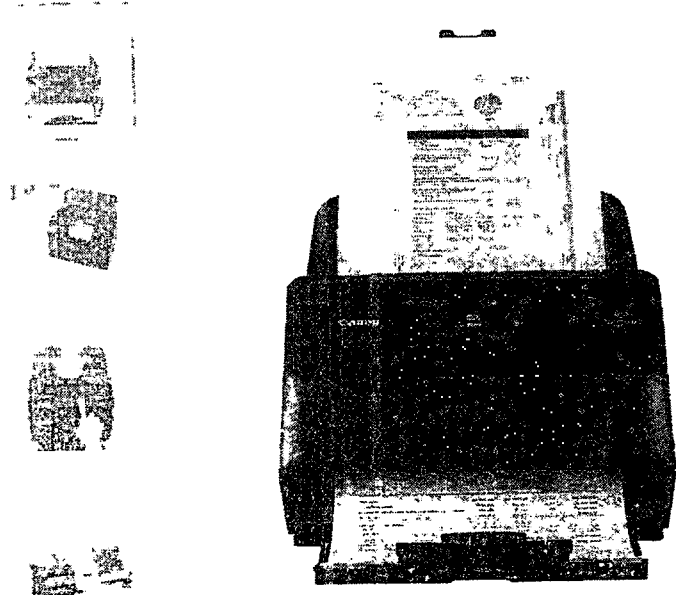

Características do Produto

Scanner de Mesa Canon DR-S150, LAN/WIFI/USB, Duplex, Display Touch - 4044C011AA

O scanner de Mesa Canon DR-S150, LAN/WIFI/USB, Duplex, Display Touch O scanner DR-S150 é ideal para uso por grupos de trabalho ou usuários individuais em muitos negócios, incluindo serviços financeiros, saúde, serviços jurídicos, seguros e muito mais. Pode ser usado para modernizar ou automatizar processos de negócios e reduzir o papel ajudando a otimizar os fluxos de trabalho e a reduzir os custos. O DR-S150 também pode fazer parte de um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos ou ECM, integrando-se com os sistemas back-end existentes, permitindo um gerenciamento de informações mais eficiente e conformidade. **Digitalização e Wi-Fi** O Canon imageFORMULA DR-S150 é um scanner de documentos flexível e fácil de usar. Com Wi-Fi integrado, conexões de rede com fio e USB. **Facilidade de uso** O scanner seja usado com computadores desktop, smartphones ou tablets compatíveis, e compartilhado entre vários usuários. Seu painel colorido e intuitivo facilita a seleção de destinos ou atalhos. **Fácil Uso Foi projetado** com um painel de toque LCD, grande, colorido e com uma interface de usuário intuitiva. Até 99 atalhos de digitalização podem ser predefinidos como atalhos, usando o software CaptureOnTouch incluído, e executados diretamente do painel. Para facilitar a manutenção as notificações de erros potenciais e substituição dos roletes aparecerão na tela LCD, permitindo que os usuários ou administradores resolvam os problemas rapidamente. **Desempenho Poderoso** Pode digitalizar os dois lados de um item numa única passagem, colorido e em até 45 páginas por minuto. Com capacidade para até 60 folhas no Alimentador Automático de Documentos (ADF), o scanner DR-S150 pode processar documentos e outras mídias de maneira eficiente e inteligente. A CPU de processamento de imagem integrada funciona independentemente do desempenho do computador conectado, para que os documentos sejam digitalizados em informações digitais com rapidez e precisão. **Importante:** Este produto poderá ser enviado em até 15 dias após a confirmação da compra

Fabricante: Canon

[Denunciar Anuncio](#)




Scanner

Scanner Olha só os tipos

[Scanner Olha só os tipos](#)

Verifique qual que serve cada um deles

961/35/136

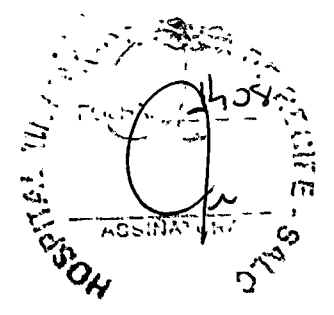

Handwritten signature

Clique no botão ao lado para assistir o vídeo relacionado ao produto.

- [Veja vídeo](#)
- [Lista de Desejos](#)
- [Comprar](#)
- [SCANNERS](#)
- [Rede | Network](#)

Scanner de Rede Canon DR-S150

Código: 8572KEKZJ Marca: Canon

~~R\$ 3.586,00~~ R\$ 3.240,00

até 10x de R\$ 324,00 sem juros

ou R\$ 2.980,80 via Pagamento na entrega

Compre Estoque: Disponível

Parcelas

- 1x de R\$ 3.240,00 sem juros
- 2x de R\$ 1.620,00 sem juros
- 3x de R\$ 1.080,00 sem juros
- 4x de R\$ 810,00 sem juros
- 5x de R\$ 648,00 sem juros
- 6x de R\$ 540,00 sem juros
- 7x de R\$ 462,85 sem juros
- 8x de R\$ 405,00 sem juros
- 9x de R\$ 360,00 sem juros
- 10x de R\$ 324,00 sem juros

- R\$ 2.980,80
- R\$ 2.980,80
- R\$ 2.980,80

Calcule o frete

CEP

OK

[Ver mais CEP](#)

Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

SCANNER CANON imageFORMULA DR-S150

Scanner de elevado desempenho com conectividade de rede flexível.

Para empresas de todas as dimensões, o compacto scanner Canon imageFORMULA DR-S150 oferece conectividade de rede e USB, assim como uma tela LCD tátil, colorida, para proporcionar um funcionamento simples e intuitivo.

Américas - material escolar com até 30% de desconto - queeero >

busque aqui seu produto




ou faça seu login ou cadastre-se

fixe o app entrega rápida nossas lojas arte digital marcas próprias lojas

departamentos: eletrônicos celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis

scanner scanner de mesa

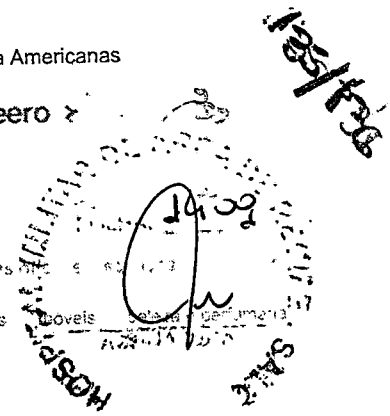

Scanner de mesa canon DR-S150 USB preto - 4044C011AA

[faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Scanner de mesa canon DR-S150 USB preto - 4044C011AA. scanner de mesa canon DR-S150 USB preto - 4044C011AA. Características: - Marca: Canon - Modelo: DR-S150 - Especificações: - Tipo: Scanner de secretária com alimentação automática...

[mais informações](#)

cor: preto

voltagem: bivolt

[política de troca e devolução](#)

R\$ 2.799,00


até 6x de R\$ 349,87

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

Digite seu CEP: 50610-


⚠ Cálculo de frete indisponível no momento.

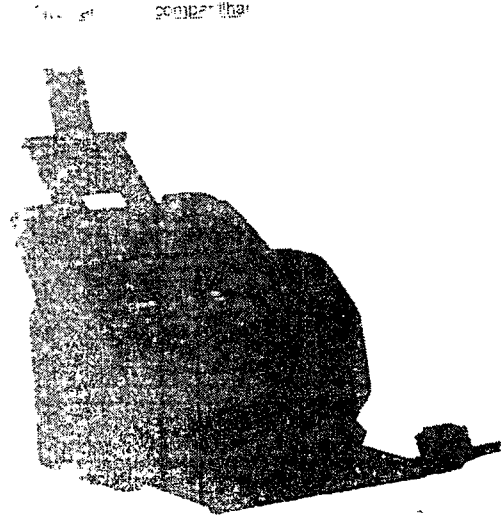

Scanner de mesa canon DR-S150 USB preto - 4044C011AA - imagem 1	Scanner de mesa canon DR-S150 USB preto - 4044C011AA - imagem 2	Scanner de mesa canon DR-S150 USB preto - 4044C011AA - imagem 3
---	---	---

Este produto é vendido por **MMSANTOS** e entregue por Americanas, que garante a sua compra do pedido à entrega **salvo** mas.

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Sim Sim 1 R\$ 3.720,0000 R\$ 3.720,0000 28/01/2022 16:48:50
Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo / Versão: AOC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 60 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLER REMOTO/SLEEP, TIME/VHF/UHF E TV A CABO
Porte da empresa: ME/EPP

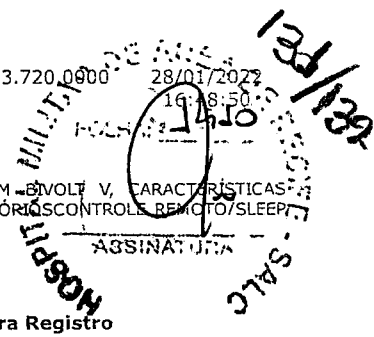

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance R\$ 3.720,0000
CNPJ/CPF 31.131.938/0001-74
Data/Hora Registro 31/01/2022 08:00:01:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	31/01/2022 08:17:22	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/01/2022 08:48:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/01/2022 09:06:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	31/01/2022 09:06:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R\$ 3.720,0000.
Encerramento	31/01/2022 09:11:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	31/01/2022 09:11:49	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	01/02/2022 08:52:26	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 3.720,0000. Motivo: O fornecedor não enviou proposta adequada ao último lance ofertado.
Cancelado no julgamento	09/02/2022 14:45:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: O fornecedor não enviou proposta adequada ao último lance ofertado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Televisor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLER REMOTO/SLEEP, TIME/VHF/UHF E TV A CABO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.030,0000	R\$ 2.030,0000	28/01/2022 16:48:54
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: 42G52RCF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 42 PHILCO 42G52RCF Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.036,1800	R\$ 2.036,1800	28/01/2022 10:44:27

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)


Valor do Lance R\$ 2.036,1800
CNPJ/CPF 05.462.543/0001-44
Data/Hora Registro 31/01/2022 08:00:01:010
 R\$ 2.030,0000 31.131.938/0001-74 31/01/2022 08:00:01:010
 R\$ 2.020,0000 05.462.543/0001-44 31/01/2022 08:54:13:360
 R\$ 2.000,0000 31.131.938/0001-74 31/01/2022 09:03:28:693
 R\$ 2.019,0000 05.462.543/0001-44 31/01/2022 09:08:07:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	31/01/2022 08:17:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/01/2022 08:48:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/01/2022 09:07:33	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	31/01/2022 09:07:33	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2.000,0000 e R\$ 2.020,0000.
Encerramento	31/01/2022 09:12:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	31/01/2022 09:12:34	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	01/02/2022 08:52:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: O fornecedor não enviou proposta adequada ao último lance ofertado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 13:54:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 14:21:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Aceite de proposta	02/02/2022 09:01:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.019,0000.
Habilitação de fornecedor	08/02/2022 14:19:04	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.019,0000.

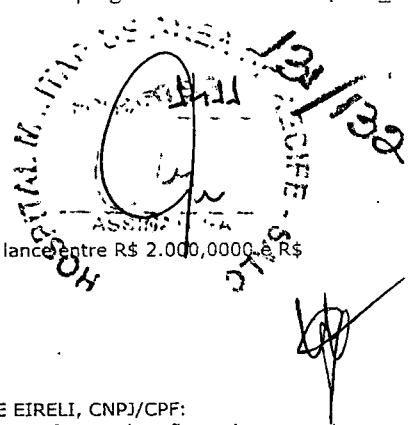

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Refrigerador Doméstico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	31/01/2022 07:44:19

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: CRB36AB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - capacidade 300, voltagem 110V OU 220V, características adicionais Frost Free, cor branca, tipo vertical.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.800,0000	42.262.411/0001-03	31/01/2022 08:00:01:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	31/01/2022 08:17:52	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/01/2022 08:49:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/01/2022 09:12:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	31/01/2022 09:12:47	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R\$ 2.800,0000.
Encerramento	31/01/2022 09:17:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	31/01/2022 09:17:48	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/01/2022 14:13:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/01/2022 15:13:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Recusa de proposta	01/02/2022 08:38:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: O valor está acima do estimado e fornecedor não tem como atender ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	09/02/2022 14:45:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: O fornecedor não enviou proposta adequada ao último lance ofertado.


Não existem intenções de recurso para o item





MINISTÉRIO DA DEFESA
 COMANDO DA MARINHA
 Diretoria-Geral de Navegação
 Diretoria de Portos e Costas
 Centro de Instrução Almirante Graça Aranha

752100.54203.14987.47454.270873.004

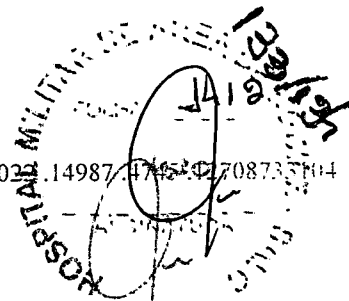

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00054/2022

As 09:00 horas do dia 11 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 46 de 30/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 63094001583202228, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00054/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, a fim de implementar um Simulador de realidade virtual e atualizar o Simulador de Máquinas no CIAGA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Microcomputador

Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Slim , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 36 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 69.386,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 42.450,0000 .

Item: 2

Descrição: Microcomputador

Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Slim , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 36 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.346,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10.950,0000 e com valor negociado a R\$ 10.612,5000 .

Item: 3

Descrição: Microcomputador

Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Slim , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 36 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.910,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não


Aceito para: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.930,0000 .

Item: 4



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Manaus

160013.22022.32278 4865-4691-0096302

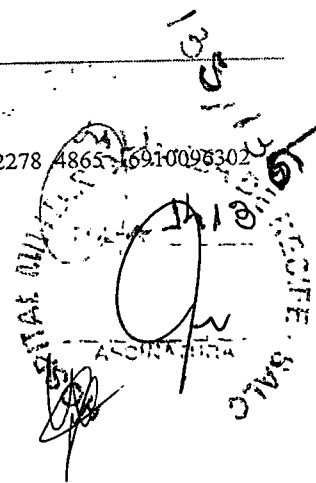

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2022 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI 038 de 23/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64255002044202289, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material permanente para as salas de apoio ao ensino do Colégio Militar de Manaus. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes imediatamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado-Aparelho

Descrição Complementar: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 11.175,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: EXCELLENCE COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.367,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 2

Descrição: Equipamento / Componente - Refrigeração

Descrição Complementar: CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 48.000 BTU/H, CICLO REVERSO, TIPO SPLIT PISO/TETO, UNIDADE CONDENSADORA DE DESCARGA VERTICAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO. ALIMENTAÇÃO 380V, 3 FASES, 50HZ. ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE, NO MÍNIMO CLASSE _C_. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 9.081,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 3

Descrição: Ar Condicionado-Aparelho

Descrição Complementar: CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 36.000 BTU/H, CICLO REVERSO (QUEM É FRIO), TENSÃO 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR ROTATIVO/SCROLL, COM GÁS REFRIGERANTE R410A. INSTALAÇÃO E MATERIAIS INCLUSA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 6.767,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 4

Descrição: Ar Condicionado-Aparelho

Descrição Complementar: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO BI SPLIT MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 3.051,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: R G XAVIER GUIMARAES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.790,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 5

Descrição: Ar Condicionado-Aparelho

comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

VISTO:



FISCAL ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

PREGÃO TRADICIONAL Nº 01/2023
(Processo Administrativo n.º 64583.010437/2022-44)

Requisição n.º 04/2022 – ALMOXARIFADO

Recife-PE, 23 de Maio de 2023.


Do Chefe do Almoarifado
Ao Fiscal Administrativo
Assunto: Aquisição de material de Permanente
Anexo: Mapa Comparativo

Nos termos do contido no art. 13 da Portaria Ministerial n.º 305/95 (IG12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material Permanente , conforme tabela abaixo:

1. Objeto

Nº DO ITEM	C A T M A T	D E S C R I Ç Ã O	U N I D A D E	R E Q U I S I Ç Ã O M Í N I M A	R E Q U I S I Ç Ã O M Á X I M A	T O T A L H M A R	V A L. U N I T Á R I O M Á X I M O	V A L. T O T A L M Á X I M O	E X C L U S I V I D A D E M E / E P P
2º/4ª UI									

9	442491	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Balança eletrônica, capacidade pesagem: 300 kg, voltagem: 110/220 v, características adicionais: plataforma em chapa aço pintado, célula de carga, tipo: digital, número dígitos: 6, dimensões: 60 x 75 cm.	ADULTO	Und	01	01	01	RS 1.652,14	RS 1.652,14	N (E S T E P E)
10	442491	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Balança eletrônica, capacidade pesagem: 300 kg, voltagem: 110/220 v, características adicionais: plataforma em chapa aço pintado, célula de carga, tipo: digital, número dígitos: 6, dimensões: 60 x 75 cm.	ADULTO	Und	01	01	01	RS 1.652,14	RS 1.652,14	X
SUBTOTAL - 2ª/4ª UI									RS 1.652,14	
1ª UI, 2ª/4ª UI, 8ª UI										
17	457135	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Balança antropométrica digital. Material concha: Polipropileno Material gabinete: Plástico abs. Material estrutura interna: Aço carbono bicromatizado. Material pés: Borracha sintética Fonte de alimentação: Externa 90 a 240Vac chaveamento automático Consumo: 08VA Display: Led vermelho. Dígitos display: 6 Divisão: 10g; Concha anatômica: Sim; Concha anti-germes: Sim; Indicação de função: Sim; Função tara: Sim; Homologada inmetro: Sim. Faixa de medição antropométrica: 0 a 54 cm. Capacidade: 30 Kg; Carga mínima: 200g. Dimensões display: 1,42 x 0,8 cm (a x l); Dimensões concha: 29 x 54 cm (l x c).	PEDIÁTRICA	Und	01	02	02	RS 1.652,14	RS 2.193,48	X
18	457135	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Balança antropométrica digital. Material concha: Polipropileno Material gabinete: Plástico abs. Material estrutura interna: Aço carbono bicromatizado. Material pés: Borracha sintética Fonte de alimentação: Externa 90 a 240Vac chaveamento automático Consumo: 08VA Display: Led vermelho. Dígitos display: 6 Divisão: 10g; Concha anatômica: Sim; Concha anti-germes: Sim; Indicação de função:	PEDIÁTRICA	Und	01	02	02	RS 1.652,14	RS 2.193,48	N (E S T E P E)

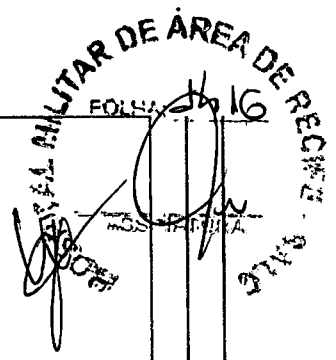

Sim; Função tara: Sim; Homologada inmetro: Sim. Faixa de medição antropométrica: 0 a 54 cm. Capacidade: 30 Kg; Carga mínima: 200g. Dimensões display: 1,42 x 0,8 cm (a x l); Dimensões concha: 29 x 54 cm (l x c).

SUBTOTAL - 1ª UI, 2ª/4ª UI, 8ª UI **RS 2.193,48**

2ª/4ª UI e 9ª UI

19	422565	<p>MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: - Monitor de sinais vitais para triagem com no mínimo as seguintes características:- Tela de alta definição com diagonal maior ou igual a 5,7" touch screen - Para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, nos parâmetros de Saturação de Oxigênio (SpO2), Frequência de Pulso (FP), Pressão não invasiva (PNI) e Temperatura;- Deve Possibilitar o armazenamento de dados e envio para prontuário eletrônico via rede e/ou Wi-fi; - Deve apresentar os valores numéricos de SpO2, FP, Temperatura e pressão sistólica, diastólica e média;- Deve apresentar índice de perfusão de SPO2;- Deve possibilitar a inclusão de protocolo de alerta precoce (Mews) - Deve possuir bateria recarregável, com autonomia mínima de 4 horas e carregador de bateria incorporado: - Deve pesar, no máximo, 2, 5 kg (10% de tolerância); - Deve possuir alça incorporada para situações de transporte. - Oximetria de Pulso: Deve apresentar índice de perfusão; Faixa de medida de SpO2: 10 a 100%; Faixa de medida de FP: 40 a 240 BPM; Acessórios: 01 extensão para sensor de SpO2, 1 sensor de SpO2 reutilizável adulto, tipo "clipe" Pressão não invasiva: Modo de operação mínimos: Manual; Faixa de medida de: 13 a 270 mmHg; Proteção para evitar insuflação acima de 330 mmHg; Acessórios: 01 mangueira de PNI, 1 manguito adulto; Temperatura: Modos de operação mínimos: Ajustado ou direto; Faixa de medida de: 26°C a 43°C no modo ajustado através de tecnologia axilar e/ou sublingual - Deve acompanhar carro para transporte (trolley) em estrutura tubular com no mínimo 04 rodízios giratórios de 2" e pintura eletrostática em epóxi pó, além de cesta/bandeja para guarda de acessórios; - Equipamento deve possuir parecer favorável do Serviço de Engenharia Clínica da AHLVF ou submeter amostra para aprovação prévia; - Alimentação da rede elétrica bivolt automático (110V - 220V). Com</p>	Und	01	02	02	RS 10.757,44	RS 21.514,88	N (E S T E P E)
----	--------	---	-----	----	----	----	--------------	--------------	---


AL. MILITAR DE ÁREA DE
 FOLHA: 2617
 ASSINATURA
 07/10/2017

		cadastro/registo Anvisa e certificação INMETRO.								
20	422565	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: - Monitor de sinais vitais para triagem com no mínimo as seguintes características:- Tela de alta definição com diagonal maior ou igual a 5,7" touch screen - Para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, nos parâmetros de Saturação de Oxigênio (SpO2), Frequência de Pulso (FP), Pressão não invasiva (PNI) e Temperatura;- Deve Possibilitar o armazenamento de dados e envio para prontuário eletrônico via rede e/ou Wi-fi; - Deve apresentar os valores numéricos de SpO2, FP, Temperatura e pressão sistólica, diastólica e média;- Deve apresentar índice de perfusão de SPO2;- Deve possibilitar a inclusão de protocolo de alerta precoce (Mews) - Deve possuir bateria recarregável, com autonomia mínima de 4 horas e carregador de bateria incorporado; - Deve pesar, no máximo, 2, 5 kg (10% de tolerância); - Deve possuir alça incorporada para situações de transporte. - Oximetria de Pulso: Deve apresentar índice de perfusão; Faixa de medida de SpO2: 10 a 100%; Faixa de medida de FP: 40 a 240 BPM; Acessórios: 01 extensão para sensor de SpO2, 1 sensor de SpO2 reutilizável adulto, tipo "clipe" Pressão não invasiva: Modo de operação mínimos: Manual; Faixa de medida de: 13 a 270 mmHg; Proteção para evitar insuflação acima de 330 mmHg; Acessórios: 01 mangueira de PNI, 1 manguito adulto; Temperatura: Modos de operação mínimos: Ajustado ou direto; Faixa de medida de: 26°C a 43°C no modo ajustado através de tecnologia axilar e/ou sublingual - Deve acompanhar carro para transporte (trolley) em estrutura tubular com no mínimo 04 rodízios giratórios de 2" e pintura eletrostática em epóxi pó, além de cesta/bandeja para guarda de acessórios; - Equipamento deve possuir parecer favorável do Serviço de Engenharia Clínica da AHLVF ou submeter amostra para aprovação prévia; - Alimentação da rede elétrica bivolt automático (110V - 220V). Com cadastro/registo Anvisa e certificação INMETRO.	Und	01	01	02	RS 10.757,44	RS 21.514,88		X
SUBTOTAL - 2ª/4ª UI e 9ª UI								RS 21.514,88		
CLÍNICA RADIOLÓGICA										
27	449554	APARELHO DE RAIOS X FIXO ANALÓGICO. Conjunto Radiológico Fixo Equipamento de raios-X compacto,	Und	01	01	01	RS 133.206,33	RS 133.206,33		X

permitindo radiografias de crânio, tórax, coluna, abdômen e extremidades com as seguintes características: Conjunto Gerador: Microprocessado em alta frequência de no mínimo 20 KHz; Potência mínima de 54 kW; Variação de Tensão de no mínimo 40 a 150 kV; Faixa mínima de mAs: 1 a 800 mAs Corrente máxima de no mínimo 600 mA; Tensão de alimentação: 380 V – 50/60 Hz; Dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede; Sistema de disparo em dois estágios; Software para detecção de falhas com indicação no display de comando; Dissipação de calor no interior da mesa de exames por meio forçado (ventilador interno); Gerador em conformidade com as normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-2-7 :2001; NBR IEC 60601-2-28:2001; NBR IEC 60601-2-32:2001; Circuitos de segurança: Sobrecarga de aquecimento no tubo Rotação do anodo do tubo Falha de filamento do tubo, Sobrecarga de corrente do tubo; Painel de comando: Técnica de comando de livre seleção dos parâmetros com indicação digital; Indicação de código de erros no comando; Seleção dos níveis de pelo menos KV e mAs por meio de teclas;

Mesa de exames: Tampo flutuante nos quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados por pedal; Tampo flutuante com movimentos longitudinal e transversal; Largura do tampo de no mínimo 80 cm; Comprimento do tampo de no mínimo 200 cm; Deslocamento transversal do tampo de no mínimo ± 10 cm (20cm); Deslocamento longitudinal do tampo de no mínimo ± 34 cm (68cm); Freios eletromagnéticos com liberação por pedal; Grades com razão mínima de 10:1; 103 linhas/pol e ponto focal com variação de 100 a 180cm; Possibilidade de inserção de cassetes nos tamanhos de 13x18cm até 35x43cm; Peso do paciente mínimo suportado pela mesa de 200kg. Estativa Porta-tubo: Sem necessidade de fixação ao teto ou parede; Estativa fixa: Rotação do braço porta tubo

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE ESPECIFIC. SAO PAULO
FOLHA: 24/17
ASSINATURA



[Handwritten signature]

de $\pm 90^\circ$; Rotação do conjunto tubo/colimador de RX em $\pm 175^\circ$; Dispositivo de segurança no movimento vertical; Distância foco-filme mínima de 100 cm; Deslocamento longitudinal da estativa de no mínimo 180 cm. Mural Bucky: Grade anti-difusora com razão mínima de 10:1, com no mínimo 103 linhas/cm; Utilização de chassis de 13x18 até 35x43 cm; Freios mecânicos ou eletromagnéticos; Deslocamento vertical de no mínimo 120 cm.

Tubo de raios X Cúpula de alta capacidade térmica, com proteção contra superaquecimento; Capacidade térmica do anodo de pelo menos 300.000 IU; Capacidade térmica de dissipação do conjunto emissor de pelo menos 1.250.000 HU; Rotação do anodo de no mínimo de 9.000 RPM. Foco fino de 0,6 mm ou menor e foco grosso de 1,2 mm ou menor; Potência referência do foco de 18 kW/50kW ou melhor Acessórios: Par de cabos de alta tensão conforme a norma brasileira; Certificação independente para colimador de acordo com as normas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-3, IEC 60601522 Luminosidade a 100 cm: 160 lux Filtragem equivalente de alumínio: 2mm Al. Condições Gerais: Garantia mínima de 12 meses para todos os itens; Montagem e demonstração de funcionamento inclusos; Registro no Ministério da Saúde/vigilância Sanitária; Certificação NBR 60601 em laboratório credenciado pelo Inmetro A empresa deve possuir Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento.

28	449554	APARELHO DE RAIOS X FIXO ANALÓGICO. Conjunto Radiológico Fixo Equipamento de raios-X compacto, permitindo radiografias de crânio, tórax, coluna, abdômen e extremidades com as seguintes características: Conjunto Gerador: Microprocessado em alta frequência de no mínimo 20 KHz; Potência mínima de 54 kW; Variação de Tensão de no mínimo 40 a 150 kV; Faixa mínima de mAs: 1 a 800 mAs Corrente máxima de no mínimo 600 mA; Tensão	Und	01	01	01	RS 114.925,00	RS 114.925,00	N (E S T E P E)
----	--------	---	-----	----	----	----	------------------	------------------	---

[Handwritten signature]

de alimentação: 380 V – 50/60 Hz; Dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede; Sistema de disparo em dois estágios; Software para detecção de falhas com indicação no display de comando; Dissipação de calor no interior da mesa de exames por meio forçado (ventilador interno); Gerador em conformidade com as normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-2-7 :2001; NBR IEC 60601-2-28:2001; NBR IEC 60601-2-32:2001; Circuitos de segurança: Sobrecarga de aquecimento no tubo Rotação do anodo do tubo Falha de filamento do tubo, Sobrecarga de corrente do tubo; Painel de comando: Técnica de comando de livre seleção dos parâmetros com indicação digital; Indicação de código de erros no comando; Seleção dos níveis de pelo menos KV e mAs por meio de teclas; Mesa de exames: Tampo flutuante nos quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados por pedal; Tampo flutuante com movimentos longitudinal e transversal; Largura do tampo de no mínimo 80 cm; Comprimento do tampo de no mínimo 200 cm; Deslocamento transversal do tampo de no mínimo ± 10 cm (20cm); Deslocamento longitudinal do tampo de no mínimo ± 34 cm (68cm); Freios eletromagnéticos com liberação por pedal; Grades com razão mínima de 10:1; 103 linhas/pol e ponto focal com variação de 100 a 180cm; Possibilidade de inserção de cassetes nos tamanhos de 13x18cm até 35x43cm; Peso do paciente mínimo suportado pela mesa de 200kg. Estativa Porta-tubo: Sem necessidade de fixação ao teto ou parede; Estativa fixa; Rotação do braço porta tubo de $\pm 90^\circ$; Rotação do conjunto tubo/colimador de RX em $\pm 175^\circ$; Dispositivo de segurança no movimento vertical; Distância foco-filme mínima de 100 cm; Deslocamento longitudinal da estativa de no mínimo 180 cm. Mural Bucky: Grade anti-difusora com razão mínima de 10:1, com no mínimo 103 linhas/cm; Utilização de chassis de 13x18 até 35x43 cm; Freios mecânicos

HOSPITAL MILITAR DE ÁREAS DISTINTAS
 FOLHA Nº 121
 ASSINATURA

ou eletromagnéticos; Deslocamento vertical de no mínimo 120 cm.
 Tubo de raios X Cúpula de alta capacidade térmica, com proteção contra superaquecimento; Capacidade térmica do anodo de pelo menos 300.000 HU; Capacidade térmica de dissipação do conjunto emissor de pelo menos 1.250.000 HU; Rotação do anodo de no mínimo de 9.000 RPM. Foco fino de 0,6 mm ou menor e foco grosso de 1,2 mm ou menor; Potência referência do foco de 18 kW/50kW ou melhor Acessórios: Par de cabos de alta tensão conforme a norma brasileira; Certificação independente para colimador de acordo com as normas: IEC 60601-1, IEC 60601-1- 2, IEC 60601-1-3, IEC 60601522 Luminosidade a 100 cm: 160 lux Filtragem equivalente de alumínio: 2mm Al. Condições Gerais: Garantia mínima de 12 meses para todos os itens; Montagem e demonstração de funcionamento inclusos; Registro no Ministério da Saúde/ vigilância Sanitária; Certificação NBR 60601 em laboratório credenciado pelo Inmetro A empresa deve possuir Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento.

SUBTOTAL - CLÍNICA RADIOLÓGICA **RS 133.206,33**

UTI/UCF

39	404168	ELETROCARDIOGRAFO: Eletrocardiógrafo com tela de no mínimo de 7 polegadas LCD, 800x480 pixels, em papel A4, com registrador térmico incorporado, permite a visualização de todas as 12 derivações de ECG, com impressão em papel A4. Mínimo armazenamento de 400 relatórios de ECG . com possibilidade de transferi -lo para um computador através de um pen drive ou conexão direta a um Servidor FTP, seja por cabo ou rede WiFi . Permitir admissão do paciente. incluir informações como idade, sexo, raça, medicações e classe . - Configuração com 12 derivações simultâneas em 12 canais com Algoritmo Glasgow (Interpretação de ECG); Cabo paciente, 12 derivações AHA, grampo, à prova de desfibrilação. Bateria de Lítio recarregável; Até 5Kg (unidade principal	Und	01	02	02	RS 6.866,48	RS 13.732,96	N (E S T E P E)
----	--------	---	-----	----	----	----	--------------------	---------------------	---

[Handwritten signature]

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RE...
 FOLHA 1499
 ASSOC. JURA

[Handwritten signature]

		com bateria e registrador, sem acessórios e papel). Temperatura Operação: 0 ° C a 40 ° C. Transporte / armazenamento: -20 ° C a 60 ° C. Autonomia de bateria de no mínimo 3.5hrs de registro contínuo, sem impressão; ou no mínimo 1 hora de registro contínuo, com impressão; ou no mínimo 400 registros automáticos de ECG, com impressão. Modos de medição: Automático, Manual, Ritmo. Amplitude de pelo menos 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, automático. Velocidade de Varredura de pelo menos 5 mm/s, 10 ou 12,5 mm/s. 25 mm/s, 50mm/s, Filtro de Linha de Base (BDR): 0,56 Hz, Filtro de Tremor / Artefato Muscular de pelo menos 25Hz e 35 Hz, abrangendo valores menores que 25Hz e maiores que 35 Hz . Resposta de Frequência: 0,05 Hz a 150 Hz. Proteção: Suportar descargas elétricas de um desfibrilador a 360 J, 5000 V. Tempo de recuperação após desfibrilação no mínimo de 5 s (linha de base); Com Indicação do Pulso de Marcapasso.							
40	404168	ELETROCARDIOGRAFO: Eletrocardiógrafo com tela de no mínimo de 7 polegadas LCD, 800x480 pixels, em papel A4, com registrador térmico incorporado, permite a visualização de todas as 12 derivações de ECG, com impressão em papel A4. Mínimo armazenamento de 400 relatórios de ECG , com possibilidade de transferi -lo para um computador através de um pen drive ou conexão direta a um Servidor FTP, seja por cabo ou rede WiFi . Permitir admissão do paciente, incluir informações como idade, sexo, raça, medicações e classe . - Configuração com 12 derivações simultâneas em 12 canais com Algoritmo Glasgow (Interpretação de ECG); Cabo paciente, 12 derivações AHA, grampo, à prova de desfibrilação. Bateria de Lítio recarregável; Até 5Kg (unidade principal com bateria e registrador, sem acessórios e papel). Temperatura Operação: 0 ° C a 40 ° C. Transporte / armazenamento: -20 ° C a 60 ° C. Autonomia de bateria de no mínimo 3,5hrs de registro contínuo, sem impressão; ou no mínimo 1 hora de registro contínuo, com impressão; ou no mínimo 400 registros automáticos de	Und	01	02	02	RS 6.866,48	RS 13.732,96	X

[Handwritten signature]

ECG, com impressão. Modos de medição: Automático, Manual, Ritmo. Amplitude de pelo menos 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, automático. Velocidade de Varredura de pelo menos 5 mm/s, 10 ou 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s, Filtro de Linha de Base (BDR): 0,56 Hz, Filtro de Tremor / Artefato Muscular de pelo menos 25Hz e 35 Hz, abrangendo valores menores que 25Hz e maiores que 35 Hz. Resposta de Frequência: 0,05 Hz a 150 Hz. Proteção: Suportar descargas elétricas de um desfibrilador a 360 J, 5000 V. Tempo de recuperação após desfibrilação no mínimo de 5 s (linha de base); Com Indicação do Pulso de Marcapasso.

[Handwritten signature]

41	422565	MONITOR DE SINAIS VITAIS: Monitor de sinais vitais com no mínimo as seguintes características: - Em conformidade com o padrão HL7; Tela de alta definição em diagonal ou vertical maior ou igual a 7" Touch screen ou através de botões de navegação em membranas iconográficas - Para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, nos parâmetros de Saturação de Oxigênio (SpO2), Frequência de Pulso (FP), Pressão não invasiva (PNI) e Temperatura; - Deve Possibilitar o armazenamento de dados e envio para prontuário eletrônico via rede e/ou Wi -fi; - Deve apresentar os valores numéricos de SpO2, FP, Temperatura e pressão sistólica, diastólica e média; - Deve apresentar índice de perfusão de SPO2; - Deve permitir a visualização em tela dos registros de pontuação por paciente; Deve possibilitar a inclusão de 3 ou mais protocolos de alerta precoce (Ex.: Mews, News, Sepse, Glasgow...)- Deve sinalizar em tela pontuação de gravidade (Escore); Deve possuir bateria recarregável, com autonomia mínima de 6 horas (bateria em lítio); - Deve pesar, no máximo, 2, 5 kg (10% de tolerância); - Deve possuir alça incorporada para situações de transporte. - Oximetria de Pulso: Deve apresentar índice de perfusão; Faixa de medida de SpO2: 10 a 100%; Faixa de medida de FP: 40 a 240 BPM; Acessórios: 01 extensão para sensor de SpO2, 1 sensor de SpO2	Und	01	01	01	RS 10.928,93	RS 10.928,93	X
----	--------	---	-----	----	----	----	--------------	--------------	---

[Handwritten signature]

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE - S.M.L.S.
 FOLHA: 24
 ASSINATURA

[Handwritten signature]

		reutilizável adulto, tipo "clip" Pressão não invasiva; Modo de operação mínimos: Manual; Faixa de medida de: 13 a 270 mmHg; Proteção para evitar insuflação acima de 330 mmHg; Acessórios: 01 mangueira de PNI, 1 manguito adulto; Temperatura: Modos de operação mínimos: Ajustado ou direto; Faixa de medida de: 26°C a 43°C no modo ajustado através de tecnologia axilar e/ou sublingual e/ou auricular e/ou temporal - Deve acompanhar carro para transporte (trolley) em estrutura tubular com no mínimo 05 rodízios giratórios de 2" e pintura eletrostática em epóxi pó, além de cesta/bandeja para guarda de acessórios; - Equipamento deve possuir parecer favorável do Serviço de Engenharia Clínica da AILVF ou submeter amostra para aprovação prévia; - Alimentação da rede elétrica bivolt automático (110V - 220V). Com cadastro/registro Anvisa e certificação INMETRO. Assistência técnica exclusiva em Recife.							
42	422565	MONITOR DE SINAIS* VITAIS: Monitor de sinais vitais com no mínimo as seguintes características: - Em conformidade com o padrão HL7; Tela de alta definição em diagonal ou vertical maior ou igual a 7" Touch screen ou através de botões de navegação em membranas iconográficas - Para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, nos parâmetros de Saturação de Oxigênio (SpO2), Frequência de Pulso (FP), Pressão não invasiva (PNI) e Temperatura; - Deve Possibilitar o armazenamento de dados e envio para prontuário eletrônico via rede e/ou Wi -fi; - Deve apresentar os valores numéricos de SpO2, FP, Temperatura e pressão sistólica, diastólica e média; - Deve apresentar Índice de perfusão de SPO2; - Deve permitir a visualização em tela dos registros de pontuação por paciente; Deve possibilitar a inclusão de 3 ou mais protocolos de alerta precoce (Ex.: Mews, News, Sepse, Glasgow...)- Deve sinalizar em tela pontuação de gravidade (Score); Deve possuir bateria recarregável, com autonomia mínima de 6 horas (bateria em lítio); - Deve pesar, no	Und	01	04	04	RS 10.928,93	RS 10.928,93	N (E S T E P E)

[Handwritten mark]

máximo, 2, 5 kg (10% de tolerância); - Deve possuir alça incorporada para situações de transporte. - Oximetria de Pulso: Deve apresentar índice de perfusão; Faixa de medida de SpO2: 10 a 100%; Faixa de medida de FP: 40 a 240 BPM; Acessórios: 01 extensão para sensor de SpO2, 1 sensor de SpO2 reutilizável adulto, tipo "clip" Pressão não invasiva: Modo de operação mínimos: Manual; Faixa de medida de: 13 a 270 mmHg; Proteção para evitar insuflação acima de 330 mmHg; Acessórios: 01 mangueira de PNI, 1 manguito adulto; Temperatura: Modos de operação mínimos: Ajustado ou direto; Faixa de medida de: 26°C a 43°C no modo ajustado através de tecnologia axilar e/ou sublingual e/ou auricular e/ou temporal - Deve acompanhar carro para transporte (trolley) em estrutura tubular com no mínimo 05 rodízios giratórios de 2" e pintura eletrostática em epóxi pó, além de cesta/bandeja para guarda de acessórios; - Equipamento deve possuir parecer favorável do Serviço de Engenharia Clínica da AHLVF ou submeter amostra para aprovação prévia; - Alimentação da rede elétrica bivolt automático (110V - 220V). Com cadastro/registro Anvisa e certificação INMETRO. Assistência técnica exclusiva em Recife.

[assinatura]

SUBTOTAL - UTI/UCE **R\$ 24.661,89**

47	421237	VENTILADOR INVASIVO PARA TRANSPORTE: VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA USO EM PACIENTES NEONATAIS. PEDIÁTRICOS E ADULTOS EM AMBULÂNCIAS E RESGATES DE EMERGÊNCIA. COM ALÇA DE TRANSPORTE. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO DE VOLUME CONTROLADO E ASSISTIDO (VCV); VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTROLADA E ASSISTIDA (PCV); VENTILAÇÃO POR PRESSÃO LIMITADA (PLV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE	Und	01	06	06	R\$ 47.427,35	R\$ 284.564,08	X
----	--------	--	-----	----	----	----	---------------	----------------	---

[assinatura]

SINCRONIZADA POR VOLUME COM PRESSÃO DE SUPORTE [SIMV (VCV) + PSV]; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA POR PRESSÃO SUPORTE [SIMV (PCV) + PSV]; CPAP; VENTILAÇÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS (APRV); VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA COM PRESSÃO DE SUPORTE (CPAP/PSV); VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI); VENTILAÇÃO CONTROLADA ACIONADA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE APNEIA. SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA DE DISPARO POR PRESSÃO E/OU FLUXO. MISTURADOR DE OXIGÊNIO COM O AR AMBIENTE. FLUXO INSPIRATÓRIO NA FAIXA MÍNIMA DE 1 A 100 L/MIN. VOLUME CORRENTE NA FAIXA MÍNIMA DE 10 A 2000 ML. TEMPO INSPIRATÓRIO NA FAIXA MÍNIMA DE 0.2 A 10 SEGUNDOS. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA NA FAIXA MÍNIMA DE 2 A 60 RPM. PEEP/CPAP NA FAIXA MÍNIMA DE 0 A 20 CMH₂O. PRESSÃO DE SUPORTE NA FAIXA MÍNIMA DE 0 A 35 CMH₂O; CONCENTRAÇÃO DE O₂ 40 A 100%. SISTEMA DE ALARMES PARA: MÁXIMA E MÍNIMA DE PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ALTA; VOLUME MINUTO ALTO; VOLUME MINUTO BAIXO; APNEIA; VENTILADOR INOPERANTE; DESCONEXÃO DO CIRCUITO; FALHA ELÉTRICA; FALHA NO SUPRIMENTO DE GASES; BATERIA FRACA. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO PARA: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; MODO VENTILATÓRIO; VOLUME MINUTO INSPIRADO E EXPIRADO; PRESSÃO DE PICO, MÉDIA E PEEP; VOLUME CORRENTE; RELAÇÃO I:E; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. DEVE APRESENTAR NA TELA DE MONITORAÇÃO AS CURVAS DE PRESSÃO X TEMPO E FLUXO X TEMPO. BATERIA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS DE DURAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: COMPATÍVEL COM REDE ELÉTRICA DE 220 V - 60 Hz. Acompanha: 03 Sensores de fluxo para pacientes neonatais; 03 Sensores de fluxo para pacientes pediátrico/adulto; 01

HOSPITAL MILITAR DE AEROSPAZ
FOLHA Nº 08
RECIFE - SALG





		mangueira de oxigênio; 01 umidificador aquecido com suporte; 03 circuitos paciente pediátrico/adulto; 03 circuitos paciente neonatal/pediátrico; 01 blender; 03 válvula de exalação. Cabo de alimentação no padrão abnt.							
48	421237	<p>VENTILADOR INVASIVO PARA TRANSPORTE: VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA USO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS EM AMBULÂNCIAS E RESGATES DE EMERGÊNCIA. COM ALÇA DE TRANSPORTE. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO DE VOLUME CONTROLADO E ASSISTIDO (VCV); VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTROLADA E ASSISTIDA (PCV); VENTILAÇÃO POR PRESSÃO LIMITADA (PLV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA POR VOLUME; COM PRESSÃO DE SUPORTE [SIMV (VCV) + PSV]; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA POR PRESSÃO SUPORTE [SIMV (PCV) + PSV]; CPAP; VENTILAÇÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS (APRV); VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA COM PRESSÃO DE SUPORTE (CPAP/PSV); VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI); VENTILAÇÃO CONTROLADA ACIONADA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE APNEIA. SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA DE DISPARO POR PRESSÃO E/OU FLUXO. MISTURADOR DE OXIGÊNIO COM O AR AMBIENTE. FLUXO INSPIRATÓRIO NA FAIXA MÍNIMA DE 1 A 100 L/MIN. VOLUME CORRENTE NA FAIXA MÍNIMA DE 10 A 2000 ML. TEMPO INSPIRATÓRIO NA FAIXA MÍNIMA DE 0,2 A 10 SEGUNDOS. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA NA FAIXA MÍNIMA DE 2 A 60 RPM. PEEP/CPAP NA FAIXA MÍNIMA DE 0 A 20 CMH2O. PRESSÃO DE SUPORTE NA FAIXA MÍNIMA DE 0 A 35 CMH2O; CONCENTRAÇÃO DE O2 40 A 100%. SISTEMA DE ALARMES PARA MÁXIMA E MÍNIMA DE PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ALTA; VOLUME MINUTO ALTO; VOLUME MINUTO</p>	Und	01	06	06	R\$ 47.427,35	R\$ 284.564,08	N (E S T E P E)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE
 A27
 ASSINATURA
 CALC

BAIXO; APNEIA; VENTILADOR INOPERANTE; DESCONEXÃO DO CIRCUITO; FALHA ELÉTRICA; FALHA NO SUPRIMENTO DE GASES; BATERIA FRACA. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO PARA: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; MODO VENTILATÓRIO; VOLUME MINUTO INSPIRADO E EXPIRADO; PRESSÃO DE PICO, MÉDIA E PEEP; VOLUME CORRENTE; RELAÇÃO I:E; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. DEVE APRESENTAR NA TELA DE MONITORAÇÃO AS CURVAS DE PRESSÃO X TEMPO E FLUXO X TEMPO. BATERIA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS DE DURAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: COMPATÍVEL COM REDE ELÉTRICA DE 220 V - 60 Hz. Acompanha: 03 Sensores de fluxo para pacientes neonatais; 03 Sensores de fluxo para pacientes pediátrico/adulto; 01 mangueira de oxigênio; 01 umidificador aquecido com suporte; 03 circuitos paciente pediátrico/adulto; 03 circuitos paciente neonatal/pediátrico; 01 blender; 03 válvula de exalação. Cabo de alimentação no padrão abnt.

49	433496	CARDIOVERSOR PORTÁTIL: Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa) e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos. Com os seguintes parâmetros básicos: ecg, spo2, temp, pni. Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 j, com indicação visual da carga selecionada: portátil, em corpo único, adequado ao uso hospitalar. Ter marca-passo transcutâneo integrado de corrente constante (pulso quadrado). Menu interno para configuração do equipamento, impressora térmica para impressão. Realizar cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo; indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor ou desfibrilador); pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo. Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada. Desfibrilação externa através das pás internas ou externas. Funcionalidade para uso tanto no modo	Und	01	02	02	RS 31.525,86	RS 63.051,71	X
----	--------	---	-----	----	----	----	--------------	--------------	---

manual, quanto no modo semi-automático, com mensagens de texto e voz em português. Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 segundos; anula carga manual/ente. Descarga automática dentro de 2 (dois) minutos se não for descarregado pelo operador. A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental. Indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado; monitor de ecg para acompanhamento visual dos sinais cardíacos. Display LCD. Apresentação numérica da frequência cardíaca na tela do monitor. Velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg. ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ecg. Velocidade de impressão do sinal de ecg que inclua a velocidade de 25 mm/seg; visualização das derivações de ecg com interpretação automática em português, Com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo. Alarmes de máximo e mínimo. Bateria recarregável e removível sem a necessidade de desmontagem do equipamento. Carregador de bateria interno ao aparelho. Alarme audiovisual de baixa carga da bateria. Indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total. O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período; Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; funcionamento tanto a bateria recarregável. Energia elétrica 220v - 60 hz automático. Acessórios: 01 (um) cabo ecg protegido contra interferências com 03 vias ou 05 vias; 08 (oito) pares de eletrodos multifunção adulto; 02 (dois) pares de eletrodos multifunção pediátrico; 05 (cinco) rolos de papel térmico; 01 (um) par de pás externas adulto/infantil

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE - SAIS
FOLHA Nº 02
ASSINATURA



HOSPITAL MILITAR DE JAGUARISSUNA
 FOLHA Nº 33
 ASSINATURA
 S.A.L.C.

		integradas; 01 cabo de alimentação. Alimentação elétrica 220v - 60 hz; cabo de alimentação no padrão ABNT. Equipamento deve seguir as normas ABNT NBR IEC 60601-1:2010; ABNT NBR IEC 60601-2-4:2010; ABNT NBR IEC 60601-2- 4:2005. IEC 60950-1 e IEC 60601-1.							
50	433496	<p>CARDIOVERSOR PORTÁTIL: Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa) e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos. Com os seguintes parâmetros básicos: ecg, spo2, temp, pni. Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 j, com indicação visual da carga selecionada; portátil, em corpo único, adequado ao uso hospitalar. Ter marca-passo transcutâneo integrado de corrente constante (pulso quadrado). Menu interno para configuração do equipamento, impressora térmica para impressão. Realizar cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo; indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor ou desfibrilador); pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo. Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada. Desfibrilação externa através das pás internas ou externas. Funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semi-automático, com mensagens de texto e voz em português. Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 segundos; anula carga manualmente. Descarga automática dentro de 2 (dois) minutos se não for descarregado pelo operador. A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental. Indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado; monitor de ecg para acompanhamento visual dos sinais cardíacos. Display LCD. Apresentação numérica da frequência cardíaca na tela do monitor. Velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25</p>	Und	01	02	02	R\$ 31.525,86	R\$ 63.051,71	N (E S T E P E)

[Handwritten mark]

HOSPITAL MILITAR DE ASSIS
 ASSIS - SP
 13200-000

mm/seg e 50 mm/seg. ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ecg. Velocidade de impressão do sinal de ecg que inclua a velocidade de 25 mm/seg; visualização das derivações de ecg com interpretação automática em português, Com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo. Alarmes de máximo e mínimo. Bateria recarregável e removível sem a necessidade de desmontagem do equipamento. Carregador de bateria interno ao aparelho. Alarme audiovisual de baixa carga da bateria. Indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total. O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período; Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; funcionamento tanto a bateria recarregável.

Energia elétrica 220v -- 60 hz automático. Acessórios: 01 (um) cabo ecg protegido contra interferências com 03 vias ou 05 vias; 08 (oito) pares de eletrodos multifunção adulto; 02 (dois) pares de eletrodos multifunção pediátrico; 05 (cinco) rolos de papel térmico; 01 (um) par de pás externas adulto/infantil integradas; 01 cabo de alimentação. Alimentação elétrica 220v - 60 hz; cabo de alimentação no padrão ABNT. Equipamento deve seguir as normas ABNT NBR IEC 60601-1:2010; ABNT NBR IEC 60601-2-4:2010; ABNT NBR IEC 60601-2- 4:2005. IEC 60950-1 e IEC 60601-1.

[Handwritten signature]

ASSINATURA

SUBTOTAL - UCE							R\$ 347.615,79		
UTI									
55	456628	MONITOR MULTIPARAMETRO MODULAR: Monitor Multiparamétrico para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes	Und	01	10	10	R\$ 41.632,57	R\$ 416.325,65	X

[Handwritten signature]

internas do equipamento, e com sistema modular para parâmetros vitais avançados; Possuir Módulos de Parâmetros Vitais com conexão tipo plug and play, ou seja, que conectem ao equipamento sem precisar de cabos e sem a necessidade de atualização/modificação de peças, partes e/ou softwares, e que além disto quando conectados diretamente ao equipamento formem, Monitor Multiparamétrico e Módulos de Parâmetros Vitais, um elemento único; Possuir, integrado ao equipamento ou em Módulo de Parâmetros Vitais único, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, DÉBITO CARDÍACO, e PRESSÃO INVASIVA EXTRA; Permitir ainda, através da adição de Módulos de Parâmetros Vitais, a monitorização dos seguintes parâmetros vitais avançados futuros: PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA, GASES ANESTÉSICOS, BIS e EEG; Permitir a conexão diretamente ao equipamento e visualização de forma simultânea de todos os parâmetros de monitorização vitais básicos e dos módulos adicionados. Possuir Alça de Transporte integrada ao equipamento; Possuir teclas e/ou botão rotacional que permita a programação de todos os parâmetros do equipamento; Possuir ajustes préprogramados através da seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal; Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e com tamanho de no mínimo 12 ; Possuir capacidade para apresentar simultaneamente na tela principal no mínimo 08 curvas de Parâmetros Vitais; Permitir o ajuste da velocidade do traçado de curva apresentado; Permitir o ajuste do ganho do traçado de curva apresentado; Permitir o ajuste do tamanho do valor dos parâmetros apresentados; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo as informações das últimas 48 horas; Permitir o ajuste dos limites, alto e baixo, para todos os parâmetros vitais monitorizados; Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros

[Handwritten signature]

FORÇA MILITAR DE AEROSPAZ
1993
1116

[Handwritten signature]

vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo os 50 últimos eventos de alarme, juntamente com seus respectivos traçados de curva; Possuir sistema de alarme audiovisual para os alarmes funcionais do equipamento, tais como: sensor desconectado, bateria fraca, etc.; Possuir tecla para interrupção temporária dos alarmes sonoros, com tempo de interrupção de no máximo 120 s; Características mínimas do sistema de monitorização de ECG: Possuir a monitorização de 07 derivações (I, II, III, aVR, AVL, AVF, V); Permitir a monitorização de 12 derivações (I, II, III, aVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento ou do módulo; Apresentar a medição da Frequência Cardíaca, com faixa de medição no mínimo de 30 a 300 bpm, resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo ± 1 bpm ou $\pm 1\%$ (o que for maior para a respectiva medida); Apresentar o traçado de curva das 07 (ou 12) derivações de ECG; Possuir sistema de análise gráfica de Segmentos ST; Possuir sistema que apresente pontuação de deterioração fisiológica; Possuir sistema de detecção de pulso de marca-passo; Possuir sistema de detecção de arritmias; Possuir sistema de alarme audiovisual para arritmias; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo os 50 últimos eventos de arritmia, juntamente com seus respectivos traçados de curva. Características mínimas do sistema de monitorização de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por tecnologia de detecção de bioimpedância transtorácica, através do cabo de ECG; Apresentar a medição da Frequência Respiratória, com faixa de medição no mínimo de 15 a 150 rpm, resolução de 1 rpm, e com precisão de no mínimo ± 2 rpm ou $\pm 2\%$ (o que for maior para a respectiva medida); Apresentar o traçado de curva da RESPIRAÇÃO; Possuir sistema de detecção de apneia; Possuir sistema de alarme audiovisual para apneia.

[Handwritten signature]


Características mínimas do sistema de monitorização de SPO2: Possuir monitorização por tecnologia Nellcor ou Masimo ou Similar; Apresentar a medição da Saturação de O2, com faixa de medição no mínimo de 10 a 100 %, resolução de 1 %, e com precisão de no mínimo ± 3 %; Apresentar a curva plestimográfica; Apresentar a medição da Frequência de Pulso, com faixa de medição no mínimo de 40 a 240 bpm, resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo ± 3 bpm. Características mínimas do sistema de monitorização de PRESSÃO NÃO INVASIVA: Possuir monitorização por tecnologia oscilométrica; Apresentar a medição da Pressão Arterial Sistólica, com faixa de medição no mínimo de 50 a 250 mmHg, resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo ± 5 mmHg; Apresentar a medição da Pressão Arterial Diastólica, com faixa de medição no mínimo de 20 a 200 mmHg, resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo ± 5 mmHg; Apresentar a medição da Pressão Arterial Média, com faixa de medição no mínimo de 20 a 230 mmHg, resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo ± 5 mmHg; Permitir a medição automática com intervalo de aferição ajustável, a medição contínua, e a medição manual através de botão dedicado; Possuir sistema de segurança que limite a pressão através da seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo as 500 últimas medições de PRESSÃO NÃO INVASIVA. Características mínimas do sistema de monitorização de TEMPERATURA: Possuir a monitorização de dois canais de TEMPERATURA; Permitir o uso de sensores cutâneos (superfície) e esofágicos/retais (cavidade); Apresentar a medição da Temperatura 1, da Temperatura 2, e do Delta entre as Temperaturas 1 e 2, com faixa de medição no mínimo de 5 a 45 °C, resolução de 0,1 °C, e com precisão de no mínimo $\pm 0,1$ °C. Permitir a conexão com Central de Monitorização; Possuir

HOSPITAL MILITAR DE AEREA DE RECIFE
FORMA: 2531
SALC

2011

sistema de proteção contra descarga de Desfibrilador; Possuir sistema de proteção contra descarga de Bisturi Elétrico; Possuir Índice de Proteção IPX1; Possuir Fonte de Alimentação interna ao equipamento; Possuir sistema com autonomia de energia mínima igual ou superior a 01 hora. com bateria interna ao equipamento, recarregável de tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Tensão de Entrada 110V; Possuir peso do equipamento com bateria de no máximo 10Kg; Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-49, e ainda ABNT NBR IEC 60601-2-27, ABNT NBR IEC 60601-2-30 e ABNT NBR IEC 60601-234; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; 36 meses de garantia. Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 Suporte de parede para o equipamento, que permita a angulação horizontal do Monitor Multiparamétrico; 2 Cabos de ECG completos reutilizáveis com 05 vias para uso Adulto/Pediátrico/Neonatal; 2 Sensores de SPO2 de dedo completos reutilizáveis para uso Adulto/Pediátrico; 02 Sensores de SPO2 tipo Y completos reutilizáveis para uso Neonatal; 2 Sensores de PNI completos reutilizáveis (braçadeira + extensor) para uso Adulto (Normal); 02 Sensores de PNI completos reutilizáveis (braçadeira + extensor) para uso Pediátrico; 1 Sensores de PNI completos (braçadeira + extensor) para uso Neonatal; 2 Sensores de temperatura completos reutilizáveis cutâneos/superficiais para uso Adulto/Pediátrico/Neonatal; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Obrigatório disponibilizar o manual do usuário da máquina para análise prévia, passivo pedido de amostra para avaliação prévia do corpo assistencial, assistência técnica

MILITARI
ASSIGNAT
35
SECRETARIA





		no estado (Apresentar CREA), produto e acessórios com registro na ANVISA, apresentar atestado de capacidade técnica do produto								
56	456628	<p>MONITOR MULTIPARAMETRO MODULAR: Monitor Multiparamétrico para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento, e com sistema modular para parâmetros vitais avançados; Possuir Módulos de Parâmetros Vitais com conexão tipo plug and play, ou seja, que conectem ao equipamento sem precisar de cabos e sem a necessidade de atualização/modificação de peças, partes e/ou softwares, e que além disto quando conectados diretamente ao equipamento formem, Monitor Multiparamétrico e Módulos de Parâmetros Vitais, um elemento único; Possuir, integrado ao equipamento ou em Módulo de Parâmetros Vitais único, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, DÉBITO CARDÍACO, e PRESSÃO INVASIVA EXTRA; Permitir ainda, através da adição de Módulos de Parâmetros Vitais, a monitorização dos seguintes parâmetros vitais avançados futuros: PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA, GASES ANESTÉSICOS, BIS e EEG; Permitir a conexão diretamente ao equipamento e visualização de forma simultânea de todos os parâmetros de monitorização vitais básicos e dos módulos adicionados. Possuir Alça de Transporte integrada ao equipamento; Possuir teclas e/ou botão rotacional que permita a programação de todos os parâmetros do equipamento; Possuir ajustes préprogramados através da seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal; Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e com tamanho de no mínimo 12 ; Possuir capacidade para apresentar simultaneamente na tela principal no mínimo 08 curvas de Parâmetros Vitais; Permitir o ajuste da velocidade do traçado</p>	Und	01	10	10	RS 41.632,57	RS 416.325,65	N (E S T E P E)	

de curva apresentado; Permitir o ajuste do ganho do traçado de curva apresentado; Permitir o ajuste do tamanho do valor dos parâmetros apresentados; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo as informações das últimas 48 horas; Permitir o ajuste dos limites, alto e baixo, para todos os parâmetros vitais monitorizados; Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo os 50 últimos eventos de alarme, juntamente com seus respectivos traçados de curva; Possuir sistema de alarme audiovisual para os alarmes funcionais do equipamento, tais como: sensor desconectado, bateria fraca, etc.; Possuir tecla para interrupção temporária dos alarmes sonoros, com tempo de interrupção de no máximo 120 s; Características mínimas do sistema de monitorização de ECG: Possuir a monitorização de 07 derivações (I, II, III, aVR, AVL, AVF, V), Permitir a monitorização de 12 derivações (I, II, III, aVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento ou do módulo; Apresentar a medição da Frequência Cardíaca, com faixa de medição no mínimo de 30 a 300 bpm, resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo ± 1 bpm ou $\pm 1\%$ (o que for maior para a respectiva medida); Apresentar o traçado de curva das 07 (ou 12) derivações de ECG; Possuir sistema de análise gráfica de Segmentos ST; Possuir sistema que apresente pontuação de deterioração fisiológica; Possuir sistema de detecção de pulso de marca-passo; Possuir sistema de detecção de arritmias; Possuir sistema de alarme audiovisual para arritmias; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo os 50 últimos eventos de arritmia, juntamente com seus respectivos traçados de curva. Características mínimas do sistema de monitorização de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por tecnologia de detecção de bioimpedância transtorácica, através do

ESPANTAL MILITAR DE AREA DE RECURSOS
137
1984

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

cabo de ECG; Apresentar a medição da Frequência Respiratória, com faixa de medição no mínimo de 15 a 150 rpm, resolução de 1 rpm, e com precisão de no mínimo ± 2 rpm ou $\pm 2\%$ (o que for maior para a respectiva medida); Apresentar o traçado de curva da RESPIRAÇÃO; Possuir sistema de detecção de apneia; Possuir sistema de alarme audiovisual para apneia. Características mínimas do sistema de monitorização de SPO2: Possuir monitorização por tecnologia Nellcor ou Masimo ou Similar; Apresentar a medição da Saturação de O₂, com faixa de medição no mínimo de 10 a 100 %, resolução de 1 %, e com precisão de no mínimo $\pm 3\%$; Apresentar a curva plestimográfica; Apresentar a medição da Frequência de Pulso, com faixa de medição no mínimo de 40 a 240 bpm, resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo ± 3 bpm. Características mínimas do sistema de monitorização de PRESSÃO NÃO INVASIVA: Possuir monitorização por tecnologia oscilométrica; Apresentar a medição da Pressão Arterial Sistólica, com faixa de medição no mínimo de 50 a 250 mmHg, resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo ± 5 mmHg; Apresentar a medição da Pressão Arterial Diastólica, com faixa de medição no mínimo de 20 a 200 mmHg, resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo ± 5 mmHg; Apresentar a medição da Pressão Arterial Média, com faixa de medição no mínimo de 20 a 230 mmHg, resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo ± 5 mmHg; Permitir a medição automática com intervalo de aferição ajustável, a medição contínua, e a medição manual através de botão dedicado; Possuir sistema de segurança que limite a pressão através da seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo as 500 últimas medições de PRESSÃO NÃO INVASIVA. Características mínimas do sistema de monitorização de TEMPERATURA: Possuir a monitorização de dois canais de

HOSPITAL MILITAR DE CASPUS
FOLHA 13
RECIFE - SAIC

TEMPERATURA; Permitir o uso de sensores cutâneos (superfície) e esofágicos/retais (cavidade); Apresentar a medição da Temperatura 1, da Temperatura 2, e do Delta entre as Temperaturas 1 e 2, com faixa de medição no mínimo de 5 a 45 °C, resolução de 0,1 °C, e com precisão de no mínimo $\pm 0,1$ °C. Permitir a conexão com Central de Monitorização; Possuir sistema de proteção contra descarga de Desfibrilador; Possuir sistema de proteção contra descarga de Bisturi Elétrico, Possuir Índice de Proteção IPX1; Possuir Fonte de Alimentação interna ao equipamento; Possuir sistema com autonomia de energia mínima igual ou superior a 01 hora, com bateria interna ao equipamento, recarregável de tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Tensão de Entrada 110V; Possuir peso do equipamento com bateria de no máximo 10Kg; Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-49, e ainda ABNT NBR IEC 60601-2-27, ABNT NBR IEC 60601-2-30 e ABNT NBR IEC 60601-234; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; 36 meses de garantia. Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 Suporte de parede para o equipamento, que permita a angulação horizontal do Monitor Multiparamétrico; 2 Cabos de ECG completos reutilizáveis com 05 vias para uso Adulto/Pediátrico/Neonatal; 2 Sensores de SPO2 de dedo completos reutilizáveis para uso Adulto/Pediátrico; 02 Sensores de SPO2 tipo Y completos reutilizáveis para uso Neonatal; 2 Sensores de PNI completos reutilizáveis (braçadeira + extensor) para uso Adulto (Normal); 02 Sensores de PNI completos reutilizáveis (braçadeira + extensor) para uso Pediátrico; 1 Sensores de PNI completos (braçadeira + extensor) para uso Neonatal; 2 Sensores de temperatura

HOSPITAL MILITAR DE AEROSPAZ
ASSINATURA



HOSPITAL MILITAR DE AEROPÉDIA
 240
 07/08/2017

completos reutilizáveis cutâneos/superficiais para uso Adulto/Pediátrico/Neonatal; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Obrigatório disponibilizar o manual do usuário da máquina para análise prévia, passivo pedido de amostra para avaliação prévia do corpo assistencial, assistência técnica no estado (Apresentar CREA), produto e acessórios com registro na ANVISA, apresentar atestado de capacidade técnica do produto								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL - UTI							R\$ 416.325,65		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

PAMO

59	422565	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRIAGEM: Monitor de sinais vitais para triagem com no mínimo as seguintes características: - Tela de alta definição com diagonal maior ou igual a 5,7" touch screen - Para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, nos parâmetros de Saturação de Oxigênio (SpO2), Frequência de Pulso (FP), Pressão não invasiva (PNI) e Temperatura; - Deve Possibilitar o armazenamento de dados e envio para prontuário eletrônico via rede e/ou Wi -fi; - Deve apresentar os valores numéricos de SpO2, FP, Temperatura e pressão sistólica, diastólica e média; - Deve apresentar índice de perfusão de SPO2; - Deve possibilitar a inclusão protocolos de alerta precoce (Mews) - Deve possuir bateria recarregável, com autonomia mínima de 4 horas e carregador de bateria incorporado; - Deve pesar, no máximo, 2,5 kg (10% de tolerância); - Deve possuir alça incorporada para situações de transporte. - Oximetria de Pulso: Deve apresentar índice de perfusão; Faixa de medida de SpO2: 10 a 100%; Faixa de medida de FP: 40 a 240 BPM; Acessórios: 01 extensão para sensor de SpO2, 1 sensor de SpO2 reutilizável adulto, tipo "clipe" Pressão não invasiva: Modo de operação mínimos: Manual; Faixa de medida de: 13 a 270 mmHg; Proteção para evitar insuflação acima de 330 mmHg; Acessórios: 01 mangueira de	Und	01	01	01	R\$ 9.220,66	R\$ 9.220,66	X
----	--------	---	-----	----	----	----	--------------	--------------	---

[Handwritten signature]

HOSPITAL MILITAR DE RECIFE
 07/03/2016
 [Handwritten signature]

		<p>PNI, 1 manguito adulto; Temperatura: Modos de Und 1 X operação mínimos: Ajustado ou direto; Faixa de medida de: 26°C a 43°C no modo ajustado através de tecnologia axilar e/ou sublingual - Deve acompanhar carro para transporte (trolley) em estrutura tubular com no mínimo 05 rodízios giratórios de 2" e pintura eletrostática em epóxi pó, além de cesta/bandeja para guarda de acessórios; - Equipamento deve possuir parecer favorável do Serviço de Engenharia Clínica da AHLVF ou submeter amostra para aprovação prévia; - Alimentação da rede elétrica bivolt automático (110V - 220V). Com cadastro/registo Anvisa e certificação INMETRO. Assistência técnica exclusiva em Recife.</p>							
80	422565	<p>MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRIAGEM: Monitor de sinais vitais para triagem com no mínimo as seguintes características: - Tela de alta definição com diagonal maior ou igual a 5,7" touch screen - Para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, nos parâmetros de Saturação de Oxigênio (SpO2), Frequência de Pulso (FP), Pressão não invasiva (PNI) e Temperatura; - Deve Possibilitar o armazenamento de dados e envio para prontuário eletrônico via rede e/ou Wi -fi; - Deve apresentar os valores numéricos de SpO2, FP, Temperatura e pressão sistólica, diastólica e média; - Deve apresentar índice de perfusão de SPO2; - Deve possibilitar a inclusão protocolos de alerta precoce (Mews) - Deve possuir bateria recarregável, com autonomia mínima de 4 horas e carregador de bateria incorporado; - Deve pesar, no máximo, 2,5 kg (10% de tolerância); - Deve possuir alça incorporada para situações de transporte. - Oximetria de Pulso: Deve apresentar índice de perfusão; Faixa de medida de SpO2: 10 a 100%; Faixa de medida de FP: 40 a 240 BPM; Acessórios: 01 extensão para sensor de SpO2, 1 sensor de SpO2 reutilizável adulto, tipo "clipe" Pressão não invasiva: Modo de operação mínimos: Manual; Faixa de medida de: 13 a 270 mmHg;</p>	Und	01	01	01	R\$ 9.220,66	R\$ 9.220,66	N (E S T E P E)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Proteção para evitar insuflação acima de 330 mmHg; Acessórios: 01 mangueira de PNI, 1 manguito adulto; Temperatura: Modos de Und 1 X operação mínimos: Ajustado ou direto; Faixa de medida de: 26°C a 43°C no modo ajustado através de tecnologia axilar e/ou sublingual - Deve acompanhar carro para transporte (trolley) em estrutura tubular com no mínimo 05 rodízios giratórios de 2" e pintura eletrostática em epóxi pó, além de cesta/bandeja para guarda de acessórios; - Equipamento deve possuir parecer favorável do Serviço de Engenharia Clínica da AHLVF ou submeter amostra para aprovação prévia; - Alimentação da rede elétrica bivolt automático (110V - 220V). Com cadastro/registo Anvisa e certificação INMETRO. Assistência técnica exclusiva em Recife.

SUBTOTAL - PAMO

R\$ 9.220,66

AMBULATORIO DE CARPOLOGIA DO BMAR

LOTE 1 - EXCLUSIVIDADE ME/EPF

63	331285	Gravador digital de HCLTER para registros eletrocardiográficos; dinâmico para monitorização e gravação em 24/72 horas contínuas, digital de alta precisão, possuir sistema de auto teste, possuir sistema de gravação em mídia digital reutilizável e de fácil substituição, possuir no mínimo 03 canais de aquisição, possuir no mínimo resolução de aquisição de sinal 800 p.p., com processamento em tempo real, circuito de detecção automática de marca-passo e relógio interno incorporado, transmissão via raios infravermelhos, possuir alarme sonoro de falha. Cada equipamento deve ter peso não superior a 100 gramas (incluindo bateria), com utilização de pilhas AAA recarregáveis. Acompanhar: Cabo de 4 vias, clipe e 2 cartões de memória.	Und	01	05	05	R\$ 7.161,36	R\$ 35.806,78		X
64	331285	MÓDULO DE ANÁLISE DE HCLTER Sistema de análise digital (HCLTER) em Windows 7 ou superior, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com:	Und	01	01	01	R\$ 30.463,00	R\$ 30.463,00	N	(F S T E P E

[Handwritten signature]

capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS's; arritmias e desnivelamento do segmento ST; tabela de propriedade dosm QRS's, revisor de arritmias e ST; classificação de extras sistoles; menu de exemplos; banco de frases configuráveis para edição e laudo; menu de configuração de relatórios; permitir a apresentação do tacograma dos intervalos RR; permitir a apresentação da variabilidade da frequência cardíaca hora a hora; possuir sistema de detecção de apneia do sono; possuir sistema para análise de marca-passo; possuir sistema para análise de eventos em loop; permitir a inserção e/ou edição de dados gerais; permitir a exibição das formas de onda separadas pela morfologia destas; possuir barra dos gráficos da frequência sobre a barra de ECG; permitir a apresentação das arritmias, com a quantidade de eventos; permitir destacar os histogramas por classe de acoplamento entre RR, como normal-normal, normal-ventricular ou ventricular-ventricular; permitir a apresentação da leitura realizada nos 03 canais durante as 24 h de exame, além de fazer medições e acessar horários específicos; permitir o zoom do ECG; possuir sistema de filtros de frequência para minimizar e/ou eliminar interferências na gravação; permitir a impressão de relatórios com todas as alterações e reclassificações feitas pelo operador; Incluir. 01-Computador compatível: Software de análise de Holter em português, 1 CD de Instalação, 1 Dongle (Dispositivo de Licença), 1 Leitor de cartão de memória (adaptador USB), 1 Manual Operacional e Técnico em Português. Software certificado na ANVISA. 01-Nobreak compatível;

[Handwritten signature]

ESTE ITEM REQUER AMPLA PARTICIPAÇÃO

65	331285	Gravador digital de HOLTER para registros eletrocardiográficos, dinâmico para monitorização e gravação em 24/72 horas contínuas, digital de alta precisão, possuir sistema de auto teste, possuir sistema de gravação em mídia digital reutilizável e de fácil substituição, possuir no mínimo 03 canais de aquisição,	Und	01	05	05	R\$ 7.161,36	R\$ 35.806,78	X
----	--------	--	-----	----	----	----	--------------	---------------	---

[Handwritten signature]

FORÇA ARMADA BRASILEIRA
 FORÇA MILITAR DE ÁREA DE RESERVA
 2544
 S.A.T.C.

possuir no mínimo resolução de aquisição de sinal 800 p.p., com processamento em tempo real, circuito de detecção automática de marca-passo e relógio interno incorporado, transmissão via raios infravermelhos. possuir alarme sonoro de falha. Cada equipamento deve ter peso não superior a 100 gramas (incluindo bateria), com utilização de pilhas AAA recarregáveis. Acompanhar: Cabo de 4 vias, clipe e 2 cartões de memória.

66	302341	<p>MÓDULO DE ANÁLISE DE HOLTER Sistema de análise digital (HOLTER) em Windows 7 ou superior, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS's arritmias e desnivelamento do segmento ST; tabela de propriedade dos QRS's, revisor de arritmias e ST; classificação de extrasístoles; menu de exemplos; banco de frases configuráveis para edição e laudo; menu de configuração de relatórios; permitir a apresentação do tacograma dos intervalos RR; permitir a apresentação da variabilidade da frequência cardíaca hora a hora; possuir sistema de detecção de apneia do sono; possuir sistema para análise de marca-passo; possuir sistema para análise de eventos em loop; permitir a inserção e/ou edição de dados gerais; permitir a exibição das formas de onda separadas pela morfologia destas; possuir barra dos gráficos da frequência sobre a barra de ECG; permitir a apresentação das arritmias, com a quantidade de eventos; permitir destacar os histogramas por classe de acoplamento entre RR, como normal-normal, normal-ventricular ou ventricular-ventricular; permitir a apresentação da leitura realizada nos 03 canais durante as 24 h de exame, além de fazer medições e acessar horários específicos; permitir o zoom do ECG; possuir sistema de filtros de frequência para minimizar e/ou eliminar interferências na gravação; permitir a</p>	Und	01	01	01	R\$ 30.463,00	R\$ 30.463,00	N (E S T E P E)
----	--------	---	-----	----	----	----	---------------	---------------	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

impressão de relatórios com todas as alterações e reclassificações feitas pelo operador; Incluir: 01-Computador compatível; Software de análise de Holter em português, 1 CD de Instalação, 1 Dongle (Dispositivo de Licença), 1 Leitor de cartão de memória (adaptador USB), 1 Manual Operacional e Técnico em Português. Software certificado na ANVISA. 01-Nobreak compatível;							
SUBTOTAL - AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HMAR						R\$ 66.269,78	
TOTAL - GERAL						R\$ 1.022.660,62	

Justificativa para a aquisição

A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades das 1ª UI, 2ª e 4ª UI, 5ª UI, 8ª UI, 9ª UI, UTI 1, 2 e 3, UCE, Ambulatório de Cardiologia, Clínica Radiológica, e PAMO do Hospital Militar de Área de Recife, no que concerne à realização dos procedimentos cirúrgicos dos usuários do sistema SAMMED/FuSEx/PASS.

Recife, PE, 23 de Maio de 2023.

Wallace de Souza Ferreira
WALLACE DE SOUZA FERREIRA - Coronel
 Gestor do PAASSEx do HMAR



MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIMENAPA COMPARATIVO DA PESQUISA DE PREÇOS


MAPA COMPARATIVO - REQUISITÓRIA N.º 042/2022 - PREÇO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ODONTOLÓGICOS - PAASSE x 2022/2023
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO DE 2022 DO HMAR.

Em cumprimento ao que prescreve a letra "b" do § 1º, Art 48, Lei 8.666/93 e alínea a), do inciso IV, do Art 25 da Portaria Ministerial n.º 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), esta comissão declara, sob as penas da lei, que foi realizada a pesquisa de preços aquisição de equipamentos médicos, composto por 24 itens, em proveito do Hospital Militar de Área de Recife, obtendo o valor estimado para cada item, conforme descrito no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL HMAR	PAINEL DE PREÇOS	ATA	ATA	FNS	SITE 1	S1	SITE 2	S2	SITE 3	S3	FORN 1	F1	FORN 2	F2	FORN 3	F3	VALOR MÉDIO ESTIMADO	
																					ATA
9	Balança adulto antropométrica	Und	1	R\$ 1.357,34	R\$ 1.428,00	A	R\$ 1.716,00	R\$ 1.690,00	1	R\$ 1.892,00	2	R\$ 1.839,50	3	***	***	***	***	***	***	R\$ 1.652,14	
10	Balança adulto antropométrica	Und	1	R\$ 1.357,34	R\$ 1.428,00	A	R\$ 1.716,00	R\$ 1.690,00	1	R\$ 1.892,00	2	R\$ 1.839,50	3	***	***	***	***	***	***	R\$ 1.652,14	
SUBTOTAL - 21/4 UI																					
17	Balança pediátrica antropométrica	Und	2	R\$ 860,97	R\$ 881,94	B	R\$ 1.101,00	R\$ 1.130,50	4	R\$ 1.359,00	5	R\$ 1.251,30	6	***	***	***	***	***	***	R\$ 1.096,74	
18	Balança pediátrica antropométrica	Und	2	R\$ 860,97	R\$ 881,94	B	R\$ 1.101,00	R\$ 1.130,50	4	R\$ 1.359,00	5	R\$ 1.251,30	6	***	***	***	***	***	***	R\$ 1.096,74	
SUBTOTAL - 11 III, 21/4 III e 8ª III																					
19	Monitor multiparametro de sinais vitais	Und	2	R\$ 7.400,00	R\$ 7.780,00	G	18.666,00**	R\$ 9.247,85	11	R\$ 9.900,00	15	***	***	R\$ 11.216,80	12	R\$ 19.000,00	16	***	***	R\$ 10.757,44	
20	Monitor multiparametro de sinais vitais	Und	2	R\$ 7.400,00	R\$ 7.780,00	G	18.666,00**	R\$ 9.247,85	11	R\$ 9.900,00	15	***	***	R\$ 11.216,80	12	R\$ 19.000,00	16	***	***	R\$ 10.757,44	
SUBTOTAL - 21/4 UI e 9ª UI																					
27	Aparelho de raios-x, fixo, analógico	Und	1	R\$ 104.950,00	R\$ 115.900,00	C	R\$ 178.769,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	R\$ 133.206,33	
28	Aparelho de raios-x, fixo, analógico	Und	1	R\$ 104.950,00	R\$ 115.900,00	C	R\$ 178.769,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	R\$ 133.206,33	
SUBTOTAL - CLÍNICA RADIOLÓGICA																					
39	Electrocardiografo	Und	2	R\$ 3.800,00	R\$ 6.790,00	D	R\$ 14.010,00**	R\$ 7.502,99	7	R\$ 6.149,99	8	R\$ 6.155,90	9	R\$ 8.800,00	16	***	***	***	***	R\$ 6.866,48	
40	Electrocardiografo	Und	2	R\$ 3.800,00	R\$ 6.790,00	D	R\$ 14.010,00**	R\$ 7.502,99	7	R\$ 6.149,99	8	R\$ 6.155,90	9	R\$ 8.800,00	16	***	***	***	***	R\$ 6.866,48	
41	Monitor multiparametro de sinais vitais	Und	1	R\$ 7.400,00	R\$ 7.780,00	G	18.666,00**	R\$ 9.247,85	11	***	***	***	***	R\$ 11.216,80	12	R\$ 19.000,00	16	***	***	R\$ 10.928,93	
42	Monitor multiparametro de sinais vitais	Und	1	R\$ 7.400,00	R\$ 7.780,00	G	18.666,00**	R\$ 9.247,85	11	***	***	***	***	R\$ 11.216,80	12	R\$ 19.000,00	16	***	***	R\$ 10.928,93	
SUBTOTAL - UTI/ICU																					
47	Ventilador invasivo para Transporte	Und	6	R\$ 51.200,00	R\$ 46.026,50	I	R\$ 33.908,00	R\$ 32.329,58	13	R\$ 25.500,00	04	***	***	***	***	***	***	***	***	R\$ 47.427,35	
48	Ventilador invasivo para Transporte	Und	6	R\$ 51.200,00	R\$ 46.026,50	I	R\$ 33.908,00	R\$ 32.329,58	13	R\$ 25.500,00	04	***	***	***	***	***	***	***	***	R\$ 47.427,35	
49	Cardiovisor Portatil	Und	2	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	J	R\$ 23.496,00	R\$ 31.895,00	14	R\$ 39.690,00	9	R\$ 31.900,00	4	R\$ 26.700,00	16	***	***	***	***	R\$ 31.525,86	
50	Cardiovisor Portatil	Und	2	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	J	R\$ 23.496,00	R\$ 31.895,00	14	R\$ 39.690,00	9	R\$ 31.900,00	4	R\$ 26.700,00	16	***	***	***	***	R\$ 31.525,86	




Recife, PE, de 03 de Maio de 2023.
Wallace de S. Ferrera
WALLACE DE SOUZA FERRERA
Gestor do PAASSEX do HMMAR

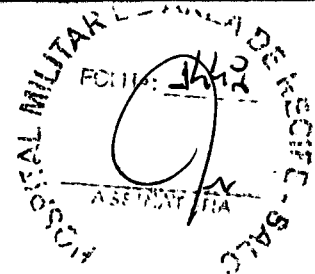

PROCESSO DE LICITAÇÃO

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HMAR
- PAASSEx 2023 -

- REQUISITÓRIA
- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
- BOLETIM INTERNO
- MAPA DE RISCO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- PARECER TÉCNICO
- FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA
- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- MAPA COMPARATIVO
- RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO
- ANÁLISE CRÍTICA
- JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
- TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO
- AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
- APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- PESQUISA DE PREÇOS

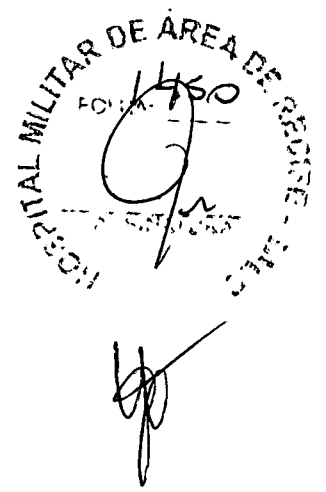

PROCESSO DE LICITAÇÃO

● AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HMAR

- PAASSEx 2023 -

● **PESQUISA DE PREÇOS**
(PAINEL DE PREÇOS)

MEDIA
R\$ 7.186,25
MEDIANA
R\$ 7.186,25
MENOR
R\$ 6.793,82

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Ano da Compra Esfera
331285 2022, 2023 Federal

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00057/2022	00041	Pregão	331285	GRAVADOR DE HOLTER		UNIDADE	4	R\$6793,82	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254492 - INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS IPEC	17/11/2022
00025/2022	00002	Dispensa de Licitação	331285	GRAVADOR DE HOLTER		UNIDADE	1	R\$7578,68	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	04/10/2022



MÉDIA R\$ 30.395,00
 MEDIANA R\$ 30.395,00
 MENOR R\$ 29.990

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar


Ano da Compra

GRAVADOR DE HOLTER), TIPO DIGITAL, COMPONENTE CARTÃO MAGNÉTICO MÍNIMO 48MB OU CARTÃO SD), AUTONOMIA SISTEMA AUTONOMIA MÍNIMA 24HS), ACESSÓRIOS BRACADEIRAS C/ MANGUITOS), 2 PILHAS RECARREGÁVEIS), SOFTWARE SOFTWARE LEITURA/ENVIO EXAMES OU P/ CARDIONET DYNAL), OUTROS COMPONENTES RECARREGADOR PILHAS), CABO PACIENTE), TIPO FUNCIONAMENTO: FUNCIONAMENTO C/ 1 PILHA, SISTEMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA (HOLTER), TIPO ANÁLISE COMPUTADORIZADA), COMPONENTES GRAVAÇÃO EM TRÊS CANAIS, TIPO SISTEMA COMPATIBILIDADE C/WINDOWS XP E VISTA, MEMÓRIA 512M B), TIPO LEITURA GRAVAÇÃO DE ECG ALTA RESOLUÇÃO), VETORCARDIOGRAMA), SOFTWARE IMPRESSORA COLORIDA EM 3), 12 E 18 CANAIS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO DE RESULTADOS REDE OU MÍDIA), FUNÇÕES AJUSTE MANUAL OU AUTOMÁTICO QRS E ST), OUTROS COMPONENTES VALIAÇÃO ARRITMIAS POR EVENTOS OU POR HISTOGRAMA S, GRAVADOR DE HOLTER DIGITAL COM SOFTWARE PARA ANÁLISE DE HOLTER COMPLETO), PARA ADULTO, SISTEMA HOLTER - ANALISADOR E GRAVADOR DE HOLTE R. MONITORAÇÃO CARDÍACA DE NO MÍNIMO 24 HORAS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR O REGISTRO DE ECG, VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE MONITOR DE VÍDEO E IMPRESSÃO O CO NJUNTO DEVE SER COMPOSTO DE UM ANALISADOR E TRÊS GRAVADORES DIGITAIS. 2022, O ANALISADOR DE HOLTER DE ECG DEVE SER COMPOSTO DE: I) INTERFACE DE LEITURA DOS REGISTROS DE ECG ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA COM ENTRADA USB OU INTERFACE SERIAL), II) SOFTWARE DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS EM PORTUGUÊS, III) ANÁLISE PE DIÁTRICA), IV) ANÁLISE DE RÚIDO PARA CADA CANAL), V) ANÁLISE DE FIBRILAÇÃO, SISTEMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA (HOLTER), TIPO ANÁLISE COMPUTADORIZADA), COMPONENTES 5 GRAVADORES DE HOLTER, ANALÓGICO, TIPO SISTEMA SISTEMA ANÁLISE WINDOWS CSK 550, TIPO LEITURA LEITURA DIGITAL (CARTÃO MEMÓRIA SÓLIDA), SOFTWARE GERENCIAMENTO MÓDULOS), VARIABILIDADE R-R), TEMPO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA), GRÁFICOS), EDIÇÃO E CONFIGURAÇÃO), FUNÇÕES ANÁLISE MARCAPASSO), OUTROS COMPONENTES ARQUIVO GRAVAÇÃO MÍDIAS REMOVÍVEIS), LOOP, ECG ALTA R, SISTEMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA (HOLTER), TIPO SOFTWARE WINDOWS), SOFTWARE VARIABILIDADE RR, COMPONENTES BARRA TRACADO ECG, CPU PENTIUM IV, MEMÓRIA 512MB), TIPO SISTEMA HD 80GB, GRAVADOR, LEITOR DVD), OPERACIONAL WINDOWS X P), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSORA A LASER, MÍNIMO 35 PÁG./MIN.), OUTROS COMPONENTES GRAVADOR DIGITAL), MONITOR 17" TELA PLANA

Quantidade total de registros: 2
 Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00172/2022	00005	Preço	331285	GRAVADOR DE HOLTER		UNIDADE	3	R\$29990	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	17/05/2023
00036/2022	00006	Preço	3090	COLONITA		UNIDADE	2	R\$10300	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	17/05/2023



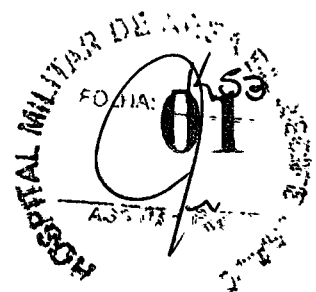

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H0'.

PROCESSO DE LICITAÇÃO

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HMAR

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(ATAS)



254492.572022.133821.4520.395971189000



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00057/2022

As 10:00 horas do dia 11 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA N.º 058/2021 de 23/12/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 25029000326202263, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00057/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material permanente. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Banqueta**Descrição Complementar:** Banqueta Altura: 45 CM, Material Estrutura: Ferro , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Compensado , Acabamento Estrutura: Pintado , Característica Assento: Circular Acolchoado , Revestimento Assento: Acolchoado , Cor Assento: Preta , Cor Estrutura: Preta**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 1.806,2700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.548,5700 .**

Item: 2**Descrição:** Escada Hospitalar**Descrição Complementar:** Escada Hospitalar Material: Madeira Padrão Marfim , Aplicação: Fisioterapia , Dimensão Escada: 1,37 X 0,79 X 1,62 M, Dimensão Rampa: 1,37 X 0,79 X 1,60 M, Tipo: De Canto Com Rampa , Características Adicionais: Com Corrimão E Antiderrapante Emborrachado**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.999,8800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 e com valor negociado a R\$ 1.999,0000 .**

Item: 3**Descrição:** Barra Paralela**Descrição Complementar:** Barra Paralela Material: Aço Inoxidável , Tipo Piso: Piso De Madeira C/ Borracha Anti-Derrapante , Comprimento: 2,5m De Comprimento , Largura: 1**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 5.597,9100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 .**

Item: 4**Descrição:** Material Fisioterapia**Descrição Complementar:** Material Fisioterapia Componentes: C/4canais,Parâmetros Fixos P/Rise/Decay,Peso 3,5kg , Aplicação: Fisioterapia , Tipo: Aparelho Tens/Fes , Características Adicionais: Operação Em Burst/Normal,Controles R/T E Modo Fes**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.422,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 .**

Assento Anatômico Com Regulagem , Tipo Painel: Lcd , Tipo Medição: Calorias, Tempo, Fc, Distância, Velocidade, Carga

Acessórios: Apoio Lateral Para Mãos, Rodas Transporte C/Travas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 0,0100


Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

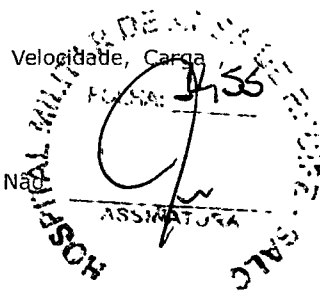

Item: 38

Descrição: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Material: Metal , Aplicação: Costas, Braços, Ombros , Características Adicionais: Revestido Couro Sintético , Tipo: Remada Sentada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 0,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 39

Descrição: Dinamômetro

Descrição Complementar: Dinamômetro Aplicação: Medição De Tensão E Compressão , Tipo: Digital , Características Adicionais: Baterias 1,5v, Portátil, Com Estojo Transporte , Capacidade Máxima: 150 KG

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 0,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 40

Descrição: Acessório Para Equipamento Médico

Descrição Complementar: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 10 Vias , Tipo: Cabo Paciente , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.100,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 e com valor negociado a R\$ 1.100,0000 .

Item: 41

Descrição: Gravador De Holter

Descrição Complementar: Software: Software Leitura/Envio Exames Ou P/Cardionet Dyna, Componente: Cartão Magnético Mínimo 48mb Ou Cartão Sd, Outros Componentes: Recarregador Pilhas,Cabo Paciente, Tipo: Digital, Tipo Funcionamento: Funcionamento C/ 1 Pilha, Autonomia Sistema: Autonomia Mínima 24hs, Acessórios: Braçadeiras C/ Manguitos,2 Pilhas Recarregáveis,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 31.192,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28.500,0000 e com valor negociado a R\$ 27.175,2800 .

Item: 42

Descrição: Gravador De M.A.P.A.

Descrição Complementar: Componentes: Manual De Instrução, Tipo Programação: Software Windows, Aplicação: Monitorização Ambulatorial Pressão Arterial, Outros Componentes: Recarregador De Pilhas, Características Adicionais: Monitor Pressão,Estojo E Cinto Couro,Cabo Conector, Autonomia Sistema: Autonomia Mínima 24hs, Acessórios: Braçadeira Com Manguito,4 Pilhas Recarregáveis,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 25.542,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17.800,0000 e com valor negociado a R\$ 17.500,0000 .

Item: 43

Descrição: Monitor Frequência Cardíaca

Descrição Complementar: Componentes: Memória Até 99 Exercícios, Resistente A Água 50m, Outros Componentes: Interface Relógio Para Computador Raios Iv, Características Adicionais: Luz Noturna, Transmissão Codificada Sem Fio, Fonte Alimentação: Bateria, Acessórios: Com Cinta Torácica,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 13.636,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Ariquemes

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00036/2022

Às 09:00 horas do dia 09 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 18.260/21 de 28/12/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 22003/SEMSAU/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00036/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (bisturi elétrico, cardioversor, colposcópio, sistema holter, sistema de vídeo endoscopia e etc...), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes/RO - Convênio nº 253/PGE-2021.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Dolomita

Descrição Complementar: BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W) Gerador com potência mínima de 300W, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d'água com leitura digital de potência Modos de operação no mínimo: Bipolar, Monopolar. Especificação mínima do gerador: Corte puro (300W), Blend (130W), Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 38.740,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000**.

Item: 2

Descrição: Dolomita

Descrição Complementar: CARDIOVERSOR Especificações mínimas: Comando nas pás: carga e disparo Memória de ECG Módulo DEA Acompanha: Impressora e Bateria

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 81.173,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 42.084,0000**.

Item: 3

Descrição: Dolomita

Descrição Complementar: COLPOSCÓPIO Colposcopio ginecológico com vídeo. Cabeça estereoscópica de 05 aumentos (3x, 4x, 7x, 11x e 17x), objetiva foco 300mm, binóculo reto curto f=160mm., braço pantográfico, ocular 12,5x grande angular com trava e ajuste de dioptrias (par). microfocalização na objetiva, distancia inter-pupilar de 55 a 75mm, gerador de luz fria com uma lâmpada halogena 15v, 150w e transmissão da luz a traves de cabo de fibra Óptica e potenciometro com ajuste da luminosidade da luz, fusível de segurança, cabo elétrico, e lâmpadas obressalente. filtro verde, removível, estativa portátil de chão com cinco rodízios. manipululo para movimentação do equipamento. divisor de luz e adaptador para câmera de vídeo incorporado na cabeça óptica. Câmera com microcorpo de 36 x 36 x 37mm, 1/3 ntsc 7 68 (h) x 494 (v). Altura mínima: 950mm, altura máxima: 1120mm., todos os acessórios necessários para o bom e perfeito funcionamento do equipamento, monitor LCD de 15. Interface vídeo-vga com captura e gravação de imagem em cartão de memória. Alimentação elétrica: 110/220v - 60hz, selecionável. [A DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTA NO EDITAL e no TERMO DE REFERÊNCIA]

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 56.214,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 42.000,0000 .

Item: 4

Descrição: Dolomita

Descrição Complementar: SERRA/ PERFURADORA ÓSSEA (DRILL) Perfurador ósseo: Pneumático, canulado e autoclavável. Com velocidade de trabalho no mínimo de 0 a 1.000 RPM e acionamento progressivo através de gatilho ou pedal. Mandril de aperto rápido e com ajuste de no mínimo 0 a 6,5 mm, para brocas. Mandril de alto torque com ajuste de 0 a 10 mm para utilização de fresas e raspas. Serra óssea: Pneumática, confeccionada em material leve, resistente e autoclavável. Turbina motora com capacidade mínima de 14.000 CPM e com acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Deve possuir sistema de trava de segurança. Acessórios mínimos: 01 caixa de esterilização; 04 brocas com diâmetro de no mínimo 5,0 mm aproximadamente; 04 lâminas; 01 válvula reguladora de pressão para nitrogênio ou ar comprimido medicinal; Mangueiras, conectores, adaptadores e todos os demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 40.602,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.552,1600 e com valor negociado a R\$ 40.000,0000 .

Item: 5

Descrição: Dolomita

Descrição Complementar: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Vídeo Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição (HD), que possua magnificação, WideScreen e sistema de captura de imagens (através de pendrive, cartão de memória ou computador). Com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB, DVI ou SDI. Fonte de iluminação LED ou Xênon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. ... [... DEMAIS DESCRIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL e no TERMO DE REFERÊNCIA]

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 312.709,6500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 243.000,0000 .

Item: 6

Descrição: Dolomita

Descrição Complementar: SISTEMA HOLTER - ANALISADOR E GRAVADOR Sistema analisador e gravador de holter. Monitoração cardíaca de no mínimo 24 horas. O equipamento deve possibilitar o registro de ECG, visualização através de monitor de vídeo e impressão. O conjunto deve ser composto de um analisador e três gravadores digitais. O analisador de Holter de ECG deve ser composto de: I) interface de leitura dos registros de ECG através de cartão de memória com entrada USB ou interface serial, II) software de leitura e interpretação dos dados em português, III) análise pediátrica, IV) análise de ruído para cada canal, V) análise de fibrilação atrial, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, sequências ventriculares, frequência cardíaca, emparelhamentos, bigeminismo, trigeminismo, sequências atriais, ectópicos ventriculares com atraso, contrações atriais e ventriculares prematuras, interferências, VI) detecção e análise de arritmias nos segmentos ST e QT, VII) análise da variabilidade da frequência cardíaca e VIII) ... [... DEMAIS DESCRIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL e no TERMO DE REFERÊNCIA]

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 100.988,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 61.600,0000 .

Histórico

Item: 1 - Dolomita

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.737 428/0001-14	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Marca: EMAI	Sim	Sim	2	R\$ 19.300,0000	R\$ 38.600,0000	06/05/2022 11:45:27




PROCESSO DE LICITAÇÃO

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HMAR

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(SÍTIOS ELETRÔNICOS)

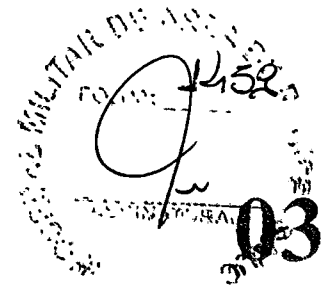

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S.", located to the right of the coat of arms.

PROCESSO DE LICITAÇÃO

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HMAR

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(FORNECEDORES)

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do equipamento e acessórios descritos abaixo:

Item	Produto	Qtd	Preço Unit.	Valor Total
1	CardioLight Código 05190100003 NCM 90181100	6	7.504,00	45.024,00
2	CardioSmart 550 Código 05134000010 NCM 85234990	1	30.599,00	30.599,00
3	CardioNet Client Código 05194000002 NCM 85234990	1	1.199,00	1.199,00
4	Carregador de Pilhas AA e AAA Código 04700100003 NCM 85044010	2	210,00	420,00
5	Pilha Recarregável AAA (Kit com 2 pilhas) Código 04700100002 NCM 85078000	3	74,00	222,00
6	Leitora de Cartão de Memória USB 3.0 Código 04196000042 NCM 84719011	1	199,00	199,00
Total				77.663,00

Os valores acima estão expressos em Reais (R\$) e contemplam IPI.

Atenção! A pessoa jurídica com inscrição estadual habilitada pode estar sujeita à cobrança do ICMS ST. Este imposto não está contemplado nos valores desta proposta comercial e será oportunamente calculado conforme os itens de seu pedido e sua situação fiscal durante a efetivação do pedido de venda.

Os valores acima não incluem instalação e treinamento no local de entrega dos produtos. Este serviço deve ser negociado diretamente com o representante Cardios de sua região, com custos de deslocamento e hospedagem (quando aplicável) por conta do cliente.

Cardios oferece, gratuitamente, atendimento via Serviço de Suporte ao Cliente para instalação remota dos produtos e vídeos de treinamento em seu canal no YouTube.

Formas de Pagamento

Pagamento Antecipado

Boleto Bancário

1 x

1 x

Opções de Entrega

Rua do Hospício - Boa Vista - Recife - PE 50050-050

Rodoviário

via Quality/Press

8 dias - R\$ 325,33

Aéreo

via JAMEF

9 dias - R\$ 746,95

Estimativa de prazo máximo a contar da confirmação de pagamento.

CARDIO SISTEMAS COML. INDL. LTDA

Equipamentos e Sistemas Avançados em Eletrocardiografia Ambulatorial e MAPA

www.cardios.com.br

Av. Paulista, 509 Andar 1 Andar 2 Cj. 201, 212-214
CEP 01311-910 Bela Vista São Paulo SP Brasil

Tel. Geral: 11 3883-3000

Fax: 11 3883-3060

Vendas: 11 3883-3030

SSC: 11 3883-3010

CNPJ. 51.961.258/0001-95 IE. 110.280.210.110



A Halma company




Estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Laura Fischer
11 38833032

PROPOSTA

QFB3KJ

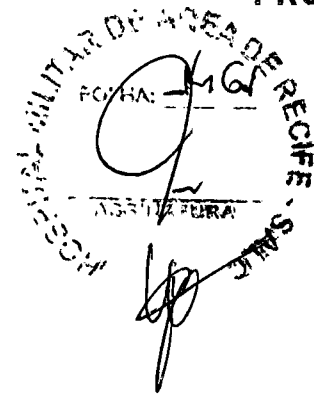

Desde 2017 a Cardios faz parte da Halma plc, grupo global de empresas de tecnologia que salvam vidas, com sede no Reino Unido. Apresentamos, abaixo, as condições para a aceitação desta proposta comercial.

As partes compreendem, atestam e garantem per si, seus agentes, subcontratados, consultores e intermediários que estão de acordo com todas as leis, regulações, normas e decretos relativos aos atos antissuborno e anticorrupção, incluindo, mas não limitados:

- As Leis nacionais e locais do território em que operam;
- Ao UK Bribery Act 2010;
- Ao US Foreign Corrupt Practices Act 1977;
- A Convenção Contra Corrupção das Nações Unidas;
- Ao Código de Conduta da companhia Halma plc, que pode ser encontrado em <https://www.halma.com/sustainability/policies-and-procedures>.

E, em atenção ao Modern Slavery Act 2015, a Lei de Escravidão Moderna do Reino Unido, também declaram que:

- não cometeram quaisquer ofensa MSA (MSA Offense) ao Modern Slavery Act 2015;
- não foram notificados de que estão sob investigação relacionada a uma ofensa MSA (MSA Offense) ou sendo processados sob o Modern Slavery Act 2015;
- estão cientes de qualquer circunstâncias dentro da cadeia de suprimentos que possa ser levantada com investigação a uma alegada ofensa MSA (MSA Offense) ou processados sob a égide do Modern Slavery Act 2015.

Você também atesta que está ciente e concorda com a política comercial vigente, que pode ser encontrada em <https://www.cardios.com.br/termos>.

Para a efetivação desta proposta em pedido, por favor, informe os dados para faturamento e assine no espaço indicado.

Assinatura e carimbo

Nome do Aprovador

CPF e Inscrição no CRM/CREA do Profissional Responsável

CARDIO SISTEMAS COML. INDL. LTDA

Equipamentos e Sistemas Avançados em Eletrocardiografia Ambulatorial e MAPA

www.cardios.com.br

Av. Paulista, 509 Andar 1 Andar 2 Cj. 201, 212-214
CEP 01311-910 Bela Vista São Paulo SP Brasil
CNPI. 51.961.258/0001-95 IE. 110.280.210.110

Tel. Geral: 11 3883-3000
Fax: 11 3883-3060
Vendas: 11 3883-3030
SSC: 11 3883-3010



O Futuro se fazendo Presente

Alta precisão

Tecnologia digital de aquisição do sinal de 800 pontos por segundo com processamento em tempo real (DSP), circuito de detecção de marca-passo e relógio interno incorporados permitem a maior precisão dos registros. Permite a realização de gravações de 24h a 72h contínuas, sem mudança de pilha ou cartão.

Transmissão via raios infravermelhos

Possibilita a monitorização do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal.

Transmissão via Internet

Através do software CardioNet os registros gravados no CardioLight podem ser transmitidos por Internet para análise em outros centros, discussão de casos ou formação de bancos de dados.

Extremamente confortável

Seu tamanho e peso reduzidos (62 gramas com pilha e cartão), aliados ao seu formato ergonômico o tornam imperceptível no bolso ou na cinta do paciente.

Cada grama e cada milímetro deste revolucionário gravador de Holter foram cuidadosamente projetados para obter o gravador mais avançado no tamanho mais reduzido e com o design mais moderno.

O gravador de Holter que reúne os requisitos mais importantes para o médico, para o técnico e para o paciente.

Médico

Alta qualidade do sinal, variedade de recursos.

Técnico

Facilidade de operação e possibilidade de verificação do sinal.

Paciente

Conforto total e design agradável.

Características Técnicas

Tamanho: 82 x 60 x 14 mm

Mídia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g

Aquisição do sinal: 800 pps. – 12 bits.

Relógio interno

Emissor - Receptor Infravermelho

3 anos de Garantia (não inclui acessórios)

Peso: 47 g

Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g

Circuito de detecção de marca-passo

Alarmes luminosos e sonoros

Registro ANVISA/MS: 10361050006

www.cardios.com.br

Acessórios inclusos



Cabo de 4 vias



Clipe




Capanga de couro



02 Cartões de Memória

Acessórios Opcionais



Cabo de 7 vias



Tampa do gabinete



Cinto de couro



Carregador



Pilhas AAA



Leitora

CARDIO SISTEMAS COML. INDL. LTDA

Equipamentos e Sistemas Avançados em Eletrocardiografia Ambulatorial e MAPA

Av. Paulista, 509 Andar 1 Andar 2 Cj. 201, 212-214
CEP 01311-910 Bela Vista São Paulo SP Brasil

CNPJ. 51.961.258/0001-95 IE. 110.280.210.110

Tel. Geral: 11 3883-3000


Fax: 11 3883-3060


Vendas: 11 3883-3030

SSC: 11 3883-3010

A MALMA CORP. S.A.S.

www.cardios.com.br

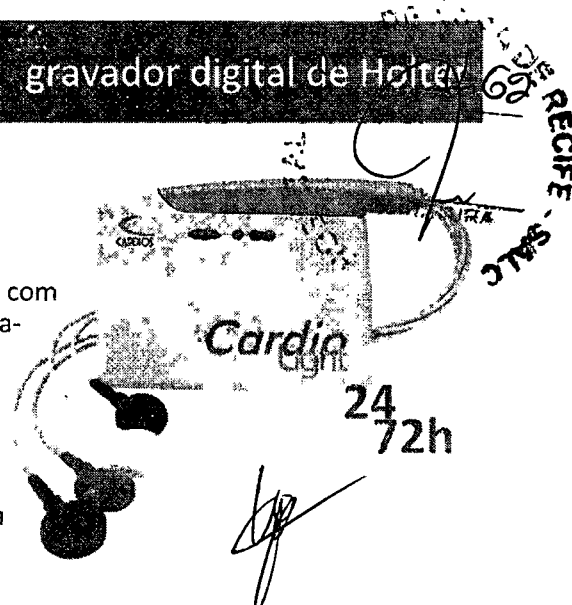

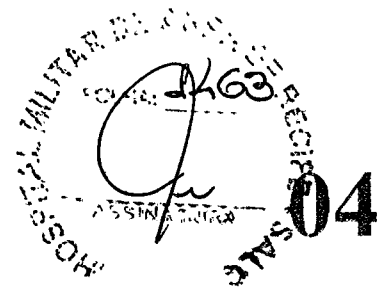

A handwritten signature in black ink, located to the right of the coat of arms.

PROCESSO DE LICITAÇÃO

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HMAR

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(FNS)

Detalhe Equipamento

Ocorreu um erro no servidor

RECIFE
34
57
Equipamento
Sistema Holter - Analisador e Gravador
Unidade Funcional / Unidade
Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Métodos Gráficos
COPIAS
VALIDAS

Atividade
Apoio Diagnóstico - Hospital - Serviço de Alta Complexidade e Especialidades
Ambiente
Sala de eletrocardiografia contínua - (Holter)

Item
1123
Nomenclatura
Sistema Holter - Analisador e Gravador

Sinónimos
ECG 24 horas, Gravador de ECG Holter

Classificação
Médico Assistencial

Definição e Aplicação
O Sistema Holter deve ser composto minimamente do software (interface gráfica para visualização e diagnóstico do exame) e um componente de hardware (gravador). Trata se de um monitor portátil que registra a atividade elétrica do coração e suas variações durante as 24 horas do dia ou mais e pode, assim, detectar alterações que em geral não aparecem num exame de tempo mais limitado, como num eletrocardiograma simples, por exemplo.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido
R\$ 60.834,00

Sistema analisador e gravador de holter. Monitoração cardíaca de no mínimo 24 horas. O equipamento deve possibilitar o registro de ECG, visualização através de monitor de vídeo e impressão. O conjunto deve ser composto de um analisador e três gravadores digitais. O analisador de Holter de ECG deve ser composto de: i) interface de leitura dos registros de ECG através de cartão de memória com entrada USB ou interface serial, ii) software de leitura e interpretação dos dados em português, iii) análise pediátrica, iv) análise de ruído para cada canal, v) análise de fibrilação atrial, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, seqüências ventriculares, frequência cardíaca, emparelhamentos, bigeminismo, trigeminismo, seqüências atriais, ectópicos ventriculares com atraso, contrações atriais e ventriculares prematuras, interferências, vi) detecção e análise de arritmias nos segmentos ST e QT, vii) análise da variabilidade da frequência cardíaca e viii) cálculos de SDNN, RMSSD, PNN50, índice SDNN, índice SD ANN, histograma de intervalos R-R médios e taocogramas. Características técnicas mínimas do Holter de ECG: i) o aparelho deve ser digital com resolução mínima de 12 bits, ii) gravação em 3 canais de sinal de ECG, iii) sistema de gravação de 24 e 48 horas contínuas, no mínimo, iv) memória do tipo cartão de memória SD (de 2GB expansível para no mínimo 32GB), v) taxa de amostragem mínima de 10000 Hz de amostragem por detecção sincronoma de 3 canais, vi) tela de cristal líquido com para visualização em tempo real das informações e dos canais de ECG individuais, vii) detecção

Autonomia de cabo solto, viii) transmissão completa dos dados em 10 segundos com análise automática da fibrilação atrial com precisão igual ou maior de 97 por cento, ix) deve possuir autonomia de 48 horas de gravação ininterruptas, x) peso máximo de 170 g (sem pilhas) e resistente a água, xii) análise ECG de alta resolução (1000 amostras por segundo) e xiii) análise pediátrica. Computador com software instalado para análise da gravação realizada pela unidade gravadora portátil com função de transferência direta de dados via USB / Wireless. Computador que contenha no mínimo: teclado, gabinete, monitor LCD, mouse, com todas as licenças dos softwares utilizados / instalados e impressora. Deverão acompanhar o sistema todos os acessórios aplicáveis necessários para sua utilização. Alimentação. Pilha AAA ou bateria recarregáveis. Acessórios* 3 gravadores de holter, driver para leitura do cartão de memória SD, 1 cabo de ECG de 5 vias, 1 cartão de memória SD de no mínimo 2 GB e 1 carregador de pilhas ou baterias.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

É permitido solicitar computador e impressora dentro do Sistema Holter. O Sistema deve ser composto minimamente do software (interface gráfica para visualização e diagnóstico do exame) e um componente de hardware (gravador). Além da descrição básica, deve conter características e / ou informações referentes ao: número de canais, características do software, memória, alimentação, transferência de dados, acessórios aplicáveis e demais características técnicas que agreguem valor ao equipamento.

**Não será passível de aprovação a descrição que não possua software e no mínimo um gravador.

Ambientes

Empresa Participante do PROOCOT	Página na Internet	Telefone
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	http://www.prolife.com.br	(11)50817190

O PROOCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROOCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br



PROCESSO DE LICITAÇÃO

CLÍNICA RADIOLÓGICA
- PAASSEx 2023 -

- REQUISITÓRIA
- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
- BOLETIM INTERNO
- MAPA DE RISCO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- PARECER TÉCNICO
- FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA
- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- MAPA COMPARATIVO
- RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO
- ANÁLISE CRÍTICA
- JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
- TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO
- AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
- APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- PESQUISA DE PREÇOS

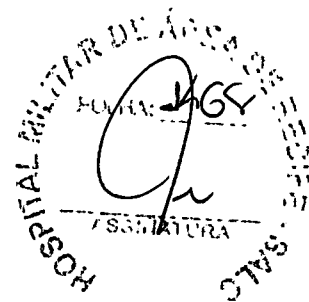

PROCESSO DE LICITAÇÃO

CLÍNICA RADIOLÓGICA

- PAASSE_x 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS
(PAINEL DE PREÇOS)

MÉDIA
R\$ 104.950,00
MEDIANA
R\$ 104.950,00
MENOR
R\$ 94.000

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 449554
Ano da Compra 2022
Modalidade da Compra Pregão

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00042/2022	00008	Pregão	449554	APARELHO RAIOS X		UNIDADE	1	R\$94000	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DISTRITO FEDERAL	450432 - SECRETARIA DE EST.DE EDUCACAO DO DIST.FEDERAL	28/12/2022
00002/2022	00001	Pregão	449554	APARELHO RAIOS X		UNIDADE	1	R\$115900	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	ESTADO DE MINAS GERAIS	985301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO	13/05/2022





PROCESSO DE LICITAÇÃO

CLÍNICA RADIOLÓGICA

- PAASSE_x 2023 -

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

PESQUISA DE PREÇOS

(ATAS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2022

985301.22022.12561.4470.7500249402



Às 09:00 horas do dia 01 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 004/2022 de 04/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 138/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Raio X, digitalizadora CR, impressora DRY e equipamentos hospitalares conforme emenda parlamentar da proposta 14444.600000/1210-01 do FNS-Fundo Nacional de Saúde para a prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparelho raios x

Descrição Complementar: Aparelho Raios X Tipo: Analógico , Corrente: Máximo De 630 MA, Tensão: Máximo De 125 KV, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão , Outros Componentes: Bucky E Mesa , Capacidade 1: Mínimo De 180 K

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 138.324,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VMI TECNOLOGIAS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 115.900,0000 .

Item: 2

Descrição: Sistema digitalização imagem radiológica

Descrição Complementar: Tipo: Portátil, Componentes: C/ Monitor E Acessórios, Compatibilidade: Compatível Com Placas Até 35 X 43 Cm, Componentes Adicionais: Software Integrado, Acessórios: C/ Impressora E Porta Usb,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 141.833,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FUJIFILM DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 79.500,0000 .

Item: 3

Descrição: Apoio de braço para coleta de sangue

Descrição Complementar: Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Esmaltado , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 313,1800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 3,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SILVIO VIGIDO, pelo melhor lance de R\$ 220,0000 .

Item: 4

Descrição: Aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 120.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 16.288,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J C SERAFINI REFRIGERACAO, pelo melhor lance de R\$ 11.050,0000 .

Item: 5

Descrição: Comadre

Descrição Complementar: Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 3.500 ML, Tamanho: Tamanho Adulto Padrão Mundial, Característica Adicional: C/Alça,



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PROCESSO DE LICITAÇÃO

CLÍNICA RADIOLÓGICA

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(SÍTIOS ELETRÔNICOS)



PROCESSO DE LICITAÇÃO

CLÍNICA RADIOLÓGICA

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(FORNECEDORES)



A handwritten signature in black ink, located below the circular stamp.


PROCESSO DE LICITAÇÃO

CLÍNICA RADIOLÓGICA

- PAASSE_x 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS
(FNS)

Detalhe Equipamento



Equipamento
Aparelho de Raios X - Fixo Analógico

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Radiologia

Atividade

Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Ambiente

Sala de exames (com comando) - Geral - Odontológico - Mama - Densitometria

Item

10912

Nomenclatura

Aparelho de Raios X - Fixo Analógico

Sinônimos

Aparelho de Raios-X Fixo, Raios-x Fixo, Aparelho para Radiografia, RX

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Equipamento emissor de Raios X para fins de diagnóstico médico.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 178.769,00

GERADORPOTÊNCIA | TENSÃO | CORRENTE :40 KW OU SUPERIOR | 40 A 125KV OU SUPERIOR | MÁXIMO 500MA OU SUPERIOR TUBOFOCO FINO | GROSSO : FF:MINIMO DE 0,6MM | FG:IGUAL A 1,2MMMESATIPO | CAPACIDADE | BUCK MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL:FIXA COM TAMPO FLUTUANTE |MINIMO 160 KG | DESLOCAMENTO DE MINIMO DE 120 CM ESTATIVA PORTA TUBO: POSSUIPAINEL DE COMANDO: POSSUICOLIMADOR: POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

*Nos sistemas de cadastro de propostas de projetos de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada.

PAINEL DE COMANDO:

Opção 1: POSSUI

Opção 1: POSSUI

ESTANHA PORTA TUBO:

- GERADOR POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE):
Opção 1: 407KW OU SUPERIOR/40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO 500MA OU SUPERIOR

- TUBO (FOCO FINO/FOCO GROSSO):

Opção 1: FF:MINIMO DE 0,6MM/FG:IGUAL A 1,2MM;

Opção 2: FF:MINIMO DE 0,6MM/FG: MAXIMO DE 1,0MM;

Opção 3: FF:MINIMO DE 1,0MM/FG:MINIMO DE 1,5MM.

- COLIMADOR:

Opção 1: POSSUI

- MESA (TIPO/CAPACIDADE)/BUCK MURAL (DESLOCAMENTO VERTICAL):

Opção 1: FIXA COM TAMPO FLUTUANTE/MINIMO 160 KG/DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 120 CM

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Empresa Participante do PROCOT

AGFA HEALTHCARE

FUJIFILM DO BRASIL LTDA.

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

IMEX MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA.

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.

Página na Internet

<http://http://www.agfa.com.br>

<http://www.fujifilmamericas.com.br/>

<http://www3.gehealthcare.com.br/>

<http://https://www.imexmedicalgroup.com.br>

<http://https://www.konicaminolta.com/medicalusa/>

<http://www.konimagem.com.br>

Telefone

(11)51886415

(11)50914000

0800122345

(48)32518800

(31)31174400

(11)29501971

RECIFE - SAUDE
ASSINATURA
HOSPITAL PHILIPS

Empresa Participante do PROCOT

	Página na Internet	Telefone
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	http://www.lotushealthcare.com.br	(41)30742100
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt	(11)21250600
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	http://www.shimadzu.com.br	(11)2424-1700
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A.	http://www.siemens.com.br	(11)39083668
VMI TECNOLOGIAS LTDA	http://www.vmi-medica.com.br	(31)33703750

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br





PROCESSO DE LICITAÇÃO

UCE

- PAASSEx 2023 -

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L.P.' or similar, written over a horizontal line.

PESQUISA DE PREÇOS

(FORNECEDORES)

C000942-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Carol de Aquiar

hmar@tecsaude.com.br

8121234844

09.577.422/0002-80

Proposta Emitida por

Daniel Valerio

daniel.valerio@safesolucoes.com.br

(81) 9732-2332

Em atenção à sua consulta, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., proposta comercial cujo objetivo é o fornecimento de produto de mais avançada tecnologia.

Colocamos-nos à sua disposição para esclarecermos quaisquer dúvidas referentes a assuntos técnicos ou comerciais e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Item: 1 VENTILADOR SV300 / APARELHO DE VENTILACAO MECANICA (SUB: EV20B-PA00281)

Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/PI	V. Total
MIN-008	VENTILADOR SV300 / APARELHO DE VENTILACAO MECANICA (SUB: EV20B-PA00281)	6	UN	83.200,00	499.200,00

Item: 2 PEDESTAL PARA TRANSPORTE DE VENTILADOR SV300 (NACIONAL)

Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/PI	V. Total
CAR-SV300	PEDESTAL PARA TRANSPORTE DE VENTILADOR SV300 (NACIONAL)	6	UN	4.000,00	24.000,00

Item: 3 TRAQUEIA ADULTO 22 X 1600 60 SHORE A - TRANSLUCIDO


Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/PI	V. Total
H0087 00.60	TRAQUEIA ADULTO 22 X 1600 60 SHORE A - TRANSLUCIDO	6	UN	160,00	960,00

Item: 4 TRAQUEIA ADULTO 22 X 1600 60 SHORE A - TRANSLUCIDO

Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/PI	V. Total
H0087.00.60	TRAQUEIA ADULTO 22 X 1600 60 SHORE A - TRANSLUCIDO	6	UN	160,00	960,00

Item: 5 CONECTOR Y ADULTO AUTOCLAVAVEL SEM FUROS

Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/PI	V. Total
2400/21	CONECTOR Y ADULTO AUTOCLAVAVEL SEM FUROS	6	UN	80,00	480,00

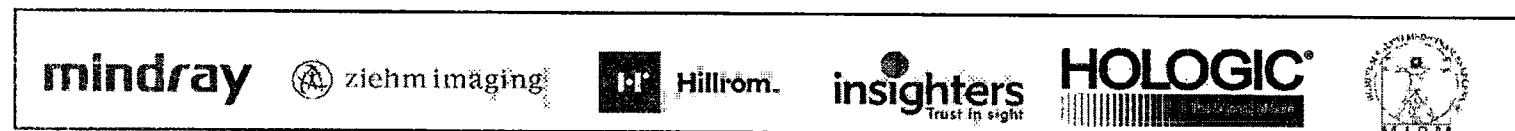

C000942-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Carol de Aquiar

hmar@tecsaude.com.br

8121234844

09.577.422/0002-80

Item: 6 SENSOR DE FLUXO NEO REUSE PARA VENTILADOR SV300 MINDRAY (Ref- 012-000190-00)					
Código	Desc. Produto	Qty	UM	V. Unit c/PII	V. Total
MIN-438	SENSOR DE FLUXO NEO REUSE PARA VENTILADOR SV300 MINDRAY (Ref-012-000190-00)	6	UN	6.000,00	36.000,00

Item: 7 CABO PROXIMAL PARA SENSOR DE FLUXO NEO - SV300 MINDRAY (040-006072-00)					
Código	Desc. Produto	Qty	UM	V. Unit c/PII	V. Total
N 439	CABO PROXIMAL PARA SENSOR DE FLUXO NEO - SV300 MINDRAY (040-006072-00)	6	UN	2.000,00	12.000,00

Valor líquido: 573.600,00

Condições de Faturamento:


Condição de Pagamento : 0 DD
 Prazo de Entrega : 10 Dias após aprovação
 Validade da Proposta : 492 DD
 Frete : Emitente
 Garantia do Equipamento : 1 Ano
 Garantia do Acessório : 3 Meses
 Faturamento Mínimo : R\$ 2.000,00

Observações:

Ventilador de transporte invasivo

Atenciosamente


Daniel Valerio

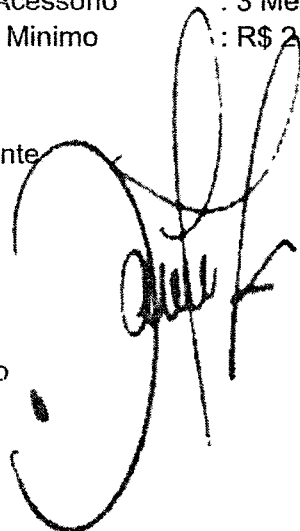

Aprovação do Cliente:

Data ____/____/____

Nome _____



C000942-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Carol de Aquiar
hmar@tecsaude.com.br
8121234844
09.577 422/0002-80

Proposta Emitida por:
Daniel Valerio
daniel.valerio@safesolucoes.com.br
(81) 9732-2332

Em atenção à sua consulta, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., proposta comercial cujo objetivo é o fornecimento de produto de mais avançada tecnologia.

Colocamos-nos à sua disposição para esclarecermos quaisquer dúvidas referentes a assuntos técnicos ou comerciais e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/Imp	V. Total
MIN-106	CARDIOVERSOR BENEHEART D3 BÁSICO MP	2	UN	26.700,00	53.400,00

Valor líquido: 53.400,00

Condições de Faturamento:

Condição de Pagamento : 0 DD
Prazo de Entrega : 10 Dias após aprovação
Validade da Proposta : 492 DD
Frete : Emitente
Garantia do Equipamento : 1 Ano
Garantia do Acessório : 3 Meses
Faturamento Mínimo : R\$ 2.000,00

Observações:

Cardioversor Portatil


Atenciosamente

Daniel Valerio

Aprovação do Cliente:

Data _____ / _____ / _____

Nome _____





PROCESSO DE LICITAÇÃO

UCE

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(FNS)

Detalhe Equipamento

Ocorreu um erro no servidor

MILITAR DE ARMA
FOLHA: 14
Equipamento
BIPAP com Monitor Gráfico
Unidade Funcional / Unidade
Internação / Internação Intensiva-UTI / CTI

Atividade
Internação - Hospital
Ambiente
Área coletiva de tratamento (exceto neonatologia)



Item
11241

Nomenclatura
BIPAP com Monitor Gráfico

Sinônimos
BIPAP, Ventilador BIPAP, Respirador BIPAP

Classificação
Médico Assistencial

Definição e Aplicação
Sistema de suporte ventilatório não-invasivo que possua monitor gráfico para monitorização dos parâmetros em UTI.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1


Preço Sugerido
R\$ 33.908,00

BIPAP com monitor gráfico. Deve operar com faixa de pressão de mínimo: 4 a 30 cm de H2O; Frequência respiratória mínima de 0 a 40 BPM. Possuir indicação de monitoração; Possuir alarmes internos; Oferecer no mínimo três modos ventilatórios. Deve realizar leituras no mínimo dos parâmetros IPAP, EPAP, CPAP, Frequência Respiratória, Tempo Inspiratório e Volume Corrente. Deve permitir o registro de dados. Possuir monitor gráfico em LCD que mostra os parâmetros em display. Bateria interna, umidificador e máscara.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o):

Executar, quando aplicável, IPAP, EPAP e CPAP; Definir os modos de ventilação aplicados; Possuir controle de IPAP, EPAP e CPAP e demais modos de ventilação; Definir o tipo de paciente (adulto/pediátrico); Definir faixa de pressão máxima para os modos ventilatórios; Definir frequência respiratória por minuto; Definir alarmes; Definir nível de

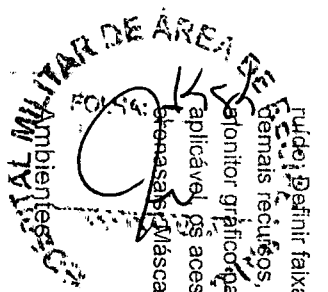

Definir faixa de Rise time, frequência, etc; Definir se possui umificador, Definir
Demais recursos, funcionalidades, softwares, ajustes, conexão
Monitor gráfico para visualização dos parâmetros monitorados. Determinar quando
aplicável os acessórios: Circuitos de paciente autoclaváveis, Máscaras faciais, Máscaras
Respiratórias, Máscaras nasais, Filtros. Alimentação: 110/220 V - 60 Hz.

Os e-mails devem ser enviados ao servidor

Empresa Participante do PROCOT
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Página na Internet
<http://www.equipamed.com.br>

Telefone
(11)50351500

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

RECEPTE Detalhe Equipamento

Ocorreu um erro no servidor

Equipamento
Cardioversor

Unidade Funcional / Unidade
Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratório

Atividade
Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Ambiente
Sala de recuperação



Item
936

Nomenclatura
Cardioversor

Sinônimos
Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG

Classificação
Médico Assistencial

Definição e Aplicação
Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 23.496,00

COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPAROMEMÓRIA DE ECG: POSSUMARCAPASSO | MÓDULO DEA | OXIMETRIA: NÃO POSSUI | POSSUI | NÃO POSSUI IMPRESSORA:
POSSUIBATERIA: POSSUIPÁS INTERNAS: NÃO POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a se

COMANDO DAS PÁS:
Opção 1: CARGA E DISPARO

MEMÓRIA DE ECG.
Opção 1: POSSUI

FOHA
Opção 1: POSSUI

MARCA POSSUI/MÓDULO DE AOXIMETRIA:
Opção 1: NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/POSSUI

Opção 3: NÃO POSSUI/POSSUI/NÃO POSSUI

Opção 4: NÃO POSSUI/ POSSUI/POSSUI

Opção 5: POSSUI/POSSUI/NÃO POSSUI

Opção 6: POSSUI/POSSUI/POSSUI

IMPRESSORA:

Opção 1: POSSUI

BATERIA:

Opção 1: POSSUI

PÁS INTERNAS:

Opção 1: POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ocorreu um erro no servidor



Ambientes

Empresa Participante do PROCOT

CMOS DRAKE DO NORDESTE

DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI

HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.

MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Página na Internet

<http://www.cmosdrake.com.br/>

<http://diversamed.com.br/>

<http://www.hatril.com.br>

<http://www.instramed.com.br>

<http://www.mindray.com/pf/index.html>

Telefone


(31)35473944

(62)985913635

(61)33813700

(51)30738228

(11)36721443

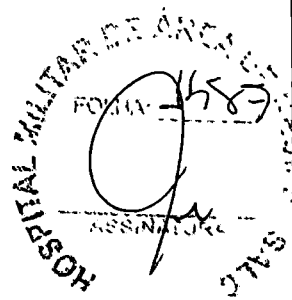

Empresa Participante do PROCOT

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS ~~EMERSON~~ um erro no servidor

PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

STRYKER DO BRASIL LTDA.

TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA

TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA.

Página na Internet

http://www.healthcare.philips.com/br_p/

<http://www.prolife.com.br>

<http://www.stryker.com.br>

<http://www.teb.com.br>

<http://www.transform.ind.br>

Telefone

(11)21250600

(11)50817190

(11)51892500

(11)50188855

(11)21143000

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br



PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI/UCE
- PAASSEx 2023 -

- REQUISITÓRIA
- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
- BOLETIM INTERNO
- MAPA DE RISCO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- PARECER TÉCNICO
- FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA
- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- MAPA COMPARATIVO
- RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO
- ANÁLISE CRÍTICA
- JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
- TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO
- AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
- APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- PESQUISA DE PREÇOS



PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI/UCE

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(PAINEL DE PREÇOS)

Painel de Preços



GOVERNO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA
 GESTÃO E DA INOVAÇÃO
 EM SERVIÇOS PÚBLICOS

MEDIA
R\$ 7.503,33
 MEDIANA
R\$ 7.400,00
 MENOR
R\$ 7.330

FILTROS APLICADOS
 Código Material/Serviço Ano da Compra Esfera
422565 2022, 2023 Federal

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2022	00025	Pregão	422565	MONITOR MULTIPARÂMETRO		UNIDADE	4	R\$7330	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE	28/04/2022
00002/2022	00041	Pregão	422565	MONITOR MULTIPARÂMETRO		UNIDADE	1	RS7400	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE	28/04/2022
00005/2022	00035	Pregão	422565	MONITOR MULTIPARÂMETRO		UNIDADE	1	RS7780	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160151 - MEX-9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/MS	28/12/2022



MEDIA
R\$ 6.091,00

MEDIANA
R\$ 5.800,00

MENOR
R\$ 5.300

FILTROS APLICADOS

Codigo Material/Serviço Descrição

404168 ELETROCARDIOGRAFO, MODELO: DIGITAL, PORTÁTIL C/ ALÇA, TIPO: TELA LCD 2X16, 12 CANAIS, VOLTAGEM: 110/220 V, FUNÇÕES: TECLADO MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO REGISTRO: C/ 12 DERIVAÇÕES, LEITURA DIAGNÓSTICA, VELOCIDADE REGISTRO: 12,5; 25 E 50 MM/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEMÓRIA P/ 100 EXAMES, ACESSÓRIOS: CABO ALIMENTAÇÃO, CABO PACIENTE 10 VIAS, TIPO IMPRESSORA: IMPRESSÃO PAPEL A4, ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Data da Compra	Esfera
00004/2021	00014	Pregão	404168	ELETROCARDIOGRAFO		UNIDADE	3	R\$5300	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160359 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE/RS	2022, 2023	Compra	14/06/2022	Federal
00012/2022	00011	Pregão	404168	ELETROCARDIOGRAFO		UNIDADE	1	R\$5799,99	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARE	JUSTICA DO TRABALHO	080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	2022, 2023	Compra	15/07/2022	Federal
00009/2022	00003	Pregão	404168	ELETROCARDIOGRAFO		UNIDADE	1	R\$5800	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	158719 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	2022, 2023	Compra	14/10/2022	Federal
00006/2022	00015	Pregão	404158	ELETROCARDIOGRAFO		UNIDADE	5	R\$6765	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DA MARINHA	787700 - HOSPITAL NAVAL DE BRASIA	2022, 2023	Compra	14/10/2022	Federal

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RESERVA
SALC
22/10/2022
SINATURA



PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI/UCE

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(ATAS)

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

160530.22022.74963.4958.101833796692



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00002/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 16 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI Nº 27, B Adm Ap/CMO de 08/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 65303001427202280, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, PARA A UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO SANITÁRIA DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AO CMO, conforme Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército - PAASSEX 2022.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparelho purificador de água

Descrição Complementar: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.155,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, pelo melhor lance de R\$ 1.123,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 2

Descrição: Porta Amálgama

Descrição Complementar: Porta Amálgama Material: Náilon , Tipo: Autoclavável , Características Adicionais: Mola Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 553,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Reanimador manual

Descrição Complementar: Reanimador Manual Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 130,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.198,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.925,9200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0.01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.360,0000 e com valor negociado a R\$ 8.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 41

Descrição: Monitor Multiparâmetro
Descrição Complementar: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes/Bateria , Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp , Registros: Mínimo 6 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução , Tipo: Pré Configurado/Modular , Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 38.516,6300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não


Aceito para: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.480,0000 e com valor negociado a R\$ 7.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Aparelho purificador de água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H - MOD. LUCA-310 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC; - Indicação de pureza da água; - Sistema de coluna intercambiável; - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna; - Produz água com condutividade inferior a 4µS e pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla Isolação); - Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x15cm; - Ciclos Aproximados: 500 Litros; - Vazão: 50 L/Hora; - Acompanha: cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	15/03/2022 11:44:39
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: DAU50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , C Vazão 50 l/h Dimensões 15 x 74,5 Elemento 5 litros de resina mista Rendimento 900 litros Potência (W) 9 Carcaça confeccionada em PVC branco. Coluna deionizadora de 50 l/h; Condutímetro de alarme ótico; Leito de resina mista, catiônica e aniônica; Bivolt; Requer baixa pressão de alimentação; Regeneração da coluna à base de troca. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	15/03/2022 14:20:47
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS Marca: Osmose reversa Fabricante: Osmose reversa Modelo / Versão: Aparelho Purificador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutímetro e Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Voltagem: 110/220 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	16/03/2022 00:04:39
36.045.363/0001-90	MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO 15239420530 Marca: SP LABOR Fabricante: SP LABOR Modelo / Versão: SP 050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutímetro De Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/03/2022 22:11:39

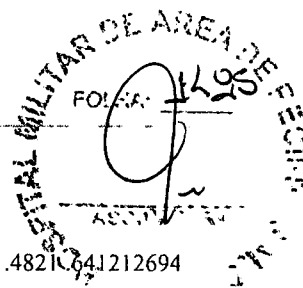

Este pregão possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Posterior

160176.52023.155731.48210641212694



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Aditamento 2 ao Bol Int 2 de 03/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 64278021231202201, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00005/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente para a seção de saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Arquivo escritório

Descrição Complementar: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Aplicação: Pastas Suspensas , Cor: Cinza Claro , Características Adicionais: Porta Etiqueta / Puxador Embutido / Sist. Seguran- , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.073,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 2

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material: Madeira Aglomerada , Altura: 1,60 M, Cor: Argila , Largura: 90 CM, Características Adicionais: Com Dobradiça E Chave , Profundidade: 50 CM, Material Porta: Madeira Aglomerada , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 784,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 640,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 3

Descrição: Ar condicionado central

Descrição Complementar: Ar Condicionado Central Vazão Ar: 550 M3/H, Capacidade: 12.000 BTU, Pressão Estática: 0 MMCA, Características Adicionais: Externa (Mono Split) E Controle Remoto Sem Fio (Hi , Freqüência: 60 HZ, Altura Interna: 250 MM, Largura Interna: 250 MM, Potência: 1,35 KW, Altura Externa: 540 MM, Largura Externa: 780 MM, Tensão: 220 V, Tipo Instalação: Posição Horizontal , Quantidade Fases: 1 UN, Profundidade Interna: 188 MM, Profundidade Externa: 250 MM, Peso Externo: 34 KG, Peso Interno: 8,5 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.774,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado


Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CH COMERCIO VAREJISTA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.764,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 4

Descrição: Aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

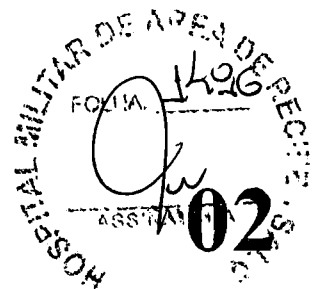

PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI/UCE

- PAASSEx 2023 -


PESQUISA DE PREÇOS

(SÍTIOS ELETRÔNICOS)



Monitor de Triagem (SPO2 / TEMP / PNI) Vita i20
- Alfamed

R\$ 9.247,95

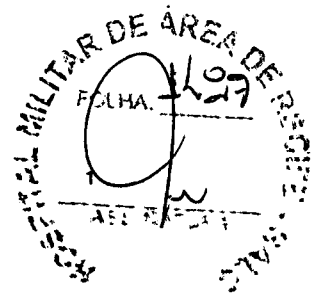

+Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com

todos os prazos e valores.



CALCULAR



SUBTOTAL R\$ 9.247,95


TOTAL R\$ 9.247,95

[ESCOLHER MAIS PRODUTOS](#)

PAGAMENTO

SITE SEGURO

Eletrcardiógrafo CardioCare 2000 ...R\$ 7.502,99 à vista

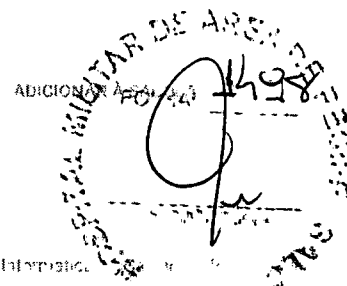

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Ofertas do Dia](#)

[Ofertas do Dia](#)

[Celulares](#)

[Móveis](#)

[Eletrodomésticos](#)


[TV e Vídeo](#)

[Informática](#)

Magalu > Saúde e Cuidados Pessoais > Hospitalar > Equipamento Médico e Hospitalar > Eletrcardiógrafo > Eletrcardiógrafo CardioCare 2000 12 canais Completo E

Eletrcardiógrafo CardioCare 2000 12 canais Completo Bionet

Código de barras: 74499011 | [Ver descrição completa](#) | [Bionet](#)

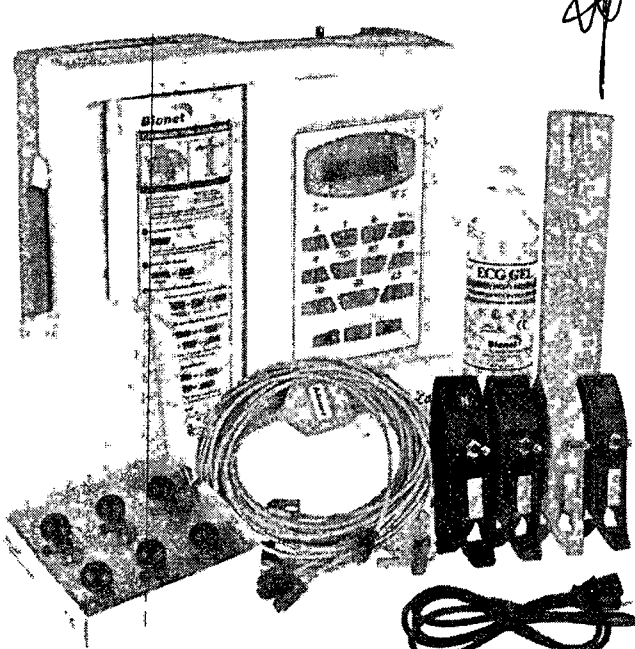

★★★★☆ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Medjet**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 11.222,78

R\$ 7.502,99

ou R\$ 7.502,99 em 10x de R\$ 750,30 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR A SACOLA](#)

[Calcular frete e prazo](#)

+ 2

Informações do Produto

Eletrcardiógrafo CardioCare 2000 12 canais Completo Bionet

Eletrcardiógrafo CardioCare 2000 12 canais Bionet O eletrcardiógrafo mais vendido do BRASIL!

O CardioCare 2000 oferece rapidez, simplicidade, e avançados recursos de conectividade para proporcionar os melhores cuidados aos pacientes, a um preço acessível! O CardioCare 2000 possui 12 canais que verificam e gravam o eletrcardiograma do paciente. Fornece o registro de ECG e os parâmetros de medida para diagnóstico e informações do paciente e a identificação do operador são impressas com o ECG no relatório de saída facilitando o controle e a identificação do exame. O ECG é facilmente um relatório tamanho A4. Além da alimentação Bivolt, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Isto possibilita o uso do Car ambulâncias, visitas à pacientes ou durante o transporte do paciente. Informações do Produto:- Impressão em formato A4 permite fácil visualização:

- Função copia permite varias impressões de um único paciente;
- Baixo custo de impressão Função grade permite o uso de papel fax;
- Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor);

- Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos;
- Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais;
- Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota;
- Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax);
- Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V;
- Impressora térmica integrada de alta resolução
- Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4
- Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax
- Interpretação do ECG e medidas complexas

Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum

Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte

Garantia 1 ANO Conteúdo da Embalagem: - 01 Eletrcardiógrafo CardioCare-2000 Bionet;

01 Cabo de força com 3 pinos;


01 Cabo paciente de 10 vias tipo Garra;

medjet

RECEBIMOS
27/04/2014
FOLHA Nº 01
DE 01

O que você procura?

VIDEO

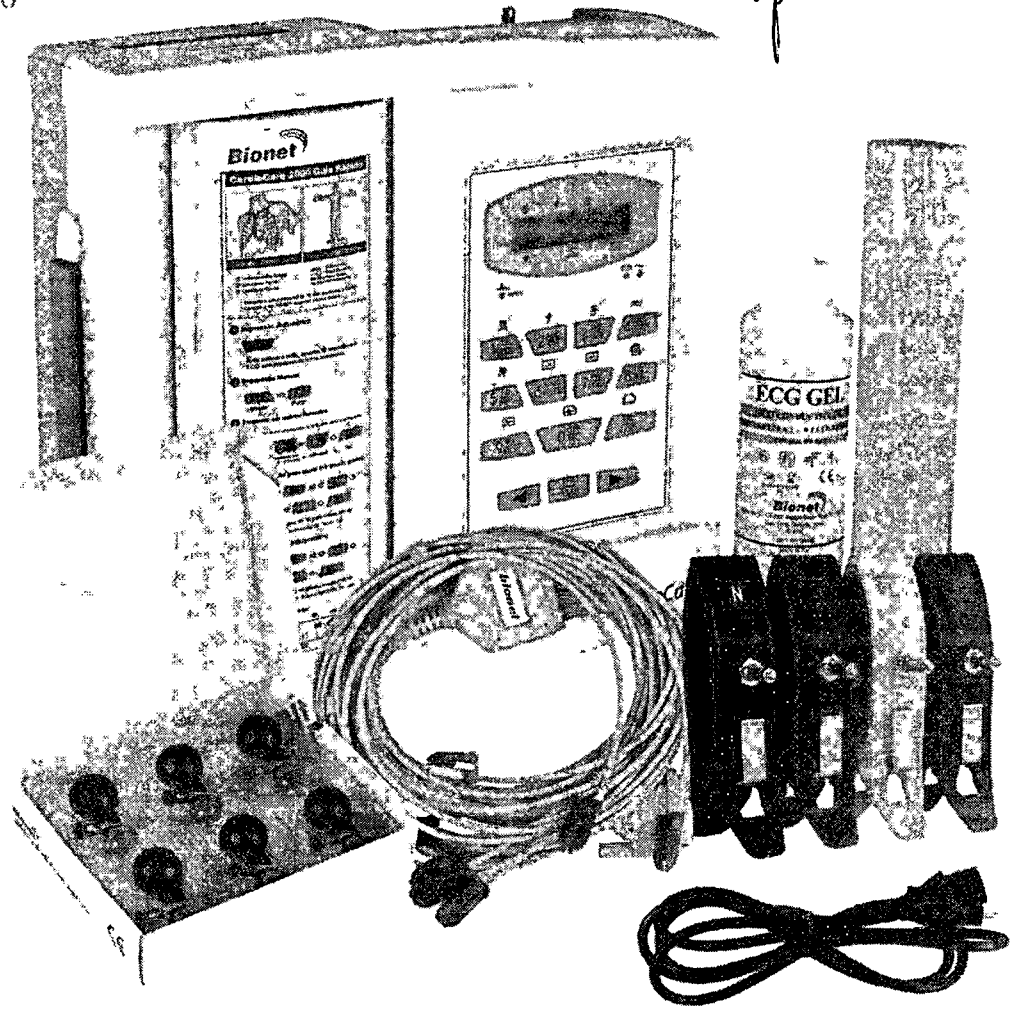

DIÁ AQUI

FRETE GRATIS


Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 12 canais Completo Bionet

Disponibilidade: Imediata
I00056

De R\$ 9.199,00 **R\$ 6.149,99**

R\$ 5.842,49 à vista com desconto Boleto Bancário

Mais informações

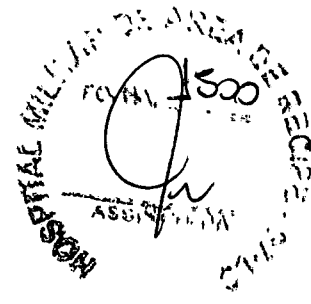

- Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4
- Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax
- Interpretação do ECG e medidas complexas
- Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum
- Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte
- Garantia: 1 ano;

Conteúdo da Embalagem:

- 01 Eletrocardiógrafo CardioCare-2000 Bionet;
- 01 Cabo de força com 3 pinos;
- 01 Cabo paciente de 10 vias tipo Garra;
- 06 eletrodos precordiais ;
- 04 eletrodos de membros;
- 01 Tubo de gel condutor;
- 01 Rolo de papel térmico;

Modelo: CardioCare-2000 (EKG-2000)
Garantia: 1 ANO
Registro na Anvisa: 80070210004

Para baixar o manual e software, [clique aqui.](#)

Ficha técnica

Código	100056
Código de barras	7899636100689
Categoria	ECG - Eletrocardiógrafo
Marca	Bionet
Itens Inclusos	01 Eletrocardiógrafo CardioCare-2000 Bionet; 01 Cabo de força com 3 pinos; 01 Cabo paciente de 10 vias tipo Garra; 06 eletrodos precordiais ; 04 eletrodos de membros; 01 Tubo de gel condutor; 01 Guia de operação em Português; 01 Software para computador (CD); 01 Rolo de papel térmico;


INSTITUCIONAL

ATENDIMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO

EMPRESA AUTORIZADA


SELOS DE SEGURANÇA

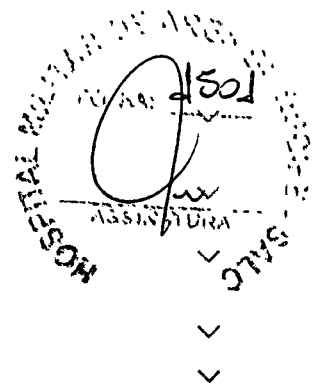

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Medjet Ltda. - CNPJ: 16.877.544/0001-76.
Rua Iririú, 1139 - Joinville - SC - 89221-515
Responsável Técnico: Ricardo Mira da Silva - CRF/SC 3499

Tecnologia TrayCommerce

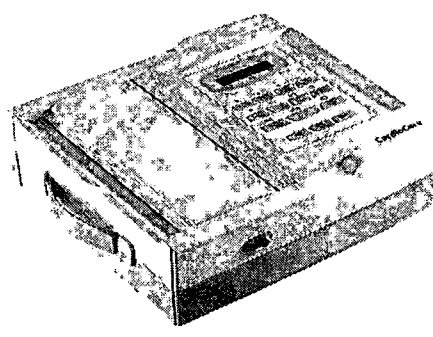

Handwritten signature or initials.



(https://api.whatsapp.com/send?text=Eletrocardi%C3%B3grafo%20Interpretativo%20Digital%2012%20canais%20CardioCare%202000%20-%20Bionet%20http%3A%2F%2Fwww.produtoshospitalaresonline.com.br/eletrocardiografo-interpretativo-digital-12-canais-cardiocare-2000-bionet)

Eletrocardiógrafo Interpretativo Digital 12 canais CardioCare 2000 - Bionet

Código 100056

Marca: Bionet (https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/marca/bionet.html)

6.879,90

R\$ 6.155,90

até 6x de R\$ 1.025,98 sem juros
ou R\$ 5.848,10 via Boleto Bancário

Mais formas de pagamento

1



Comprar agora (https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/carrinho/produto/125785314/ac)

calcule o frete

CEP

calcular

COMPRE DE 10 WHATSAPP PAGUE À VISTA E GANHE 5% DE DESCONTO


(https://api.whatsapp.com/send?phone=5541992181817) (https://www.produtoshospitalaresonline.com.br)



Digite o que você procura

(https://wa.me/5541992181817) (https://www.produtoshospitalaresonline.com.br)

Q

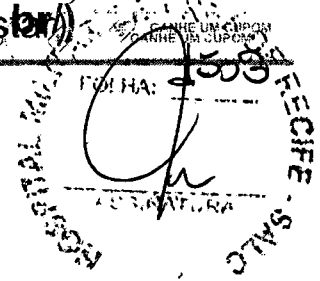

- Cartão paciente 10 vias tipo garra.
- Conjunto de 8 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros.
- 111 brilha de papel termo sensível com rendimento para 100 exames.
- 01 Tubo de gel condutor
- Alimentação - bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 volts.
- Manual de operação em português.


Registro ANVISA: 80332620015.

Garantia de 02 anos.

Para incluir itens opcionais ou solicitar orçamentos, entre em contato pelo telefone (41) 3888 4667 ou pelo email contato@produtoshospitalaresonline.com.br
Retornaremos o mais breve possível.

Produtos relacionados

(<https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/eletrocardiografo-12-canais-cardiotouch-3000-bionet>)



Eletrocardiógrafo 12 canais ^{12% OFF} CardioTouch 3000 - Bionet (<https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/eletrocardiografo-12-canais-cardiotouch-3000-bionet>)


~~R\$ 7.928,90~~ R\$ 6.890,00

até 6x de R\$ 1.148,33 sem juros

ou R\$ 6.545,50 via boleto bancário

Ver mais (<https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/eletrocardiografo-12-canais-cardiotouch-3000-bionet>)

(<https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/cabo-de-ecg-10-vias-tipo-banana-para-eletrocardiografo-cardiocare-2000-cardiotouch-3000-bionet>)



Cabo de ECG 10 Vias tipo Banana Para Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 / Cardiotouch 3000 - Bionet
(<https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/cabo-de-ecg-10-vias-tipo-banana-para-eletrocardiografo-cardiocare-2000-cardiotouch-3000-bionet>)


R\$ 1.579,90

até 6x de R\$ 263,31 sem juros

ou R\$ 1.500,90 via boleto bancário

Ver mais (<https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/cabo-de-ecg-10-vias-tipo-banana-para-eletrocardiografo-cardiocare-2000-cardiotouch-3000-bionet>)

(<https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/cabo-de-ecg-10-vias-tipo-garra-para-eletrocardiografo-cardiocare-2000-cardiotouch-3000-bionet>)





PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI/UCE

- PAASSEx 2023 -

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CP".


PESQUISA DE PREÇOS

(FORNECEDORES)



**TEKMARKET INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.579.468/0001-52
Endereço: Rua Alameda da Inovação, nº 270 –
Salas 004, Cidade: Campo Bom - RS Bairro:
Zona Industrial CEP: 93700-000

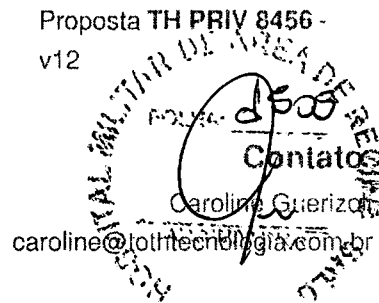

Dados da empresa

Razão social: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Nome empresa: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

CNPJ: 09.577.422/0001-07

E-mails: hger@hger.com.br

Telefones: +55 (81) 99605-7111, +55 (81) 2123-4844,
+55 (81) 2123-4817

Endereço: RUA DO HOSPICIO, 563 - ANDAR PRIMEIRO. BOA VISTA Recife/PE 50050050

Produtos e serviços:

Qtd.	Foto	Ref.	Item	Tipo	Valor unit.	Desconto	Subtotal
1		3100	Monitor Smart Check - PNI e SPO2	Produto	R\$ 14.021,00	R\$ 2.804,20 (20.0 %)	R\$ 11.216,80
Pressão Não Invasiva, Oximetria, Frequência Cardíaca e Bluetooth. - Acessórios inclusos: Cabo de Força, Mangueira e Mangueira padrão Adulto 23-33 cm, Extensão e Sensor de Oximetria DS- 100A NELLCOR e Manual do Usuário - Nota: 00181980 - Registro Anvisa: 81658400001							
1		34000000	Carrinho de Transporte Smart	Produto	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 1.760,00
1		1242B	Termômetro Bluetooth	Produto	R\$ 560,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 560,00
1		30060004	Glicosímetro TD-4279/Hematócrito	Produto	R\$ 480,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 480,00

Resumo da proposta::

Subtotal em produtos: R\$ 14.016,80
Subtotal em serviços: R\$ 0,00
Subtotal geral: R\$ 14.016,80
Frete FOB R\$ 200,00
Valor final: R\$ 14.216,80

Previsão de entrega:
15 DIAS.

Forma de pagamento

Dados Bancários:

Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda

CNPJ 21.579.468/0001-52

~~Banco do Brasil~~

Agência: 07210-9


Conta corrente: 74076-4

~~Banco do Brasil~~

Agência: 5745-2

Conta: 13.270-5

Boleto, cartão de crédito, **PIX** ou transferência bancária;

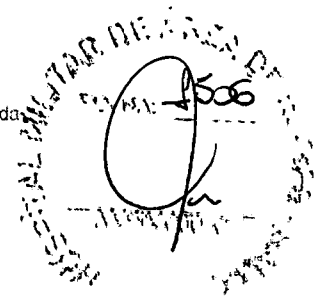

A handwritten signature in black ink, located to the right of the banking information.

Observações

Ao aprovar a presente proposta, declaro estar ciente e de acordo com as condições supracitadas.

C000942-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Carol de Aquiar

hmar@tecsaude.com.br

8121234844

09.577.422/0002-80




Proposta Emitida por:

Daniel Valerio

daniel.valerio@safesolucoes.com.br

(81) 9732-2332

Em atenção à sua consulta, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., proposta comercial cujo objetivo é o fornecimento de produto de mais avançada tecnologia.

Colocamos-nos à sua disposição para esclarecermos quaisquer dúvidas referentes a assuntos técnicos ou comerciais e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Item: 1 MONITOR DE TRIAGEM VS-600 SPO2 PNI TEMP					
Código	Desc. Produto	Qty	UM	V. Unit c/IPI	V. Total
MIN-443	MONITOR DE TRIAGEM VS-600 SPO2 PNI TEMP	2	UN	19.000,00	38.000,00

Valor líquido: 38.000,00

Condições de Faturamento:


Condição de Pagamento : 0 DD
 Prazo de Entrega : 10 Dias após aprovação
 Validade da Proposta : 492 DD
 Frete : Emitente
 Garantia do Equipamento : 1 Ano
 Garantia do Acessório : 3 Meses
 Faturamento Mínimo : R\$ 2.000,00

Observações:

Monitor de sinais vitais

Atenciosamente

Daniel Valerio

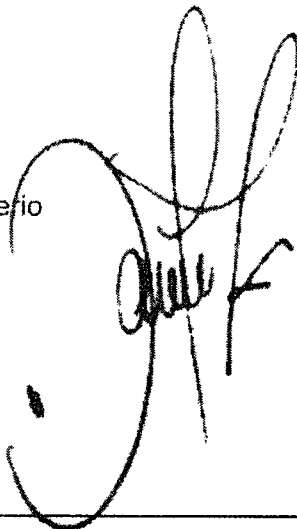

Aprovação do Cliente:

Data ____/____/____

Nome _____




C000942-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Carol de Auiar

hmar@tecsaude.com.br

8121234844

09 577.422/0002-80

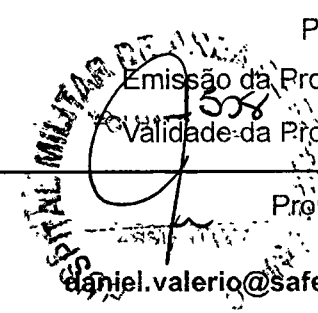Proposta Emitida por:

Daniel Valerio

daniel.valerio@safesolucoes.com.br

(81) 9732-2332

Em atenção à sua consulta, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., proposta comercial cujo objetivo é o fornecimento de produto de mais avançada tecnologia.

Colocamos-nos à sua disposição para esclarecermos quaisquer dúvidas referentes a assuntos técnicos ou comerciais e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Item: 1 ELETROCARDIOGRAFO BENEHEART R3 MINDRAY					
Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/PII	V. Total
BENEHEART R3	ELETROCARDIOGRAFO BENEHEART R3 MINDRAY	2	UN	8.800,00	17.600,00

Valor líquido: 17.600,00


Condições de Faturamento:

Condição de Pagamento : **0 DD**
 Prazo de Entrega : 10 Dias após aprovação
 Validade da Proposta : 492 DD
 Frete : Emitente
 Garantia do Equipamento : 1 Ano
 Garantia do Acessório : 3 Meses
 Faturamento Mínimo : R\$ 2.000,00

Observações:

Eletrocardiografo

Atenciosamente





Daniel Valerio

Aprovação do Cliente:

Data ____/____/____

Nome _____

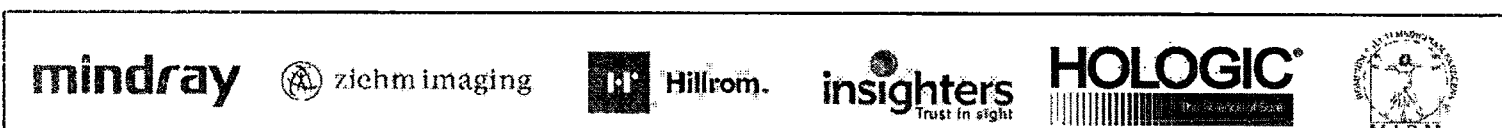

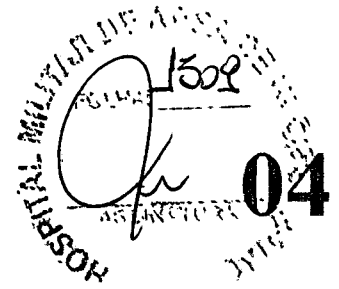

PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI/UCE

- PAASSEx 2023 -

A handwritten signature in black ink, located to the right of the text 'UTI/UCE' and '- PAASSEx 2023 -'.

PESQUISA DE PREÇOS

(FNS)

Detalhe Equipamento

Equipamento

Eletrocardiógrafo

Atividade

Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratório

Ambiente

Sala de recuperação



Item

451

Nomenclatura

Eletrocardiógrafo

Sinônimos

ECG, Eletrocardiograma

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Eletrocardiógrafo é um equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e convertê-la em registro gráfico.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1


Preço Sugerido

R\$ 14.010,00

CANALIS/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/OPERAÇÃO/CONNECT WIF-I/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO/ALIMENTAÇÃO: 12/POSSUI/DIRETA NO CONSOLE/SEM CONECTIVIDADE WIF/POSSUI EM FORMATO A4/REDE ELÉTRICA E BATERIA

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

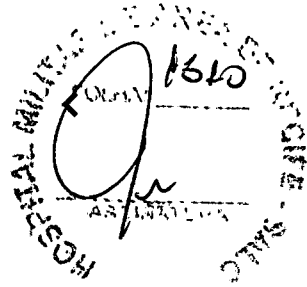

- CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/CONNECT WIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO/ALIMENTAÇÃO:

- OPÇÃO 1: 3/DIRETA NO CONSOLE/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4/REDE ELÉTRICA E BATERIA;
- OPÇÃO 2: 6/DIRETA NO CONSOLE/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4/REDE ELÉTRICA E BATERIA;
- OPÇÃO 3: 6/DIRETA NO CONSOLE/POSSUI/COM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4/REDE ELÉTRICA E BATERIA;
- OPÇÃO 4: 12/DIRETA NO CONSOLE/POSSUI/COM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4/REDE ELÉTRICA E BATERIA;
- OPÇÃO 5: 12/DIRETA NO CONSOLE/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4/REDE ELÉTRICA E BATERIA.

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Empresa Participante do PROCOT

ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

ARTMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

HILL-ROM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

HW SISTEMAS - HEARTWARE LTDA

MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA

PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA

Página na Internet

<http://www.alfamed.com>

<http://www.artmedical.net>

<http://www.macrosul.com>

<http://www3.gehealthcare.com.br/>

<http://www.hill-rom.com>

<http://www.heartware.com.br>

<http://www.mindray.com/pt/index.html>

http://www.healthcare.philips.com/br_pt/

<http://www.prolife.com.br>

<http://www.teb.com.br>

Telefone

(31)36816388

(51)32313415

(11)21663344

0800122345

(11)20252469


(11)21661726

(11)36721443

(11)21256600


(11)50817190


(11)50188855



O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

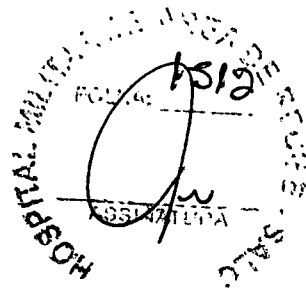

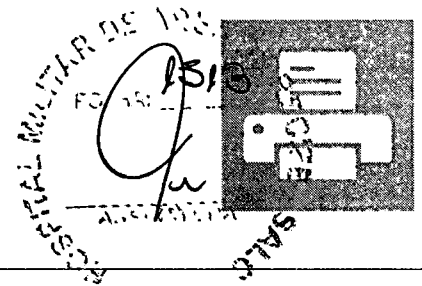

Página de Teste da Impressora do Windows

Você instalou corretamente Brother MFC-L6702DW Printer em HMARFARH01.

PROPRIEDADES DA IMPRESSORA

Horário de Envio: 10:08:35
Data: 18/05/2023
Nome de Usuário: HMAR\duarte
Nome do Computador: HMARFARH01
Nome da Impressora: Brother SALC
Modelo da Impressora: Brother MFC-L6702DW Printer
Suporte para Cores: Não
Nome(s) de Porta: IMPFISC0168A7B0
Formato de Dados: RAW
Nome do Compartilhamento de Impressora:
Processador de Impressão: winprint
Ambiente de SO: Windows x64


PROPRIEDADES DE DRIVER DE IMPRESSÃO

Nome do Driver: Brother MFC-L6702DW Printer
Tipo de Driver: Tipo 3 - Modo de Usuário
Versão do Driver: 1.9.0.0

ARQUIVOS ADICIONAIS DE DRIVER DE IMPRESSÃO

- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BREML6702DW.DAT
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_en-US.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_en-GB.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_fr-CA.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_fr-FR.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_de-DE.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_it-IT.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_es-ES.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_pt-PT.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_pt-BR.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_nl-NL.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_no-NO.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_sv-SE.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_da-DK.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_fi-FI.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_id-ID.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_ru-RU.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_bg-BG.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_uk-UA.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_cs-CZ.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_hu-HU.DLL
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLGM15A_pl-PL.DLL

...

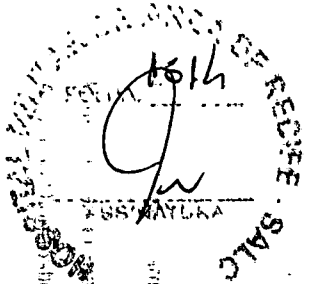

01/01/2014

Unidade de Terapia Intensiva / Intensivo
Ambiente
Sala de recuperação

Item

Nomenclatura

673

Monitor Multiparâmetros

Shimadzu

Monitor Multiparamétrico, Monitor de Sinais Vitais, Monitor Parâmetros Básicos, Monitor de Triagem

Classificação

Médico Assistencial

Indicação de Uso

Equipamento médico - meios para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adultos/pediátrico e neonatal.

A especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido


R\$ 18.666,00

Parâmetros: Altim e tamante do tronco, SPO2, P, temperatura, RESPIR, SPO2, PNI, TEMP | pré configuração de 10 a 12 par | com suporte

com suporte para 10 a 12 par | pré configuração de 10 a 12 par | com suporte

com suporte para 10 a 12 par | pré configuração de 10 a 12 par | com suporte

com suporte para 10 a 12 par | pré configuração de 10 a 12 par | com suporte

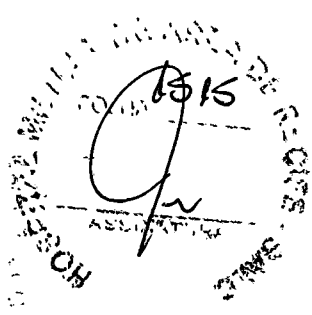

Para o processo licitatório, o proponente/licitante deverá descrever toda a
especificação técnica do item, comparabilizando no documento todas as características
(equipamentos) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retilar características que
modifiquem sua portabilidade ou valor.

Atendentes




Nome da Empresa	Telefone	Registro no Internet	Telefone
AIR KID, DE FRASCO, LTDA.	0999348	http://www.airkiddehealthcare.com.br	(11)55089471
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	0999348	http://www.alfamed.com	(31)36341500
GOVERNO DE SÃO PAULO - HOSPITAIS MAGALHÃES LTDA	0999348	http://www.niacosul.com	(41)2133000
DIVERSAMED (KODIJO) S.M.L. DOS HOSPITAIS E LABORATORIAIS EIRELI		http://diversamed.com.br/	(02)985913700
DRAGLIN KODIJO E COMÉRCIO LTDA		http://www.draqlin.com	(11)46890460
FRESENUS MEDICAL CARE LTDA		http://www.fhc-ag.com.br/	(11)25041400
HEALTHCARE EQUIPAMENTOS PARA EQUIP. MEDICINA HOSPITALARES S.LDA		http://www3.governo.sp.br/afhc-afhc.com.br/	(0800)122340
LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM S.LDA		http://www.labdiag.com.br/	(11)57903200



PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI
- PAASSEx 2023 -

- REQUISITÓRIA
- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
- BOLETIM INTERNO
- MAPA DE RISCO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- PARECER TÉCNICO
- FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA
- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- MAPA COMPARATIVO
- RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO
- ANÁLISE CRÍTICA
- JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
- TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO
- AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
- APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- PESQUISA DE PREÇOS




PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(PAINEL DE PREÇOS)



PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI

- PAASSEx 2023 -

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'L. P.' or similar, written in a cursive style.

PESQUISA DE PREÇOS

(ATAS)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Hospital Naval de Brasília

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 46/2022 de 14/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 63060003051202212, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de materiais permanentes para a Unidade de Terapia Intensiva, Centro de Endoscopia, Unidade de Internação e Centro Cirúrgico, visando atender as necessidades do Hospital Naval de Brasília, por um período de 12 (doze) meses conforme especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Cama Hospitalar

Descrição Complementar: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,10 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Tipos De Aclonamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Largura: Cerca De 0,80 M, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 21

Valor Estimado: R\$ 14.200,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STRYKER DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 15.281,0000 e a quantidade de 21 Unidade .

Item: 2

Descrição: Cama hospitalar

Descrição Complementar: Material: Aço Inoxidável, Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,10 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Tipos De Aclonamento: Controle Remoto, Tipo: Elétrica, Largura: Cerca De 0,80 M, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 14.200,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Reanimador manual

Descrição Complementar: Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Tamanhos: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 517,8200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 198,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 4

Descrição: Estetoscópio

Descrição Complementar: Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox, Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 440,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Monitor multiparâmetro

Descrição Complementar: Componentes: Alarmes, Uso: De Neonatal A Adulto, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 42.887,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

GCIFE - S/A
ASSINATURA

Aceito para: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 42.887,3300 e a quantidade de 7 Unidades.

Item: 6

Descrição: Monitor multiparâmetro

Descrição Complementar: Componentes: Alarmes, Uso: De Neonatal A Adulto, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros. Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 42.887,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 7

Descrição: Monitor multiparâmetro

Descrição Complementar: Componentes: Alarmes, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 22.894,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.107,0000 e a quantidade de 7 Unidades.

Item: 8

Descrição: Monitor Multiparâmetro

Descrição Complementar: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 22.894,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.107,0000 e a quantidade de 3 Unidades.

Item: 9

Descrição: Oftalmoscópio

Descrição Complementar: Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Tipo: Portátil, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Tipo Luz: Lâmpada De Xenônio 2,5v,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 775,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 830,0000 e com valor negociado a R\$ 775,8800 e a quantidade de 2 Unidades.

Item: 10

Descrição: Otoscópio

Descrição Complementar: Modelo: Portátil, Tipo: Clínico, Características Adicionais: Com Lâmpada De Fibra Ótica E Lente De Aumento, Alimentação: Pilha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 550,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e com valor negociado a R\$ 430,0000 e a quantidade de 2 Unidades.

Item: 11

Descrição: Medidor

Descrição Complementar: Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal, Características Adicionais: Monitor Integrado, Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o, Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.083,6600


Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(SÍTIOS ELETRÔNICOS)



PROCESSO DE LICITAÇÃO

UTI

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(FORNECEDORES)

04

C000942-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Carol de Aquiar
hmar@tecsaude.com.br

8121234844
09.577.422/0002-80

Proposta Emitida por:

Daniel Valerio
daniel.valerio@safesolucoes.com.br
(81) 9732-2332

Em atenção à sua consulta, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., proposta comercial cujo objetivo é o fornecimento de produto de mais avançada tecnologia.

Colocamos-nos à sua disposição para esclarecermos quaisquer dúvidas referentes a assuntos técnicos ou comerciais e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Item: 1 MONITOR EPM-12M (MODULAR) ECG SPO2 PNI TEMP 2PI DC					
Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/IPI	V. Total
MIN-196	MONITOR EPM-12M (MODULAR) ECG SPO2 PNI TEMP 2PI DC	10	UN	29.625,00	296.250,00

Item: 2 CABO TRONCO ECG 3/5 VIAS 12 PIN 3M P MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS MINDRAY (SUB: 0010-30-42719)					
Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/IPI	V. Total
MIN-096	CABO TRONCO ECG 3/5 VIAS 12 PIN 3M P MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS MINDRAY (SUB: 0010-30-42719)	10	UN	450,00	4.500,00

Item: 3 CONJUNTO 5 VIAS DE ECG CLIP IEC ADULTO/PED LONGO MINDRAY (SUB: EL6504A) (SUB: 0010-30-42730)					
Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/IPI	V. Total
MIN-249	CONJUNTO 5 VIAS DE ECG CLIP IEC ADULTO/PED LONGO MINDRAY (SUB: EL6504A) (SUB: 0010-30-42730)	10	UN	625,00	6.250,00

Item: 4 SENSOR SPO2 TIPO CLIP INTEGRADO ADULTO 512FLH (ADULTO 30KG) 12 PINOS MINDRAY (SUB: 115-012807-00)					
Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/IPI	V. Total
MIN-019	SENSOR SPO2 TIPO CLIP INTEGRADO ADULTO 512FLH (ADULTO 30KG) 12 PINOS MINDRAY (SUB: 115-012807-00)	10	UN	900,00	9.000,00

Item: 5 MANGUEIRA PNI ADUL/PED/INF 3M PARA MONITOR DE SINAIS VITAIS MINDRAY (SUB: 040-002712-00/6200-30-09688)					
Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/IPI	V. Total
MIN-093	MANGUEIRA PNI ADUL/PED/INF 3M PARA MONITOR DE SINAIS VITAIS MINDRAY (SUB: 040-002712-00/6200-30-09688)	10	UN	200,00	2.000,00

mindray

zihm imaging

Hillrom.

insighters
Trust in sight

HOLOGIC®



C000942-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Carol de Aquiar
hmar@tecsaude.com.br
8121234844
09.577.422/0002-80



Proposta Emitida por:
Daniel Valerio
daniel.valerio@safesolucoes.com.br
(81) 9732-2332

Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/Imp	V. Total
MIN-094	BRACADEIRA PNI ADULTO 25-35 CM PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS MINDRAY (SUB: 0010-30-12159)	10	UN	200,00	2.000,00

Valor líquido: 320.000,00

Condições de Faturamento:

Observações:

Condição de Pagamento : 0 DD
 Prazo de Entrega : 10 Dias após aprovação
 Validade da Proposta : 226 DD
 Frete : Emitente
 Garantia do Equipamento : 1 Ano
 Garantia do Acessório : 3 Meses
 Faturamento Mínimo : R\$ 2.000,00


Atenciosamente


Daniel Valerio

Aprovação do Cliente:

Data ____ / ____ / ____

Nome _____

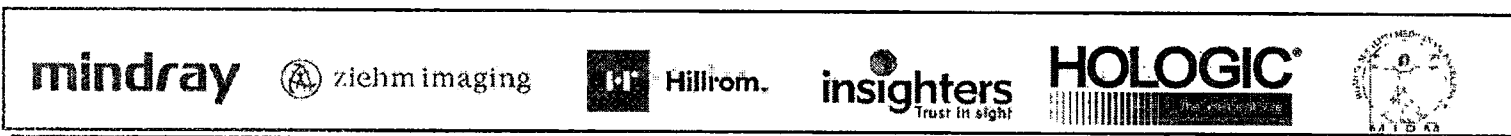



PROCESSO DE LICITAÇÃO


UTI

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(FNS)

Ocorreu um erro no servidor



Equipamento
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico

Atividade
Apoio Diagnóstico - Hospital Transplante

Unidade Funcional / Unidade
Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Hemodinâmica

Ambiente
Sala de exames e terapias

Item
11673

Nomenclatura
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico

Sinónimos

Monitor Multiparamétrico para Centro Cirúrgico, Monitor de Sinais Vitais para Centro Cirúrgico

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI), Oximetria (SPO2), Pressão Invasiva (PI), Capnografia (ETCO2), Agentes Anestésicos e Índice de Sedação Anestésica (BIS), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 48.756,00

Parâmetros básicos|tipo e tamanho do monitor|PI|ETCO2|agentes anestésicos|Índice sedação anestésica:ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP|mistura ou modular de 10 a 12pol|com PI|com ETCO2|sem agentes anest.|não possui

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projetos de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da


configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

Ocorreu um erro no servidor

Parâmetros básicos/tipo e tamanho do monitor/PI/ETCO2/agentes anestésicos/índice de saturação anestésica:

- Opção 1: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com ETCO2/sem agentes anest./não possui;
- Opção 2: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com ETCO2/com agentes anest./não possui;
- Opção 3: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com ETCO2/sem agentes anest./possui;
- Opção 4: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com ETCO2/com agentes anest./possui;
- Opção 5: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 13" a 20"/com PI/com ETCO2/sem agentes anest./não possui;
- Opção 6: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 13" a 20"/com PI/com ETCO2/com agentes anest./não possui;
- Opção 7: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 13" a 20"/com PI/com ETCO2/sem agentes anest./possui;
- Opção 8: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 13" a 20"/com PI/com ETCO2/com agentes anest./possui;
- Opção 9: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/pré configurado de 10" a 12"/com PI/com ETCO2/sem agentes anest./não possui;
- Opção 10: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 10" a 12"/com PI/com ETCO2/com agentes anest./não possui;
- Opção 11: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 10" a 12"/com PI/com ETCO2/sem agentes anest./possui;
- Opção 12: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 10" a 12"/com PI/com ETCO2/com agentes anest./possui;
- Opção 13: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 13" a 20"/com PI/com ETCO2/sem agentes anest./não possui;
- Opção 14: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 13" a 20"/com PI/com ETCO2/com agentes anest./não possui;
- Opção 15: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 13" a 20"/com PI/com ETCO2/sem agentes anest./possui; e
- Opção 16: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 13" a 20"/com PI/com ETCO2/com agentes anest./possui;

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

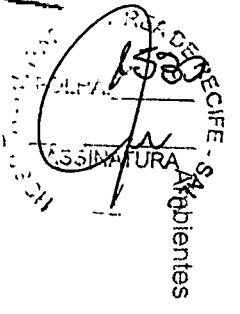

Ocorreu um erro no servidor

Empresa Participante do PROCOT

ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

Página na Internet

Telefone

DIVERSAMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI

<http://www.alfamed.com>

(31)36816388

DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

<http://diversamed.com.br/>

(62)985913635

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

<http://www.drager.com>

(11)46894900

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

<http://www3.gehealthcare.com.br/>

0800122345

MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

<http://www.instramed.com.br>

(51)30738228

PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA

<http://www.mindray.com/pt/index.html>

(11)21250600


PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

http://www.healthcare.philips.com/br_pt/

(11)36721443

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI e 9ª UI
- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

- REQUISITÓRIA
- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
- BOLETIM INTERNO
- MAPA DE RISCO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- PARECER TÉCNICO
- FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA
- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- MAPA COMPARATIVO
- RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO
- ANÁLISE CRÍTICA
- JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
- TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO
- AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
- APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- PESQUISA DE PREÇOS

1539
ASSINATURA
HOSPI
PROF. SAO



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI e 9ª UI
- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(PAINEL DE PREÇOS)



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI e 9ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(ATAS)

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Vc. Ata Posterior

160530.22022.74963.4953.10183359669



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 16 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI Nº 27, B Adm Ap/CMO de 08/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 65303001427202280, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, PARA A UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO SANITÁRIA DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AO CMO, conforme Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército - PAASSEx 2022.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparelho purificador de água

Descrição Complementar: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutímetro De Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.155,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, pelo melhor lance de R\$ 1.123,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 2

Descrição: Porta Amálgama

Descrição Complementar: Porta Amálgama Material: Náilon , Tipo: Autoclavável , Características Adicionais: Mola Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 553,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Reanimador manual

Descrição Complementar: Reanimador Manual Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 130,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.198,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não


Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 200 KG
 Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto
 , Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.925,9200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01



Aceito para: NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.360,0000 e com valor negociado a R\$ 8.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 41

Descrição: Monitor Multiparâmetro

Descrição Complementar: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes/Bateria , Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp , Registros: Mínimo 6 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução , Tipo: Pré Configurado/Modular , Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 38.516,6300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01


Aceito para: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7.480,0000 e com valor negociado a R\$ 7.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - Aparelho purificador de água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H - MOD. LUCA-310 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC; - Indicação de pureza da água; - Sistema de coluna intercambiável; - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna; - Produz água com condutividade inferior a 4µS e pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água delonizada e total (toda a água que entra, sai delonizada); - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento); - Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x15cm; - Ciclos Aproximados: 500 Litros; - Vazão: 50 L/Hora; - Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	15/03/2022 11:44:39
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: DAU50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , C Vazão 50 l/h Dimensões 15 x 74,5 Elemento 5 litros de resina mista Rendimento 900 litros Potência (W) 9 Carcaça confeccionada em PVC branco. Coluna deionizadora de 50 l/h; Condutímetro de alarme ótico; Leito de resina mista, catiônica e aniônica; Bivolt; Requer baixa pressão de alimentação; Regeneração da coluna à base de troca. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	15/03/2022 14:20:47
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS Marca: Osmose reversa Fabricante: Osmose reversa Modelo / Versão: Aparelho Purificador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutímetro e Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Voltagem: 110/220 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	16/03/2022 00:04:39
36.045.363/0001-90	MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO 15239420530 Marca: SP LABOR Fabricante: SP LABOR Modelo / Versão: SP 050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutímetro De Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/03/2022 22:11:39



02



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI e 9ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(SÍTIOS ELETRÔNICOS)



Monitor de Triagem (SPO2 / TEMP / PNI) Vita i20
- Alfamed

R\$ 9.247,95

1



+Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com

todos os prazos e valores.



CALCULAR



SUBTOTAL R\$ 9.247,95

TOTAL R\$ 9.247,95

[ESCOLHER MAIS PRODUTOS](#)

PAGAMENTO

SITE SEGURO

ADICIONAR À SACOLA
 ASSINATURA
 HOSPITAL DE ÁREA DE RESCUE - SAO

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2... R\$ 9.900,00 à vista


[Ver detalhes](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#)

[Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#)

MAGALU Monitor de sinais vitais (ecg / spo2 / resp / temp / pni) vita i20 - Alfamed

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2 / resp / temp / pni) vita i20 - Alfamed

Código hg74h4e63h | [Ver descrição completa](#) | [Alfamed](#)

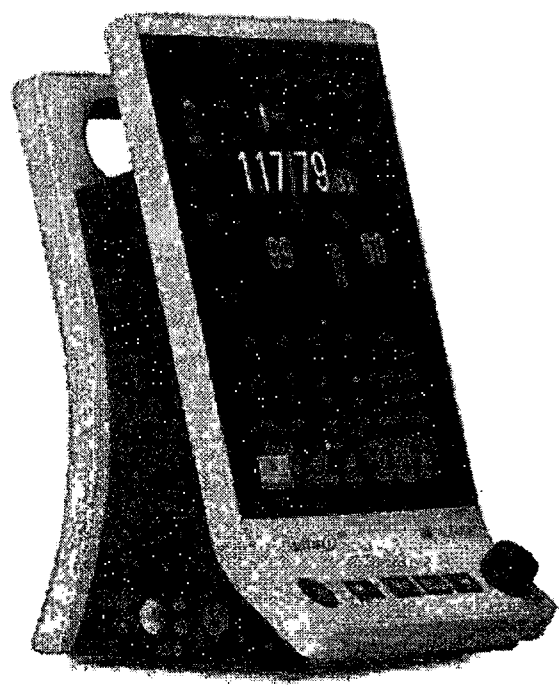

☆☆☆☆☆ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Lam Brasil**
 Entregue por **MAGALU**
 O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 9.900,00
 ou R\$ 9.900,00 em 10x de R\$ 990,00 sem juros


[Cartão de crédito](#)
 sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

[Calcular frete e prazo](#)

Quem viu este produto, viu estes também



Mini refrigerador portátil geladeira 20 litros frigobar
 2 em 1 20l e aquece café e casa 220v

R\$ 978,89
 ou R\$ 978,89 em 10x de R\$ 97,89 sem juros

Seleção especial do Magalu pra você
 Patrocinados



Monitor de sinais vitais (ecg / spo2... R\$ 9.900,00 à vista

ADICIONAR À SAC...
 ASSINATURA
 HCC 11/16

[Voltar ao topo](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#)


ou R\$ 206,90 em 4x de R\$ 51,73 sem juros



Maionese Hellmann's Tradicional

86
 R\$ 14,90
R\$ 11,12
 no PIX (10% de desconto)


ou R\$ 1.290,00 em 10x de R\$ 129,00, sem juros

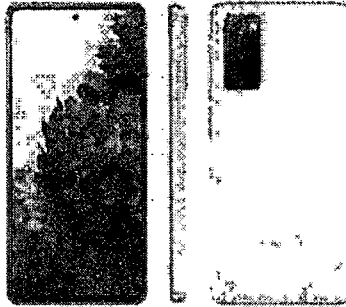

Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Branco Octa-Core 6GB RAM 6,5" Câm. Tripla +...

R\$ 3.999,00
R\$ 1.899,00
 no PIX (10% de desconto)
 ou R\$ 2.110,00 em 10x de R\$ 211,00 sem juros

Produtos relacionados



Tampa Da Manopla De Cambio...
 6
R\$ 25,00



Camara 4 00/4 80 - 8 MA-8 Buffalo
 R\$ 31,99
R\$ 28,71
 no PIX (10% de desconto)



Óleo Lubrificante do Motor Ipiranga...
 R\$ 37,54
R\$ 33,79
 no PIX




Válvula Para Pneu Sem Câmara...
 R\$ 9,45
R\$ 9,00



Cabo C Bateria
R\$ 46,90
R\$ 41
 no PIX (descont)

[Handwritten signature]

O que você viu está aqui



Electrocardiografo CardioCare 2000 12 canais Completo Bioriel
 R\$ 7.502,99
 ou R\$ 750,29 em 10x de R\$ 750,30 sem juros

Mais produtos patrocinados

Patrocinados



Monitor de sinais vitais (ecg / spo2... R\$ 9 900,00 à vista

[Voltar ao topo](#)


[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

1707


R\$ 309,90
R\$ 231,83
 no PIX (2% de desconto)
 ou R\$ 19,00 em 5x de R\$ 4,80 sem juros

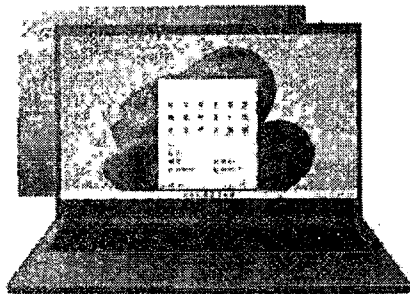

Notebook Samsung Book Intel Celeron 4GB 256GB

836

R\$ 3 299,00
R\$ 1.952,07
 no PIX (2% de desconto)
 ou R\$ 2 099,00 em 10x de R\$ 209,90 sem juros

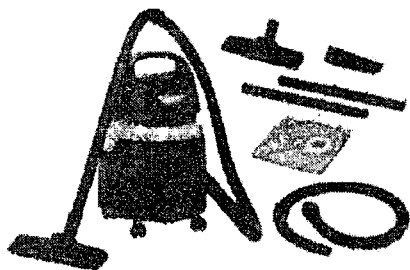

Aspirador de Pó e Água Electrolux 1400W

2951

R\$ 399,00
R\$ 267,84
 no PIX (2% de desconto)
 ou R\$ 279,00 em 6x de R\$ 46,50 sem juros




Desodorante Antitranspirante Aerossol Dove

576

R\$ 22,21
R\$ 14,49
 no PIX (2% de desconto)

118

R\$ 18,69
R\$ 12,64
 no PIX (2% de desconto)

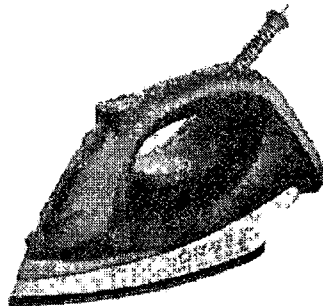

Ferro de Passar Roupa a Vapor e a Seco Electrolux

717


R\$ 124,99
R\$ 102,81
 no PIX (2% de desconto)
 ou R\$ 105,99 em 2x de R\$ 53,00 sem juros



Shampoo Pantene Hidratação 350ml

16

R\$ 32,99
R\$ 29,30
 no PIX (2% de desconto)



Desinfetante Lysoform Superfícies

18

R\$ 34,99
R\$ 9,79
 no PIX (2% de desconto)

[Handwritten signature]


Informações do Produto

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2 / resp / temp / pni) vita i20

O Vita i20 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e em monitoramento durante o transporte externo ou interno, triagem de pacientes (spot Checking) e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Informações de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal;- Tela TFT LCD colorida de 8" (resolução 800x600);- Display, fonte e processador em bloco unico com gabinete isolamento elétrico embutida;- Bateria interna recarregável com autonomia de até 3,5 horas;- Exibição em tela de: Informações do Paciente, Alarmes fisiológicos e técnicos, dados numéricos curvas, Dados de armazenamento e interfaces externas, Data e hora, Status do uso da bateria, e rede;- Indicadores: alarmes, rede elétrica, status da bateria, e Bip de QRS;- em modo Monitoramento: Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas, com resolução a 1 min, 200 conjuntos de eventos de alarmes, 1; medições de PNI;- Armazenamento em modo Visita (Spot Checking). Até 800 mil registros de verificação, 20 registros de SpO2, 20 registros de NIBP, e 20 registros de

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2) R\$ 9.900,00 à vista

ADICIONAR A SACUBIA



[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)



[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

curva de plestinografia, saturação frequência de pulso, e índice de perfusão gráfico e numérico;- Tecnologia para baixa perfusão e movimentação;- Faixa de medição: 0 a 100% Exatidão: 70 a 100%: ±2% (Adulto/Pediátrico) 70 a 100%: ±3% (Neonatal);- Faixa de FP: 25 a 300 bpm, precisão ±2 bpm, resolução 1 bpm;- Faixa alarme: 30 a 300 bpm; Precisão: ±2%;- Intervalo de medição de PI: 0 a 10; Temperatura infravermelho (TH);- Um Canal;- Auricular;- Intervalo de medição: 34°C a 42,2°C;- Temp de funcionamento: 12h;- Resolução: 0,1°C Precisão: ±0,2°C (35°C a 42°C) ou ±0,3°C fora da faixa mencionada.Conteúdo da Embalagem:- 01 (um) Módulo temp Th - 01 (uma) Senso: Infra: 01 (um) unid, 01 (um) Carregador capa sonda,- 01 (um) Sensor SpO2 tipo clip adulto reutilizável 7P,- 01 (um) Manguto/Abraçadeira reutilizável Adulto,- 01 (um) tubo ext reutilizável,- 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT;- 01 (um) Cabo terra Vita;- 01 (um) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion 2400 mAh; 01 (um) Manu Português



Outros Automotivo

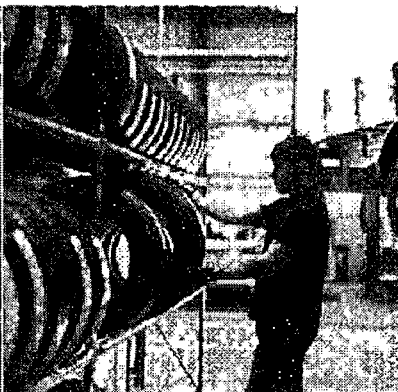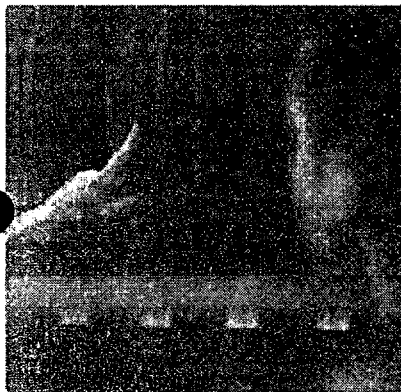

Pneu LT e AT: entenda as diferenças

Vem ver as diferenças deles e acerte na escolha!

Qual a calibragem certa do pneu?

Vem ver como manter seus pneus sempre em dia!

Tudo sobre pneus

Vem comigo que eu te ajudo a escolher o melhor modelo pro carro!

Como escolher o pneu

Vem conhecer os cuidados e marcas desse item

[Veja outros conteúdos](#)

Avaliação dos clientes

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO




Monitor de sinais vitais (ecg / spo2 / resp / temp / pni) vita...

Avaliação geral

0.0 ★ ★ ★ ★ ★
0 avaliação

Ordenar avaliações: Mais relevantes

Formas de pagamento



Cartão Luiza

RS 9.900,00 à vista

02x de R\$ 4.950,00 sem juros

03x de R\$ 3.300,00 sem juros


04x de R\$ 2.475,00 sem juros

Total

RS 9.900,00

RS 9.900,00

RS 9.900,00



Cartão de crédito

(Produto + Frete) RS 9.900,00 à vista

02x de R\$ 4.950,00 sem juros

03x de R\$ 3.300,00 sem juros

04x de R\$ 2.475,00 sem juros

Total

RS 9.900,00

RS 9.900,00

RS 9.900,00



Pix

RS 9.900,00 à vista

No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.



Boleto bancário

RS 9.900,00 a vista

No boleto bancário, que será gerado na sua compra.



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI e 9ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022


PESQUISA DE PREÇOS

(FORNECEDORES)



**TEKMARKET INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.579.468/0001-52
Endereço: Rua Alameda da Inovação, nº 270 –
Salas 004, Cidade: Campo Bom - RS Bairro:
Zona Industrial CEP: 93700-000



Caroline Guerizoli
caroline@tothtecnologia.com.br

Dados da empresa

Razão social: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE
Nome empresa: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE
CNPJ: 09.577.422/0001-07
E-mails: hger@hger.com.br
Telefones: +55 (81) 99605-7111, +55 (81) 2123-4844, +55 (81) 2123-4817
Endereço: RUA DO HOSPICIO, 563 - ANDAR PRIMEIRO. BOA VISTA Recife/PE 50050050

Produtos e serviços:

Qtd.	Foto	Ref.	Item	Tipo	Valor unit.	Desconto	Subtotal
1		3100	Monitor Smart Check - PNI e SPO2	Produto	R\$ 14.021,00	R\$ 2.804,20 (20,0 %)	R\$ 11.216,80
- Pressão Não Invasiva, Oximetria, Frequência Cardíaca e Bluetooth. - Acessórios Inclusos. Cabo de Força, Mangueira e Manguito padrão Adulto 23-33 cm, Extensão e Sensor de Oximetria DS- 100A NELLCOR e Manual do Usuário. NCM, 90181980 - Registro Anvisa 81658400001							
1		34000000	Carrinho de Transporte Smart	Produto	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 1.760,00
1		1242B	Termômetro Bluetooth	Produto	R\$ 560,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 560,00
1		30060004	Glicosímetro TD-4279/Hematócrito	Produto	R\$ 480,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 480,00

Resumo da proposta::

Subtotal em produtos: R\$ 14.016,80
Subtotal em serviços: R\$ 0,00
Subtotal geral: R\$ 14.016,80
Frete FOB R\$ 200,00
Valor final: R\$ 14.216,80

Previsão de entrega:

15 DIAS;

Forma de pagamento

Dados Bancários:

Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda

CNPJ 21.579.468/0001-52

~~Banco do Brasil~~

Agência: 07210-9

Conta corrente: 74076-4

~~Banco do Brasil~~

Agência: 5745-2

Conta: 13.270-5

Boleto, cartão de crédito, PIX ou transferência bancária;



Observações

Ao aprovar a presente proposta, declaro estar ciente e de acordo com as condições supracitadas.

A handwritten signature in black ink.

C000942-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Carol de Aquiar
hmar@tecsaude.com.br
8121234844
09.577.422/0002-80

Proposta Emitida por:
Daniel Valerio
daniel.valerio@safesolucoes.com.br
(81) 9732-2332

Em atenção à sua consulta, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., proposta comercial cujo objetivo é o fornecimento de produto de mais avançada tecnologia.

Colocamos-nos à sua disposição para esclarecermos quaisquer dúvidas referentes a assuntos técnicos ou comerciais e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Item: 1 MONITOR DE TRIAGEM VS-600 SPO2 PNI TEMP					
Código	Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/PI	V. Total
IN-443	MONITOR DE TRIAGEM VS-600 SPO2 PNI TEMP	2	UN	19.000,00	38.000,00

Valor líquido: 38.000,00

Condições de Faturamento:

Condição de Pagamento : **0 DD**
Prazo de Entrega : 10 Dias após aprovação
Validade da Proposta : 492 DD
Frete : Emitente
Garantia do Equipamento : 1 Ano
Garantia do Acessório : 3 Meses
Faturamento Mínimo : R\$ 2.000,00

Observações:

Monitor de sinais vitais


Atenciosamente


Daniel Valerio

Aprovação do Cliente:

Data ____/____/____

Nome _____





PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI e 9ª UI

- PAASSEX 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(FNS)

CIFE - Comissão Interdisciplinar de Fiscalização e Controle de Equipamentos Médicos

3 metros tipo e tamanho do monitor suporte para monitor:

Opção 1: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/pre configurado de 10" a 12"/com suporte;

Opção 2: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/estrutura mista ou modular de 10" a 12"/com suporte;

Opção 3: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/estrutura mista ou modular de 13" a 20"/com suporte;

Opção 4: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/pre configurado de 13" a 20"/com suporte;

Opção 5: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/pre configurado de 7" a 10"/com suporte;


Opção 6: SPO2, PNI, TEMP/pre configurado de 7" a 10"/com suporte; e

Opção 7: SPO2, PNI, TEMP/ estrutura mista ou modular de 7" a 10"/com suporte.

Para o processo licitatório, o proponente/concorrente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando-se com as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que não constarem em seu edital.

Nome da Empresa	Telefone	Fórmula de Faturamento	Telefone
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	(11) 3668.3388	http://www.alfamed.com	(31) 3668.3388
APPLICABLE SYSTEMS LTDA	(11) 3688.3444	http://www.appliquehealthcare.com.br	(11) 3688.3444
DIVERSAMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI	(62) 9355.12.3333	http://diversamed.com.br/	(62) 9355.12.3333
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	(11) 4669.3535	http://www.drager.com	(11) 4669.3535
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	(11) 2564.1400	http://www.fmc-ag.com.br/	(11) 2564.1400
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	0800122245	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122245
INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	(51) 3073.8228	http://www.instramed.com.br	(51) 3073.8228
JG MORIYA	(11) 2914.9716	http://jgmoriya.com.br/	(11) 2914.9716
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	(11) 9630.06452	http://medsupplies.com.br	(11) 9630.06452
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	(11) 3672.1443	http://www.mindray.com/pv/index.html	(11) 3672.1443
OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	(16) 3919.9350	http://www.olidef.com.br	(16) 3919.9350
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	(11) 2125.0600	http://www.healthcare.philips.com/br_pv/	(11) 2125.0600

Detalhamento



Empresa Participante do PROCOOT

PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

R&D MEDIC - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Tekmarket Industria, Comercio e Serviços Ltda

Página na Internet:

<http://www.prolife.com.br>

Telefone

(11)50517199


(11)31329899

<http://www.lothifecare.com>

(51)981839161

O PROCOOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando da forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou reconhecimento por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br



PROCESSO DE LICITAÇÃO

1ª UI, 2ª/4ª UI e 8ª UI
- PAASSEx 2023 -

- REQUISITÓRIA
- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
- BOLETIM INTERNO
- MAPA DE RISCO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- PARECER TÉCNICO
- FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA
- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- MAPA COMPARATIVO
- RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO
- ANÁLISE CRÍTICA
- JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
- TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO
- AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
- APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- PESQUISA DE PREÇOS



PROCESSO DE LICITAÇÃO

1ª UI, 2ª/4ª UI e 8ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(PAINEL DE PREÇOS)

MEDIA

R\$ 860,97

MEDIANA

R\$ 860,97

MENOR

R\$ 840

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
457135 2022, 2023 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00031/2022	00016	Pregão	457135	BALANCA ELETRONICA		UNIDADE	2	R\$840	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	UNIVERSIDADE FED DA INTEGR LATINO-AMERICANA	158658 - UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA	07/11/2022
00023/2022	00002	Pregão	457135	BALANCA ELETRONICA		UNIDADE	4	R\$681,94	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA/CAL	08/11/2022

ASSINATURA
1687
SISTEMA DE CONTABILIDADE



PROCESSO DE LICITAÇÃO

1ª UI, 2ª/4ª UI e 8ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(ATAS)



MINISTÉRIO DA DEFESA

Este pregão possui 2 Atas Complementares
Ver Ata Posterior

160004.232022 .69200 .4946 .1240197896



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
10ª Brigada de Infantaria Motorizada
59º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00023/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 13 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Bol Int nº 101 de 02/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64106006679202269, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Posto Médico de Guarnição do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas
Descrição Complementar: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica , Modelo: Elétrica , Material*: Gabinete Plástico , Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital , Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado , Componente Iii: Pés Reguláveis , Capacidade Máxima Carga: Até 25 K
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 919,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Balança eletrônica
Descrição Complementar: Balança Eletrônica Material: Polipropileno Injetado , Capacidade Pesagem: 25 KG, Dimensões: 55 X 33 X 8,50 CM, Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês , Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe , Tipo Painel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada , Voltagem: Bivolt
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 881,9400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 881,9400 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 3

Descrição: Esfigmomanômetro
Descrição Complementar: Esfigmomanômetro Uso: Pedestal C/ Rodízios , Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 67
Valor Máximo Aceitável: R\$ 167,4100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R. FREDERICO CAMPOS LOREDO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 167,4100 e a quantidade de 67 Unidade .

Item: 4

Descrição: Maca clínica
Descrição Complementar: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Componentes: Suporte Soro Removível , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 1,90 M, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Capacidade De Carca: Até 150 KG, Tipo: Carro Maca , Largura: Cerca De 0,60 M, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.730,6500
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

ASSINATURA
02557
HOSPITALIDADE - SACS

02



PROCESSO DE LICITAÇÃO

1ª UI, 2ª/4ª UI e 8ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(SÍTIOS ELETRÔNICOS)



Generalmed

SFJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOS

ACESSE SUA CONTA


Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

Página Inicial / Balanças / Balanças Antropométricas / Balança antropometrica pediátrica digital 15 kg



DESTAQUE



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Balança antropometrica pediátrica digital 15 kg

Digite o que você procura





Oxigenoterapia (https://www.medaxo.com.br/oxigenoterapia) **Balança** Resgate e Salvamento (https://www.medaxo.com.br/resgate-e-salvamento)

Móveis hospitalares (https://www.medaxo.com.br/moveis-hospitalares) **PEDIÁTRICO ELETRÔNICA 109 e ANTROPOMÉTRICA Descartáveis** (https://www.medaxo.com.br/descartaveis)

Equipamentos (https://www.medaxo.com.br/equipamentos) Instrumental Cirúrgico (https://www.medaxo.com.br/instrumental-cirurgico)

Locomoção (https://www.medaxo.com.br/locomocao) Aparelhos Médicos (https://www.medaxo.com.br/aparelhos-medicos)

Minha Conta (conta/index)

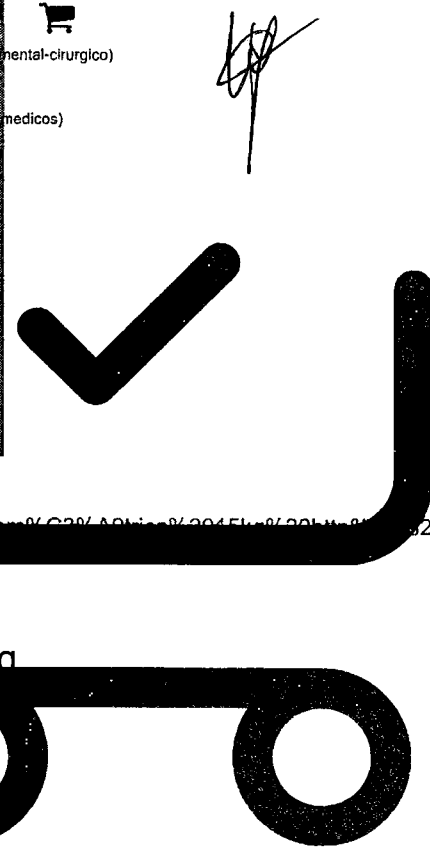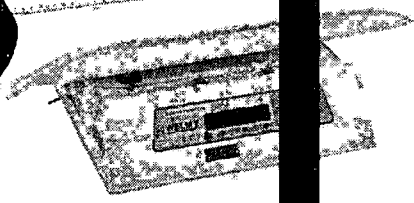

(https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999999999)

(https://www.medaxo.com.br) %20eletr%C3%B4nica%20109%20e%20antropometrica%2015kg


pediátrico-eletronica-109-e-antropometrica)

Início (https://www.medaxo.com.br) » Equipamentos (https://www.medaxo.com.br/equipamentos)

Balança Pediátrico eletrônica 109 e Antropométrica 15kg

Código: BE25

(0)



R\$ 1.130,50

5% DE DESCONTO NO PIX - BOLETO

R\$ 1.190,00

6X DE R\$ 198,33 SIJUIROS NO CARTÃO

(https://www.medaxo.com.br/carrinho/index)

Outras formas de pagamento

1

Comprar(https://www.medaxo.com.br/carrinho/index)

Calcule o frete

C.F.P.

CALCULAR

Descrição Saiba mais

Balança Pediátrico eletrônica 109 antropometrica welmy (15kg)

Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material

.Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm;

Gabinete em Plástico ABS;

Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;

Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica;


Pés reguláveis em borracha sintética;

(https://www.medaxo.com.br/conta/index)


(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511966096133>)




SEGURANÇA DO SITE

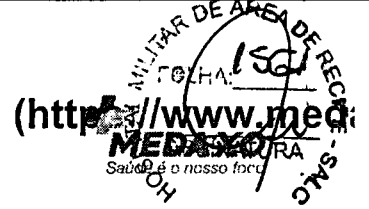

Meu perfil e que você procura



REVIEWS VERDADEIROS



CERTIFICADO RA1000 ReclameAQUI

Oxigênio terapêutico (<https://www.medaxo.com.br/oxigenoterapia>)

Resgate e Solvimento (<https://www.medaxo.com.br/resgate-e-solvimento>)

Móveis hospitalares (<https://www.medaxo.com.br/moveis-hospitalares>)

Descartáveis (<https://www.medaxo.com.br/descartaveis>)

Equipamentos (<https://www.medaxo.com.br/equipamentos>)

Instrumental cirúrgico (<https://www.medaxo.com.br/instrumental-cirurgico>)

Locomoção (<https://www.medaxo.com.br/locomocao>)

Aparelhos Médicos (<https://www.medaxo.com.br/aparelhos-medicos>)

Minha Conta (/conta/index)

Meu Caminho (/caminho/index)



COMPRA SEGURA SITE PROTEGIDO CERTIFICADO SSL



SITE SEGURO Google CLIQUE PARA VERIFICAR

(<https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?>)

url=www.medaxo.com.br)



Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(<https://consul@as.anvisa.gov.br/#/>)



(<https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/>)

medaxo_saude (https://www.instagram.com/medaxo_saude/)

medaxo.com.br (<https://www.facebook.com/medaxo.com.br>)

medaxo (https://www.youtube.com/channel/UCT0qYar73tOHLEskVb14_Ag)



ATENDIMENTO

(11) 96609-6133 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511975000786&text=Ola>) (11) 2348-8710 (tel:(11) 2348-8710)

sac@medaxo.com.br (mailto:sac@medaxo.com.br)


vendas@medaxo.com.br (mailto:vendas@medaxo.com.br)

Medaxo é uma marca registrada e pertencente a Medbit Comercio e Distribuidora LTDA / CNPJ: 34.995.970/0001-96 / IE 126.827.650.116/ Alvará de Funcionamento. 20190010054508 / Rua Antônio das Chagas 339 Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP Cep: 04.714-000/ AFE: 1240316 / CMVS: 355030801-464-003825-1-5 / Farmacêutico Responsável: Clarice do Nascimento Couto - CRF: 47543.

Os preços, as promoções, o frete e as condições de pagamento são válidos apenas para compras via Internet e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens são meramente ilustrativas Todos o pedidos efetuados estão sujeitos à confirmação da disponibilidade de produto em nosso estoque.



Fotos

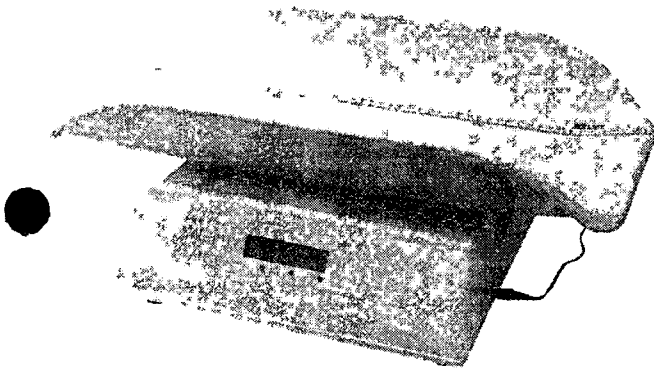

Balança Eletrônica Antropométrica Infantil em Polipropileno 109E

Tire [**R\\$ \(BRL\) 1.359,90**](https://api.whatsapp.com/send?phone=5517988120830&text=Ol%C3%A1!%2C+gostaria+de+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es+sobre+este+produto: suas *Balan%C3%A7a%20Eletr%C3%B4nica%20Antropom%C3%A9trica%20Infantil%20em%20Polipropileno%20109E* . Aqui esta o link: duvidashttps://www.produtosmedicos.com.br/balanca-eletronica-antropometrica-infantil-em-polipropileno-109e)</p></div><div data-bbox=)

R\$ 1.319,10 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 113,33 Sem juros

Capacidade:

15 Kg

30 Kg

Quantidade.


1  Comprar

CEP:

Calcular frete(https://www.produtosmedicos.com.br/balanca-eletronica-antropometrica-infantil-em-polipropileno-109e?parceiro=2015&variant_id=2651)

Descrição (https://www.produtosmedicos.com.br/balanca-eletronica-antropometrica-infantil-em-polipropileno-109e?parceiro=2015&variant_id=2)

Garantia (https://www.produtosmedicos.com.br/balanca-eletronica-antropometrica-infantil-em-polipropileno-109e?parceiro=2015&variant_id=2)

Formas de Pagamento (https://www.produtosmedicos.com.br/balanca-eletronica-antropometrica-infantil-em-polipropileno-109e?parceiro=2015&variant_id=2)  Comprar



[Handwritten signature]

Balança Eletrônica Infantil em Acrílico 109E (<https://www.produtosmedicos.com.br/balanca-eletronica-infantil-em-acrilico-109e>)

R\$ 2.099,90

R\$ 2.036,90 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 174,99 Sem juros

Escolher

AINDA NÃO CONHECE OS SEUS BENEFÍCIOS?

SAIBA MAIS SOBRE O FIDELIDADE RHOSS >>

(<https://www.produtosmedicos.com.br/loja/clic.php?loja=753145&banner=69>)

Comprar



PROCESSO DE LICITAÇÃO

1ª UI, 2ª/4ª UI e 8ª UI

- PAASSE_x 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(FORNECEDORES)



PROCESSO DE LICITAÇÃO

1ª UI, 2ª/4ª UI e 8ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. P.', is written over the text 'SETEMBRO 2022'.

PESQUISA DE PREÇOS

(FNS)



Detalhe Equipamento

Ocorreu um erro no servidor

Equipamento

Balança Antropométrica Infantil

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Métodos gráficos

Atividade

Apoio Diagnóstico - Hospital

Ambiente

Sala de eletrografia

Item
2981

Nomenclatura
Balança Antropométrica Infantil

Sinônimos
Balança infantil

Classificação
Médico Assistencial

Definição e Aplicação
Equipamento para pesagem do paciente.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 1.101,00

MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE MÁXIMA: DIGITAL/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projetos de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE:

MILITAR DE ÁREA BÉRCHE
OPÇÃO 1: DIGITAL/ ATÉ 16KG
OPÇÃO 2: DIGITAL/ ACIMA DE 17KG
OPÇÃO 3: MECÂNICA/ ATÉ 16KG
DIMENSÕES DA CONCHA
OPÇÃO 1: MÍNIMO 540X290 (MM)

Ocorreu um erro no servidor

-TARA:
Opção 1: POSSUI




Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br



PROCESSO DE LICITAÇÃO

PAMO
- PAASSEx 2023 -

- REQUISITÓRIA
- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
- BOLETIM INTERNO
- MAPA DE RISCO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- PARECER TÉCNICO
- FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA
- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- MAPA COMPARATIVO
- RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO
- ANÁLISE CRÍTICA
- JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
- TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO
- AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
- APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- PESQUISA DE PREÇOS



PROCESSO DE LICITAÇÃO

PAMO

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(PAINEL DE PREÇOS)



PROCESSO DE LICITAÇÃO

PAMO

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(ATAS)

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

160530.22022.74963.4953.10183359669



MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00002/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 16 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI Nº 27, B Adm Ap/CMO de 08/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 65303001427202280, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, PARA A UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO SANITÁRIA DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AO CMO, conforme Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército - PAASSEX 2022.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparelho purificador de água

Descrição Complementar: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.155,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, pelo melhor lance de R\$ 1.123,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 2

Descrição: Porta Amálgama

Descrição Complementar: Porta Amálgama Material: Náilon , Tipo: Autoclavável , Características Adicionais: Mola Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 553,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Reanimador manual

Descrição Complementar: Reanimador Manual Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 130,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.198,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01


Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.925,9200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Aceito para: NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.360,0000 e com valor negociado a R\$ 8.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 41

Descrição: Monitor Multiparâmetro

Descrição Complementar: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes/Bateria , Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp , Registros: Mínimo 6 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução , Tipo: Pré Configurado/Modular , Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 38.516,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.480,0000 e com valor negociado a R\$ 7.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Aparelho purificador de água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-310	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	15/03/2022 11:44:39
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: DAU50	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	15/03/2022 14:20:47
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS Marca: Osmose reversa Fabricante: Osmose reversa Modelo / Versão: Aparelho Purificador	Sim	Sim	6	R\$ 1.155,0000	R\$ 6.930,0000	16/03/2022 00:04:39
36.045.363/0001-90	MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO 15239420530 Marca: SP LABOR Fabricante: SP LABOR Modelo / Versão: SP 050	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/03/2022 22:11:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça E



PROCESSO DE LICITAÇÃO


PAMO

- PAASSEx 2023 -

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. J. ...'.

PESQUISA DE PREÇOS

(SÍTIOS ELETRÔNICOS)



Monitor de Triagem (SPO2 / TEMP / PNI) Vita i20
- Alfamed

R\$ 9.247,95

1



+Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.



CALCULAR



SUBTOTAL R\$ 9.247,95

TOTAL R\$ 9.247,95

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

PAGAMENTO

SITE SEGURO

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2... R\$ 9.900,00 à vista

ADICIONAR À SACOLA

MILITAR DE RESERVA DE RESERVA
FOLHA: 1376
ASSINATURA

[Relacionados](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Categorias de produtos](#)

[Ofertas do Dia](#)

[Celulares](#)

[Móveis](#)

[Eletrodomésticos](#)


[TV e Vídeo](#)

[Informática](#)

magalu Monitor de sinais vitais (ecg / spo2 / resp / temp / pni) vita i20 - Alfamed

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2 / resp / temp / pni) vita i20 - Alfamed

Código: bg/4h4e63h | [Ver descrição completa](#) | Alfamed

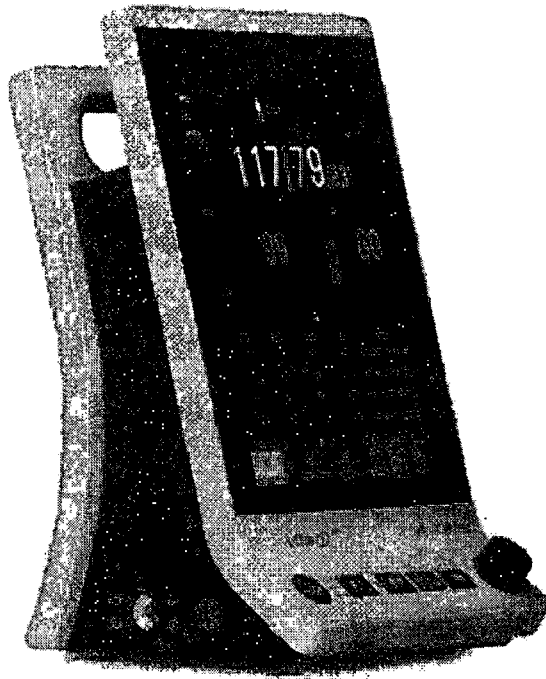

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Lam Brasil**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 9.900,00

ou R\$ 9.900,00 em 10x de R\$ 990,00 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

[Calcular frete e prazo](#)

Quem viu este produto, viu estes também



Mini refrigerador portátil geladeira 20 litros frigobar
2 em 1 20l e aquece carro e casa 220v

R\$ 978,89

ou R\$ 978,89 em 10x de R\$ 97,89 sem juros

Seleção especial do Magalu pra você

Patrocinadas



Monitor de sinais vitais (ecg / spo2... R\$ 9.900,00 à vista

ADICIONAR À SE
FOLHA: 107
ASSINATURA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE - SAIC

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

ou R\$ 206,90 em 4x de R\$ 51,73 sem juros




Maionese Hellmann's Tradicional

86

R\$ 14,90
R\$ 11,12

no PIX (10% de desconto)

ou R\$ 1.290,00 em 10x de R\$ 129,00, sem juros

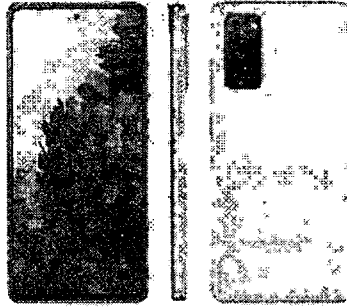


Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Branco Octa-Core 6GB RAM 6,5" Câm. Tripla +...

R\$ 3.999,00
R\$ 1.899,00

no PIX (10% de desconto)

ou R\$ 2 110,00 em 10x de R\$ 211,00 sem juros

Produtos relacionados



Tampa Da Manopla De Cambio
6

R\$ 25,00



Camara 4.00/4.80 - 8 MA-8 Buffalo

R\$ 31,98
R\$ 28,71

no PIX (10% de desconto)



Óleo Lubrificante do Motor Ipiranga...
***** 41

R\$ 37,54
R\$ 33,79

no PIX



Válvula Para Pneu Sem Câmara...
***** 21

R\$ 9,45
R\$ 9,00




Cabo C Bateria

R\$ 46,92
R\$ 41

no PIX (10% de desconto)

O que você viu está aqui



Electrocardiografo CardioCare 2000 12 canais Completo Bionet

R\$ 11.222,78
R\$ 7.502,99

ou R\$ 7.502,99 em 10x de R\$ 750,30 sem juros

Mais produtos patrocinados

Patrocinados




ADICIONAR...

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2... R\$ 9.900,00 à vista


[Voltar ao topo](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#)

1707
 R\$ 309,00
R\$ 231,83
 no PIX (23% de desconto)
 ou R\$ 239,00 em 5x de R\$ 47,80 sem juros

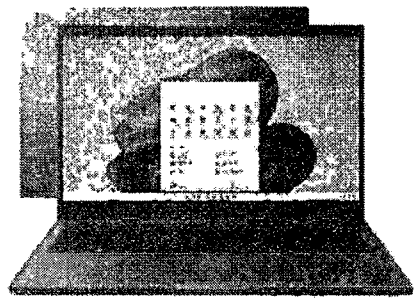

Netbook Samsung Ebook Intel Celeron 4GB 256GB


118
 R\$ 18,69
R\$ 12,64
 no PIX (32% de desconto)

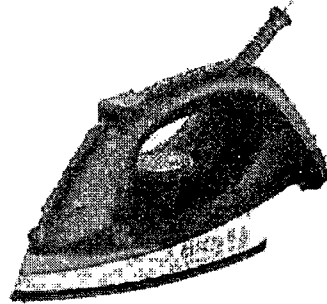

Ferro de Passar Roupa a Vapor e a Seco Electrolux

[Handwritten signature]

R36
 R\$ 3.299,00
R\$ 1.952,07
 no PIX (41% de desconto)
 ou R\$ 2.029,00 em 10x de R\$ 209,90 sem juros

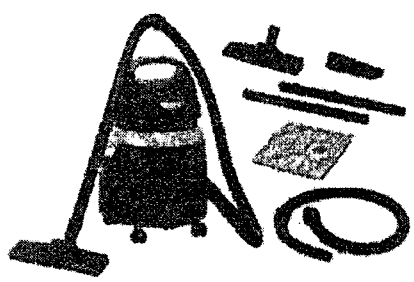

Aspirador de Pó e Água Electrolux 1400W

717
 R\$ 124,99
R\$ 102,81
 no PIX (18% de desconto)
 ou R\$ 105,99 em 2x de R\$ 53,00 sem juros



Shampoo Pantene Hidratação 350ml

2951
 R\$ 399,00
R\$ 267,84
 no PIX (33% de desconto)
 ou R\$ 279,00 em 6x de R\$ 46,50 sem juros



Desodorante Antitranspirante Aerosol Dove

16
 R\$ 32,00
R\$ 29,30
 no PIX (8% de desconto)



Desinfetante Lysoform Superfícies

326
 R\$ 22,21
R\$ 14,49
 no PIX (35% de desconto)

18
 R\$ 24,90
R\$ 9,79
 no PIX (60% de desconto)

Informações do Produto

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2 / resp / temp / pni) vita i20

O Vita i20 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, monitoramento durante o transporte externo ou interno, triagem de pacientes (spot Checking) e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Informações de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal;- Tela TFT LCD colorida de 8" (resolução 800x600);- Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrico embutido;- Bateria interna recarregável com autonomia de até 3,5 horas;- Exibição em tela de: Informações do Paciente, alarmes fisiológicos e técnicos, dados numéricos curvas, Dados de armazenamento e interfaces externas, Data e hora, Status do uso da bateria, e rede;- Indicadores: alarmes, rede elétrica, status da bateria, e Bip de QRS;- em modo Monitoramento: Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas, com resolução a 1 min, 200 conjuntos de eventos de alarmes, 100 medições de PNI;- Armazenamento em modo Visita (Spot Checking): Até 800 mil registros de verificação, 20 registros de SpO2, 20 registros de NIBP, e 20 registros de

Monitor de sinais vitais (ecg / spo2... R\$ 9.900,00 à vista

HOSPITAL AMÉRICA DE ÁREA DE RECIFE - S.A.C.
 ADICIONAR FOLHA: 15701
 ASSINATURA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)



[Formas de Pagamento](#)

curva de plestimografia, saturação frequência de pulso, e índice de perfusão gráfico e numérico;- Tecnologia para baixa perfusão e movimentação;- Faixa de medição 0 a 100% Exatidão 70 a 100% ±2% (Adulto/Pediátrico) 70 a 100% ±3% (Neonatal);- Faixa de FP: 25 a 300 bpm, precisão ±2 bpm, resolução 1 bpm,- Faixa alarme. 30 a 300 bpm Precisão ±2% - Intervalo de medição de PI: 0 a 10.Temperatura Infravermelho (TH):- Um Canal;- Auricular;- Intervalo de medição: 34°C a 42.2°C;- Temp de funcionamento: 10h;- Resolução 0.1 °C Precisão ±0,2°C (35°C a 42°C) ou ±0,3°C fora da faixa mencionada.Conteúdo da Embalagem:- 01 (um) Módulo temp Th,- 01 (uma) Sensor Infra- 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT;- 01 (um) Cabo terra Vita;- 01 (um) Bateria Interna Recarregável Lithium-Ion 2400 mAh;- 01 (um) Manual em Português..



Outros Automotivo

[Handwritten signature]

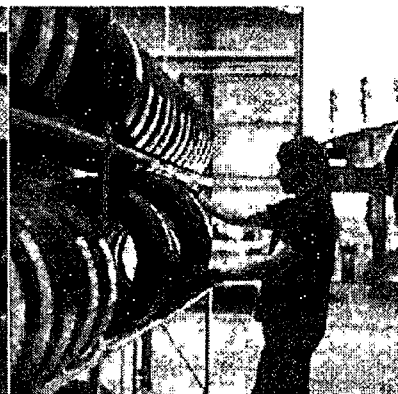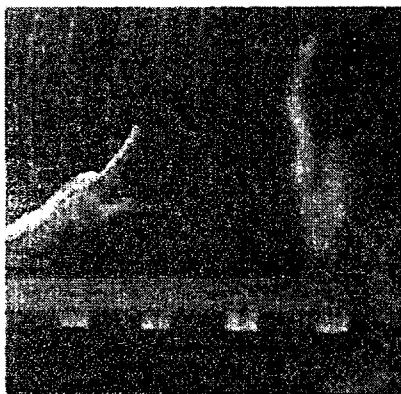

Pneu LT e AT: entenda as diferenças

Vem ver as diferenças deles e acerte na escolha!

Qual a calibragem certa do pneu?

Vem ver como manter seus pneus sempre em dia!

Tudo sobre pneus

Vem comigo que eu te ajudo a escolher o melhor modelo pro carro!

Como escolher o pneu

Vem conhecer os ruidados e marcas desse item

[Veja outros conteúdos](#)

Avaliação dos clientes

ESCREVER UMA AVALIAÇÃO



Monitor de sinais vitais (ecg / spo2 / resp / temp / pni) vita...

Avaliação geral

0.0 ★★★★★
0 avaliação

Ordenar avaliações: [Mais relevantes](#)

Formas de pagamento

Cartão Luiza

Numero de parcelas

R\$ 9.900,00 à vista

02x de R\$ 4.950,00 sem juros

03x de R\$ 3.300,00 sem juros

04x de R\$ 2.475,00 sem juros

Total

R\$ 9.900,00

R\$ 9.900,00

R\$ 9.900,00

Cartão de crédito

(Produto + Frete)
Numero de parcelas

R\$ 9.900,00 à vista

02x de R\$ 4.950,00 sem juros

03x de R\$ 3.300,00 sem juros

04x de R\$ 2.475,00 sem juros

Total

R\$ 9.900,00

R\$ 9.900,00

R\$ 9.900,00

Pix

R\$ 9.900,00 à vista
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

Boleto bancário

R\$ 9.900,00 à vista
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.



PROCESSO DE LICITAÇÃO

PAMO

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(FORNECEDORES)



**TEKMARKET INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.579.468/0001-52

Endereço: Rua Alameda da Inovação, nº 270 –
Salas 004, Cidade: Campo Bom - RS Bairro:
Zona Industrial CEP: 93700-000

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - S/A
CONTATO
Caroline Guerizoli
caroline@tothtecnologia.com.br

Dados da empresa

Razão social: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Nome empresa: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

CNPJ: 09.577.422/0001-07


E-mails: hger@hger.com.br

Telefones: +55 (81) 99605-7111, +55 (81) 2123-4844,
+55 (81) 2123-4817

Endereço: RUA DO HOSPICIO, 563 - ANDAR
PRIMEIRO. BOA VISTA Recife/PE 50050050

Produtos e serviços:

Otd.	Foto	Ref.	Item	Tipo	Valor unil.	Desconto	Subtotal
1		3100	Monitor Smart Check - PNI e SPO2	Produto	R\$ 14.021,00	R\$ 2.804,20 (20,0 %)	R\$ 11.216,80
- Pressão Não Invasiva, Oximetria, Frequência Cardíaca e Bluetooth. - Acessórios Incluídos: Cabo de Força, Mangueira e Manguito padrão Adulto 23-33 cm, Extensão e Sensor de Oximetria DS- 100A NELLCOR e Manual do Usuário. - NCC 1. 30181080 - Registro Anvisa: 81658400001							
1		34000000	Carrinho de Transporte Smart	Produto	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 1.760,00
1		1242B	Termômetro Bluetooth	Produto	R\$ 560,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 560,00
1		30060004	Glicosímetro TD-4279/Hematócrito	Produto	R\$ 480,00	R\$ 0,00 (0 %)	R\$ 480,00



Resumo da proposta::

Subtotal em produtos:	R\$ 14.016,80
Subtotal em serviços:	R\$ 0,00
Subtotal geral:	R\$ 14.016,80
Frete FOB	R\$ 200,00
Valor final:	R\$ 14.216,80

Previsão de entrega:

15 DIAS:

Forma de pagamento

Dados Bancários:

Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda

CNPJ 21.579.468/0001-52

~~BraDESCO (237)~~

Agência: 07210-9

Conta corrente: 74076-4

~~Banco do Brasil~~

Agência: 5745-2

Conta: 13.270-5

Boleto, cartão de crédito, PIX ou transferência bancária;

Observações

Ao aprovar a presente proposta, declaro estar ciente e de acordo com as condições supracitadas.

Proposta Nº: 23001

Emissão da Proposta: 23/05/2023

Validade da Proposta: 23/05/2023

ASSINATURA

Proposta Emitida por:

Daniel Valério

daniel.valerio@safesolucoes.com.br

(81) 9742-2312

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Av. Ademar
Rua da Saúde com.br

11 1032-80

Em atenção à sua consulta, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas.. proposta comercial cujo objetivo é o fornecimento de produto de mais avançada tecnologia.

Estamos à sua disposição para esclarecermos quaisquer dúvidas referentes a assuntos técnicos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

MONITOR DE TRIAGEM VS-600 SPO2 PNI TEMP

Desc. Produto	Qtd	UM	V. Unit c/PI	V. Total
MONITOR DE TRIAGEM VS-600 SPO2 PNI TEMP	2	UN	19.000,00	38.000,00

Valor líquido: 38.000,00

Condições de Faturamento:

Observações:

Monitor de sinais vitais


- Prazo de Pagamento : 0 DD
- Prazo de Entrega : 10 Dias após aprovação
- Validade da Proposta : 492 DD
- Forma de Pagamento : Emitente
- Garantia do Equipamento : 1 Ano
- Garantia do Acessório : 3 Meses
- Valor Mínimo : R\$ 2.000,00


Aprovação do Cliente:

Data ____/____/____

Nome _____

Assinatura





PROCESSO DE LICITAÇÃO

PAMO

- PAASSEx 2023 -

PESQUISA DE PREÇOS

(FNS)




Opção 4: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/pre configurado de 13' a 20'/com suporte;
 Opção 5: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/pre configurado de 7' a 10'/com suporte;
 Opção 6: SPO2, PNI, TEMP/pre configurado de 7' a 10'/com suporte, e
 Opção 7: SPO2, PNI, TEMP/estrutura mista ou modular de 7' a 10'/com suporte.

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Anexos

Empresário	Endereço	Telefone	Página na Internet	Telefone
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.			http://www.airliquidehealthcare.com.br	(11) 553698471
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA		(11) 3388	http://www.alfamed.com	(31) 35818000
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MAGROSUL LTDA.		(51) 309344	http://www.macrosul.com	(41) 2132000
DIVERSAMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI			http://diversamed.com.br/	(62) 985912335
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			http://www.drager.com	(11) 46894500
FPRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.			http://www.fmc-ag.com.br/	(11) 25041400
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.			http://www3.gehealthcare.com.br/	(69) 1222345
INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA			http://www.instramed.com.br	(51) 30738228
JG MORIYA			http://jgmcfva.com.br/	(11) 23149716
MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			http://med-equip.com.br/	(11) 200000452
MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			http://www.medicalequip.com.br/	(11) 2314629
PRÓTEC SISTEMAS MÉDICOS LTDA			http://www.protec.com.br/	(51) 3134329
TECNOLOGIA DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA			http://www.tecnologia.com.br/	(51) 3134329
TECNOLOGIA DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA			http://www.tecnologia.com.br/	(51) 3134329



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI
- PAASSEx 2023 -

- () REQUISITÓRIA
- () ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
- () BOLETIM INTERNO
- () MAPA DE RISCO
- () TERMO DE REFERÊNCIA
- () PARECER TÉCNICO
- () FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA
- () DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- () MAPA COMPARATIVO
- () RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO
- () ANÁLISE CRÍTICA
- () JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
- () TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO
- () AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
- () APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- () PESQUISA DE PREÇOS



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JP'.

PESQUISA DE PREÇOS

(PAINEL DE PREÇOS)



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI

- PAASSEx 2023 -

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS

(ATAS)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2022 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 11 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 553 de 09/12/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23302000382202296, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de materiais e medicamentos odontológicos e hospitalares para o IF Sertão - PE. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Epinefrina

Descrição Complementar: Epinefrina Uso: Solução Injetável , Dosagem: 1mg/ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 22

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Ampola 1,00 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Diclofenaco

Descrição Complementar: Diclofenaco Apresentação: Sal Potássico , Dosagem: 50 Mg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 38

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Comprimido

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,8500 e a quantidade de 38 Comprimido

Item: 3

Descrição: Diclofenaco

Descrição Complementar: Diclofenaco Forma Farmacêutica: Aerosol Tópico , Composição: Sal Dietilamônio , Concentração: 10 MG/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 112

Valor Máximo Aceitável: R\$ 26,9100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Frasco 85,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26,9100 e a quantidade de 112 Frasco 85,00 ML .

Item: 4

Descrição: Escopolamina Butilbrometo

Descrição Complementar: Escopolamina Butilbrometo Apresentação: Associada Com Dipirona Sódica , Dosagem: 10mg + 250mg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 32

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Comprimido

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,3900 e a quantidade de 32 Comprimido .

Item: 5

Item: 80**Descrição:** Monitor portátil**Descrição Complementar:** Monitor Portátil Componentes: Com Lancetas, Tiras , Faixa De Operação: 600 + 300 + 600 Mg/Dl + 25 Mmol/L , Tipo De Análise: Dosagem Glicose, Colesterol, Triglicerídeos, Lactato , Tipo Amostra: Sangue Capilar Memória: Até 150 Testes , Operação: Digital , Acessórios: Lancetador, Solução Controle**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 211,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

ASSINATURA
 FOLHA: 1/1
 RECIFE - S.A.C.
 HOSPIZAL DE ALTA DE

Item: 81**Descrição:** Adipômetro**Descrição Complementar:** Material: Metal, Faixa De Operação: Até 95 MM, Tolerância: Tolerância Até 5 MM, Resolução: Resolução 0,1 MM, Operação: Analógico, Pressão: Cerca De 10 G/Mm²,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 142,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 82****Descrição:** Dispositivo p, medidas antropométricas**Descrição Complementar:** Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Tipo*: Tipo Trena, Componente II: Retrátil, C/ Trava, Material*: Fibra De Vidro, Faixa Medição: Cerca De 2,0 M,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 39,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** THAYS GOMES DA GAMA, pelo melhor lance de R\$ 39,0600 e a quantidade de 7 Unidade .**Item: 83****Descrição:** Balança eletrônica**Descrição Complementar:** Capacidade Pesagem: 15 KG, Tipo: Digital, Características Adicionais: Contadora/Prato De Pesagem Em Aço Inoxidável, Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação, Voltagem: Bateria Interna Recarregável, Adaptador 12 Vac-220 V,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 203,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 84****Descrição:** Balança precisão**Descrição Complementar:** Características Adicionais: Funcionamento A Pilha, Pilhas Alcalinas Inclusas,, Resolução: 1 G, Capacidade Máxima: 5 KG, Tipo Painel: Visor Digital,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 241,6400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 85****Descrição:** Dispositivo p, medidas antropométricas**Descrição Complementar:** Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Modelo: Elétrica, Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG, Tipo*: Tipo Balança C/ Régua, Componente I: C/ Visor Digital, Componente II: Tapete De Borracha, Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática, Componente III: Pés Reguláveis, Faixa Medição: Cerca De 2,0 M,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.428,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.428,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 86****Descrição:** Medidor**Descrição Complementar:** Material: Pvc, Aplicação: Índice De Massa Corporal, Tipo: Disco,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 54,0300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 87**



PROCESSO DE LICITAÇÃO

2ª/4ª UI

- PAASSEx 2023 -

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

SETEMBRO 2022

PESQUISA DE PREÇOS


(SÍTIOS ELETRÔNICOS)

Busca no Magalu



Bem-vindo)
Entre ou faça login

Meu perfil



Magalu | [participações](#) | [Ofertas do Dia](#) | [Celulares](#) | [Móveis](#) | [Eletrodomésticos](#) | [TV e vídeo](#) | [Informática](#)


Descubra as ofert

Magalu | [Cuidados Pessoais](#) | [Avaliação Física](#) > [Balanças](#) > [Balança Antropométrica](#) > [Balança Eletrônica Adulto com régua antropométrica](#)

Compartilhe sua loca
valores de frete, entr

Balança Eletrônica Adulto com régua antropométrica W 200/100 A - Welmy

[Ver descrição completa](#) | Welmy

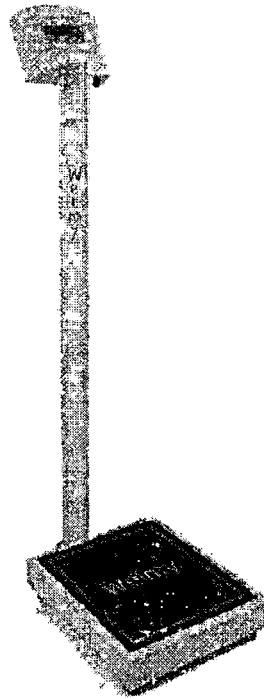

☆☆☆☆ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Hplace Produtos Médicos](#)

Entregue por [MAGALU](#)

O Magalu garante a sua compra do pedido a entrega

R\$ 1.990,00

R\$ 1.690,00

ou R\$ 1.690,00 em 10x de R\$ 169,00 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

[Calcular frete e prazo](#)

Informações do Produto

Balança Eletrônica Adulto com rég... R\$ 1.690,00 à vista

[ADICIONAR À SACOLA](#)

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight;
 Iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima;
 Plataforma 390 x 340cm;
 Estrutura em chapa de aço carbono;
 Alinhamento em tinta eletrostática a pó;
 Padrão na cor branca;
 Tábua em borracha anti-derrapante;
 Pés reguláveis em borracha sintética;
 Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;
 Função TARA ate capacidade máxima;
 homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN.

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SAÚDE
 FOLHA: 1807
 ASSINATURA

D



Balança Antropométrica



Conheça a balança de bioimpedância

Saiba pra que serve esse aparelho e as medidas que ele pode medir!

Veja diferentes tipos de dinamômetro

Saiba pra que servem e como usar os vários modelos dessa ferramenta de medida

Pra que serve o exame de dinamometria

Descubra como fisioterapeutas usam esse teste pra acompanhar cada paciente

O que é o dinamômetro

Conheça esse equipamento e ele pode melhorar seu dia a dia

[Veja outros conteúdos](#)

Avaliação dos clientes

Balança Eletrônica Adulto com régua antropométrica W...

[Handwritten signature]

Avaliação geral

0.0 ★★★★★
0 avaliação

Ordenar avaliações: Mais relevantes

Formas de pagamento

Cartão Loja

Numero de parcelas

R\$ 1.690,00 à vista

ou R\$ 845,00

Total

R\$ 1.690,00

Cartão de crédito

(Procurar + Frete)
Numero de parcelas

R\$ 1.690,00 à vista

ou 02x de R\$ 845,00
sem juros

Total

R\$ 1.690,00

Pix

R\$ 1.690,00 à vista
No PIX, com o código que será gerado na
finalização da sua compra.

Boleto bancário

R\$ 1.690,00 à vista
No boleto bancário, que será gerado na
finalização da sua compra.

Balança Eletrônica Adulto com rég... R\$ 1.690,00 à vista


SELECIONAR O SEU TIPO DE PAGAMENTO

[voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Parcela + Parcela	Total	(Parcela + Parcela) Número de parcelas	Total
Parcela de R\$ 338,00	R\$ 1.690,00	05x de R\$ 338,00 sem juros	R\$ 1.690,00
Parcela de R\$ 281,67	R\$ 1.690,00	06x de R\$ 281,67 sem juros	R\$ 1.690,00
Parcela de R\$ 241,43	R\$ 1.690,00	07x de R\$ 241,43 sem juros	R\$ 1.690,00
Parcela de R\$ 211,25	R\$ 1.690,00	08x de R\$ 211,25 sem juros	R\$ 1.690,00
Parcela de R\$ 187,78	R\$ 1.690,00	09x de R\$ 187,78 sem juros	R\$ 1.690,00
Parcela de R\$ 169,00	R\$ 1.690,00	10x de R\$ 169,00 sem juros	R\$ 1.690,00
Parcela de R\$ 172,58	R\$ 1.898,41	11x de R\$ 172,58 com juros	R\$ 1.898,41
Parcela de R\$ 159,71	R\$ 1.916,49	12x de R\$ 159,71 com juros	R\$ 1.916,49

[Handwritten signature]

Condições relacionadas: Balança Eletrônica Adulto com régua antropométrica W 200/100 A Balança Eletrônica Balança Adulto com régua antropométrica W 200/100 A Balança Adulto Balança com régua antropométrica W 200/100 A Balança Balança régua antropométrica W 200/100 A Balança régua antropométrica W 200/100 A Balança antropométrica

[veja mais](#)

Formas de pagamento



mercado	tecnologia	audio	automotivo	marketplace	bebidas	beleza	proteção	brinquedos	serviços	parcerias	como e onde falar com
					bebidas seus produtos	beleza perfumaria	proteção segurança	brinquedos brinquedos	serviços câmera drone, câmera, câmera e banho	parcerias castiça de gestão de bebê	como e onde falar com
				atendimento	termo de compra e venda	arrendamento ou cessação	meus pedidos	tracitem devoluções	assistência técnica	portal financeiro	

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-89

Magazine Luiza S/A - CNPJ. 47.960.950/1088-36


Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

Magazine Luiza - Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: <https://www.magazineluiza.com.br>



Fale conosco: <https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/>

Home > Aparelhos Médicos > Balança > Balança Digital com Plataforma Display de Led até 200kg - WELMY

76%
OFF

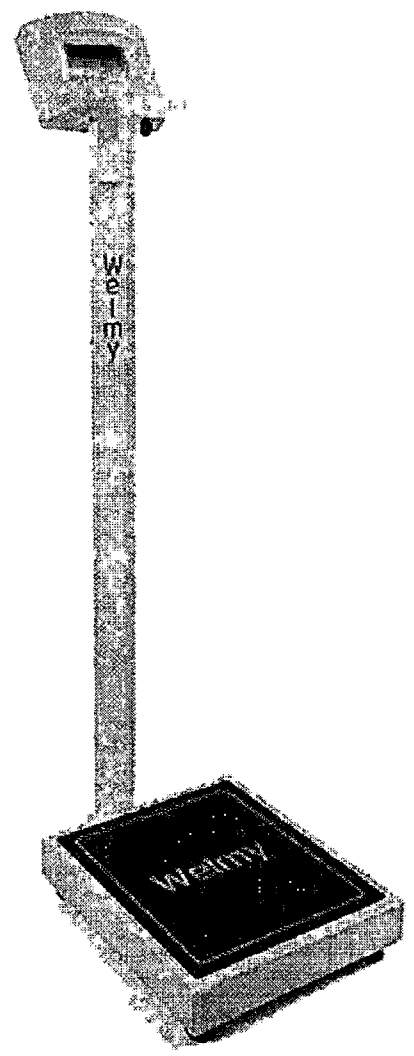

[Handwritten signature]



Balança Digital com Plataforma Display de Led até 200kg - WELMY

[Ver mais detalhes](#) [avalle agora!](#)

WELMY BALANCA





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO / 1817)**

TERMO DE ENCERRAMENTO DO 8º VOLUME

Aos 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, procedemos ao encerramento do **Volume VIII** do Processo Administrativo nº **64583.010437/2022-44**, contendo as folhas nº 1601 a 1600.

Hospital Militar de Área de Recife
UASG: 160199

GEORGE DOS SANTOS COSTA – 2º Ten

Adjunto da Saic do HMAR